

<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SEKOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1990	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 34 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1440	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 67 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 28,1 °C  
 Pression atmosphérique : 93,2 kPa  
 Humidité : 54 %

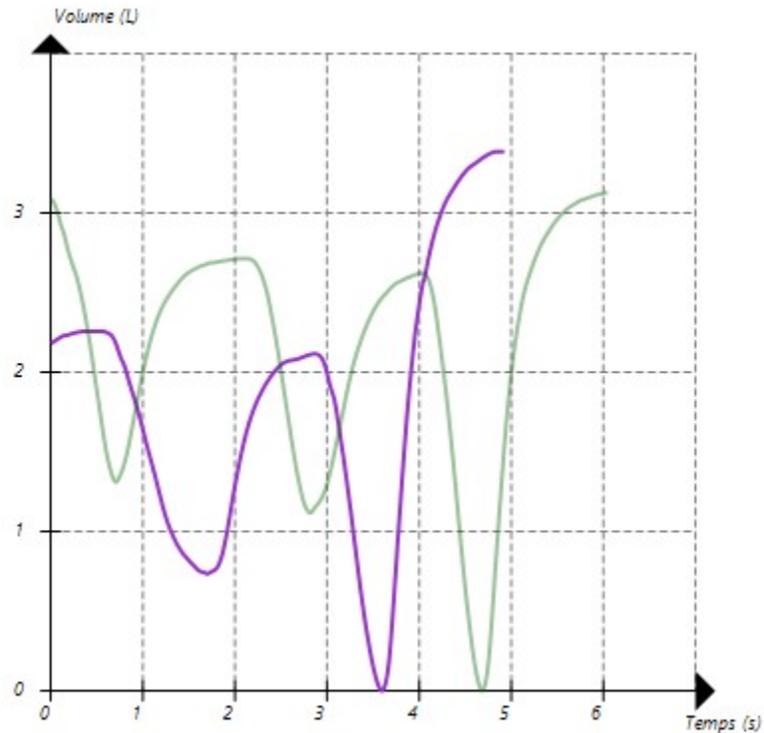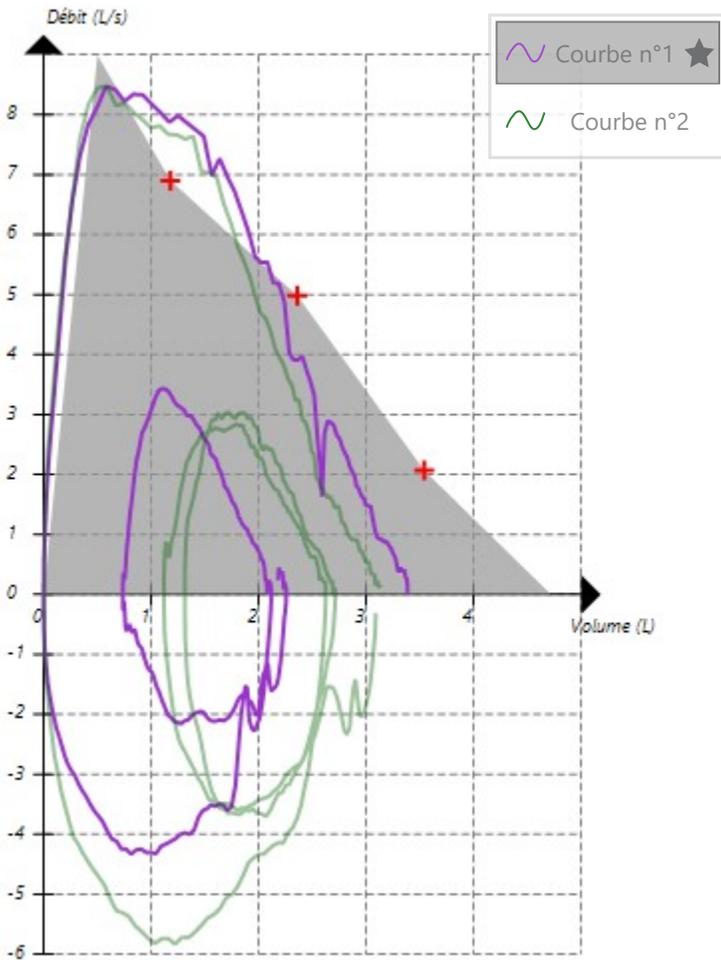

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,39 L	3,13 L	4,72 L	71,82 %
VEMS	3,33 L	3,07 L	3,94 L	84,52 %
DEP	8,56 L/s	8,56 L/s	8,99 L/s	95,22 %
VEMS/ CVF	98,23 %	98,08 %	83,13 %	118,16 %
Durée d'expiration	1,30 s	1,37 s	-	
DEMM	6,14 L/s	6,05 L/s	4,20 L/s	146,19 %
DEMM/ CVF	1,81 s-1	1,93 s-1	0,89 s-1	203,37 %
DE75	8,29 L/s	8,16 L/s	6,90 L/s	120,14 %
DE50	6,90 L/s	7,01 L/s	4,98 L/s	138,55 %
DE25	2,71 L/s	3,32 L/s	2,07 L/s	130,92 %

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: