



<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> KARAMOKO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1999	<b>Profession</b> OPERATEUR
<b>Age</b> 26 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 9802	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 176 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 71 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,8 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,7 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 63 %

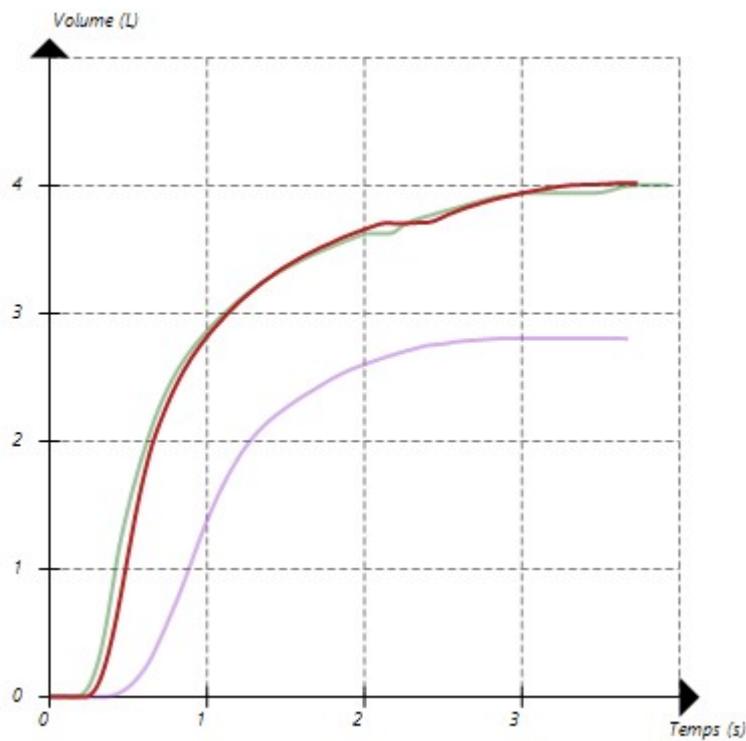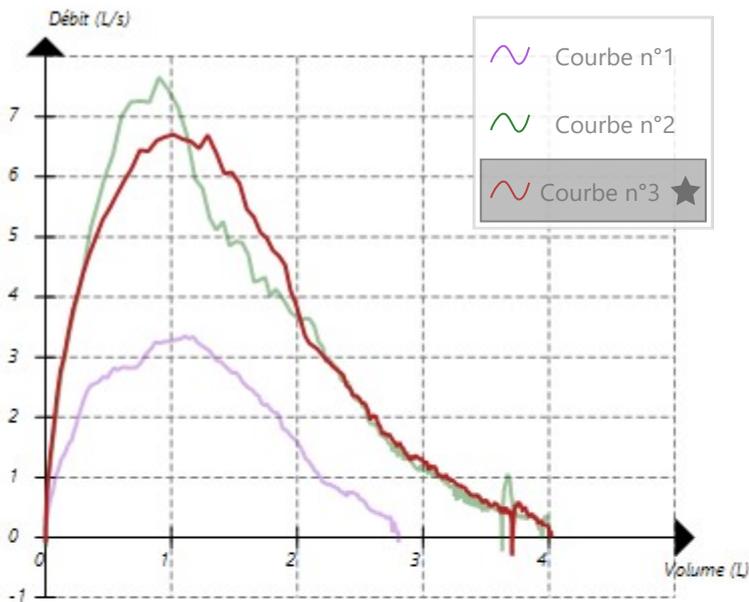

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,81 L	4,00 L	4,02 L	4,53 L	88,74 %
VEMS	2,34 L	3,19 L	3,22 L	3,83 L	84,07 %
DEP	3,41 L/s	7,77 L/s	6,88 L/s	9,63 L/s	71,44 %
VEMS/CVF	83,27 %	79,75 %	80,10 %	84,49 %	94,80 %
Durée d'expiration	2,54 s	3,56 s	3,51 s	-	
DEMM	2,52 L/s	2,89 L/s	3,05 L/s	4,29 L/s	71,10 %
DEMM/CVF	0,90 s-1	0,72 s-1	0,76 s-1	0,95 s-1	80,00 %
DE75	2,80 L/s	7,42 L/s	6,63 L/s	-	
DE50	2,86 L/s	3,66 L/s	3,75 L/s	-	
DE25	1,24 L/s	1,07 L/s	1,22 L/s	-	