

<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> OUSMANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2002	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 22 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 738	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 161 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 49 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,9 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 71 %

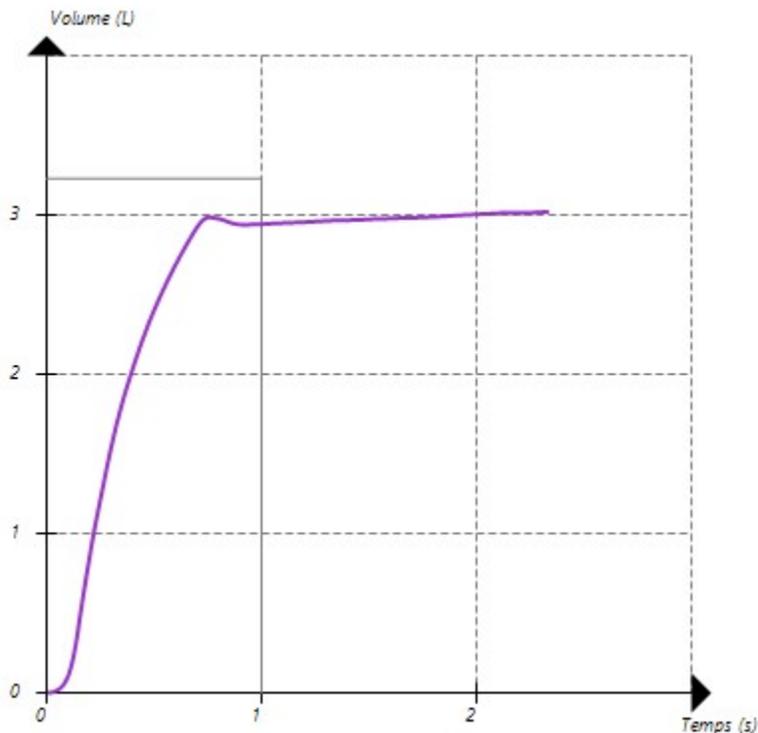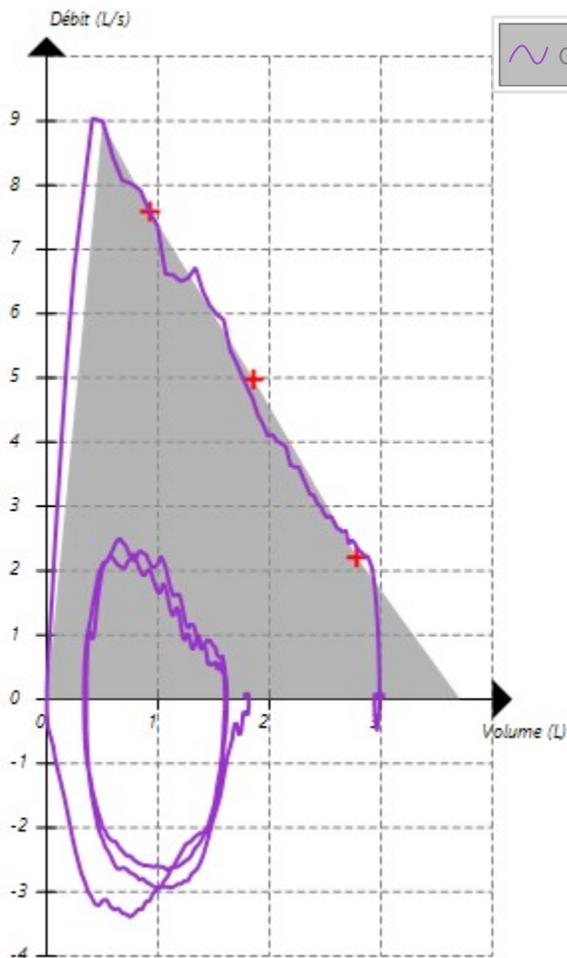

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,99 L	3,71 L	80,59 %
VEMS	2,99 L	3,23 L	92,57 %
DEP	9,30 L/s	8,97 L/s	103,68 %
VEMS/ CVF	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	0,79 s	-	
DEMM	5,63 L/s	4,75 L/s	118,53 %
DEMM/ CVF	1,88 s-1	1,11 s-1	169,37 %
DE75	8,05 L/s	7,59 L/s	106,06 %
DE50	6,02 L/s	4,98 L/s	120,88 %
DE25	3,61 L/s	2,21 L/s	163,35 %