



<b>Nom</b> KONATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LANCINET	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 05/08/1988	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 36 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> MANOEUVRE
<b>ID</b> 1668	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 160 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 62 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00	Température ambiante : 29,5 °C
Numéro de série : 232697	Pression atmosphérique : 93,7 kPa
Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024	Humidité : 59 %

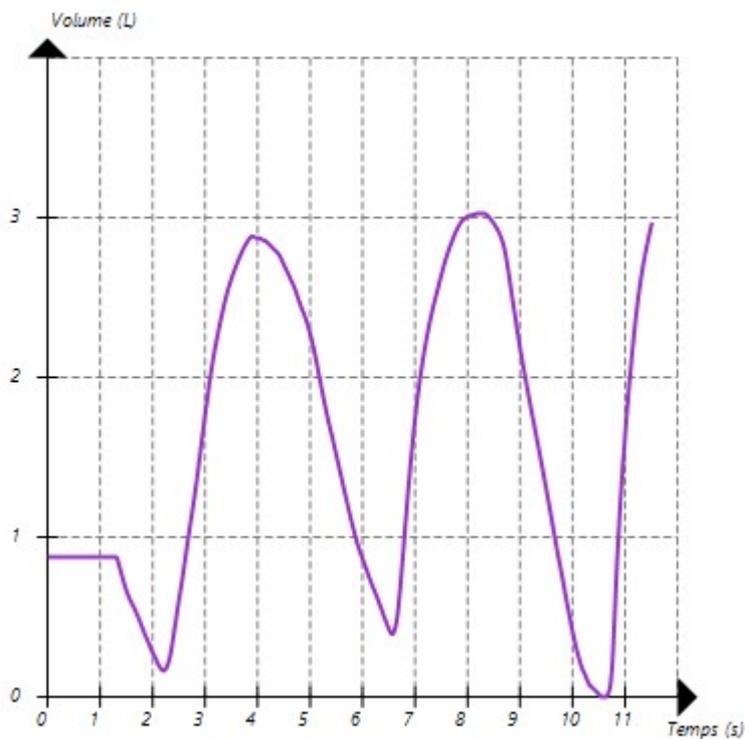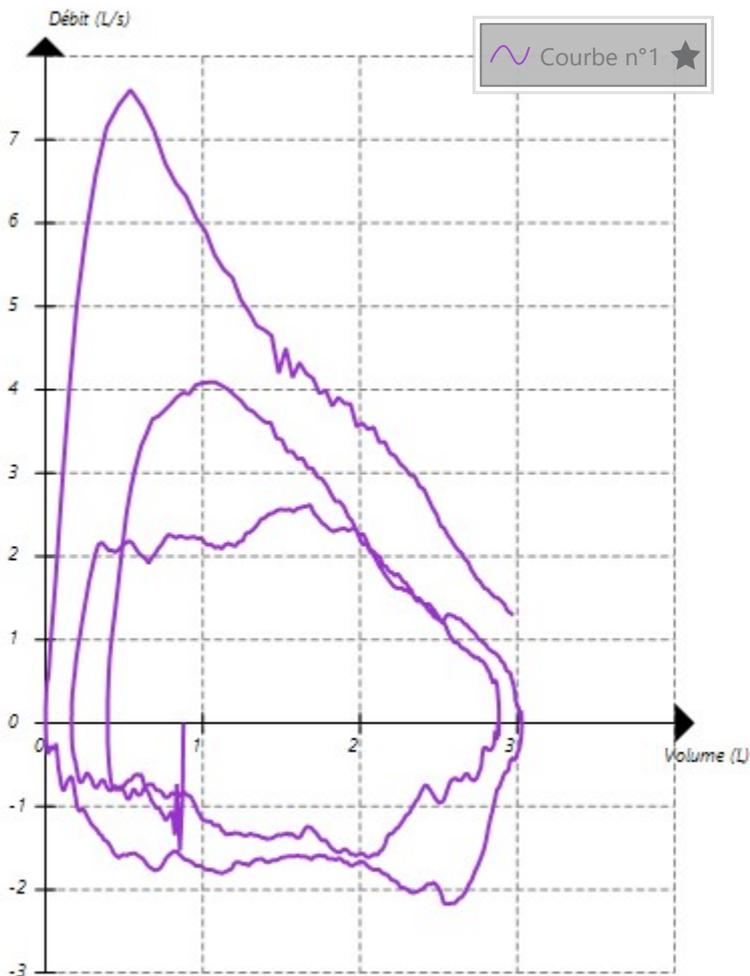

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,99 L	3,45 L	86,67 %
VEMS	2,99 L	2,89 L	103,46 %
DEP	7,64 L/s	7,75 L/s	98,58 %
VEMS/ CVF	100,00 %	82,66 %	120,98 %
Durée d'expiration	0,90 s	-	
DEMM	4,57 L/s	3,30 L/s	138,48 %
DEMM/ CVF	1,53 s-1	0,96 s-1	159,38 %
DE75	6,75 L/s	-	
DE50	4,31 L/s	-	
DE25	3,27 L/s	-	