

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2002	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 22 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 724	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 185 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 96 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,3 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 56 %

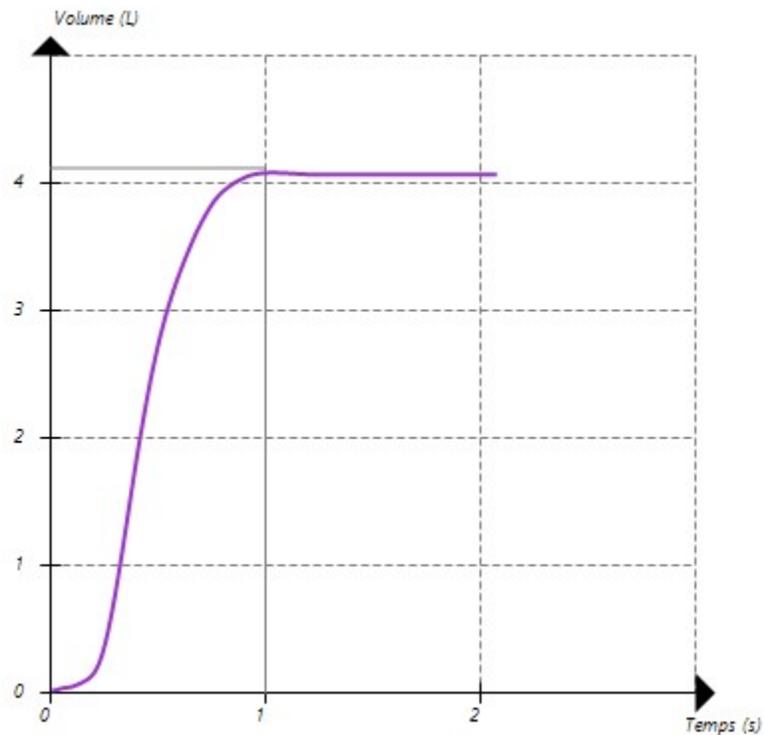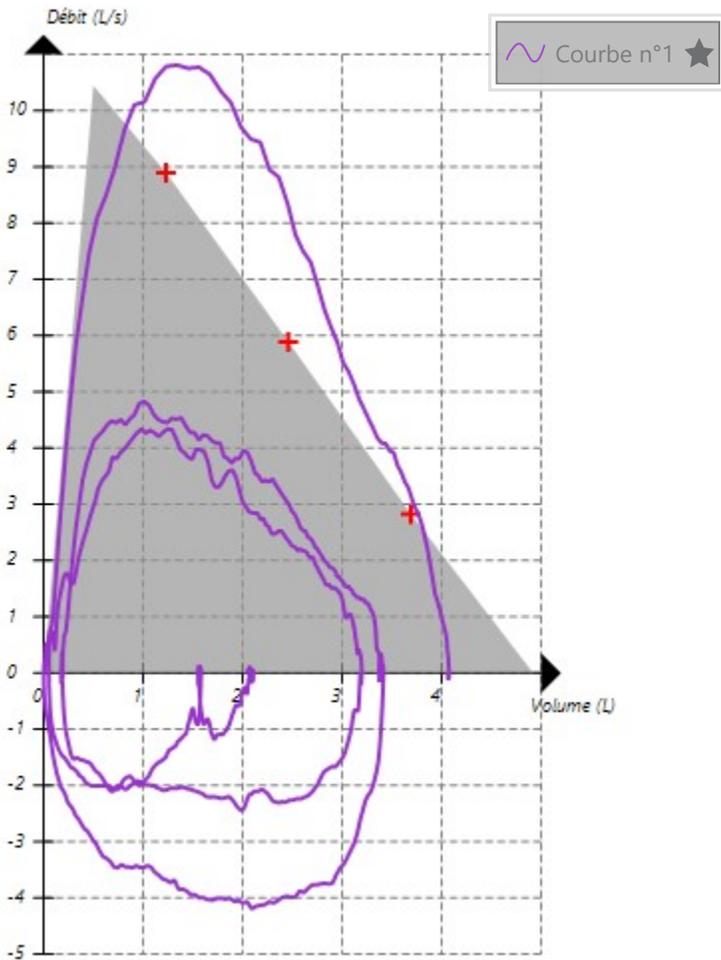

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,07 L	4,92 L	82,72 %
VEMS	4,07 L	4,12 L	98,79 %
DEP	10,92 L/s	10,45 L/s	104,50 %
VEMS/CVF	100,00 %	82,74 %	120,86 %
Durée d'expiration	1,11 s	-	
DEMM	8,93 L/s	5,22 L/s	171,07 %
DEMM/CVF	2,19 s-1	0,92 s-1	238,04 %
DE75	10,17 L/s	8,90 L/s	114,27 %
DE50	9,69 L/s	5,89 L/s	164,52 %
DE25	5,36 L/s	2,83 L/s	189,40 %