

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> IBRAHIMA KALIL	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 13/05/1982	<b>Profession</b> BUS DRIVER
<b>Age</b> 43 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 7958	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 172 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 82 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 26,6 °C  
 Pression atmosphérique : 94,4 kPa  
 Humidité : 78 %

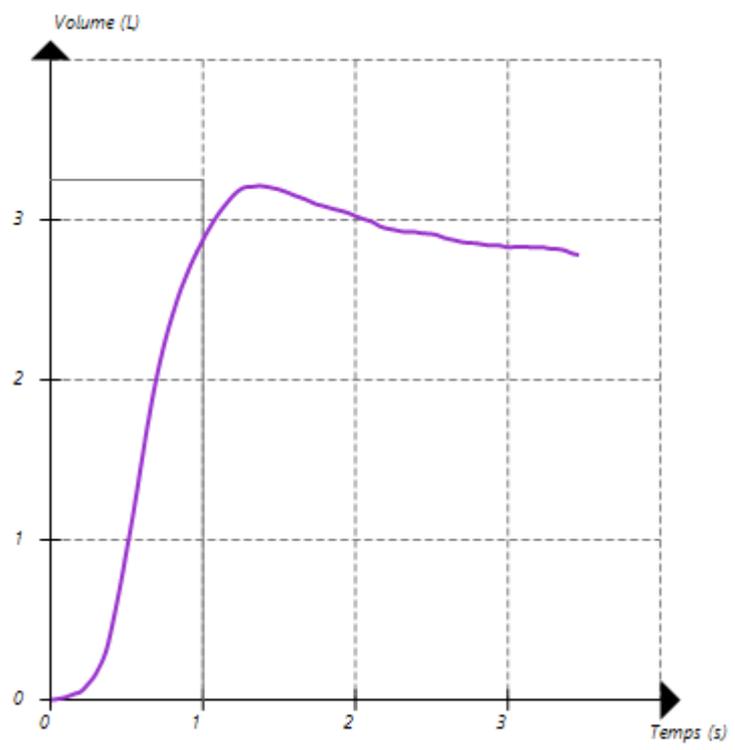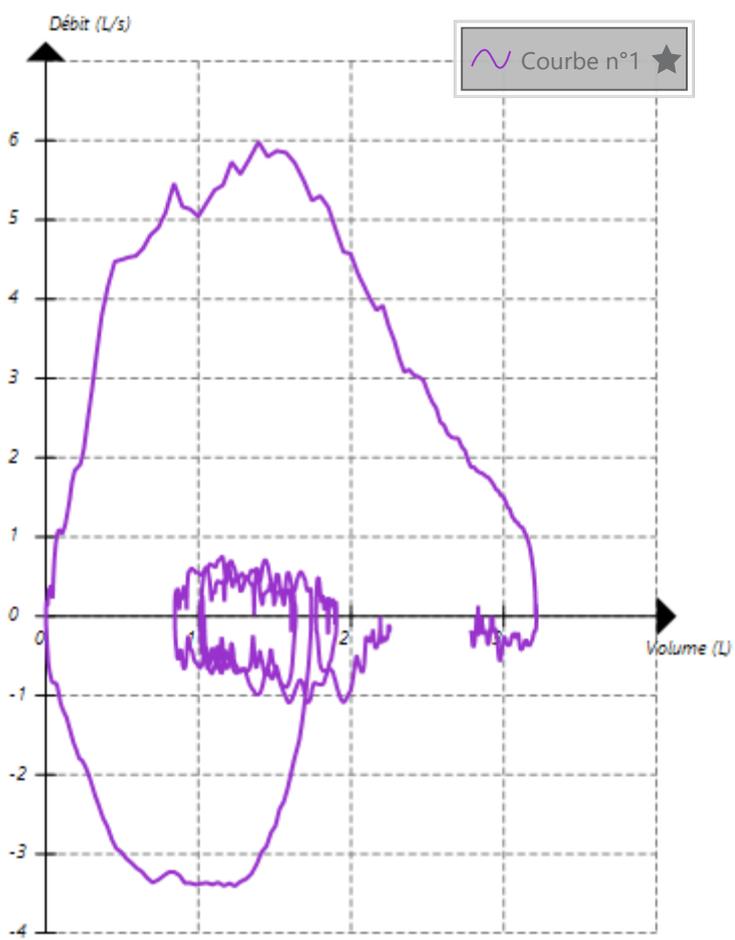

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,21 L	3,99 L	80,45 %
VEMS	3,21 L	3,25 L	98,77 %
DÉP	6,15 L/s	8,56 L/s	71,85 %
VEMS/CVF	100,00 %	81,38 %	122,88 %
Durée d'expiration	1,38 s	-	
DEMM	4,93 L/s	3,42 L/s	144,15 %
DEMM/CVF	1,54 s <sup>-1</sup>	0,86 s <sup>-1</sup>	179,07 %
DE75	5,30 L/s	-	
DE50	5,74 L/s	-	
DE25	2,99 L/s	-	