

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 09/09/1994	<b>Profession</b> WELDER /QC CERTIFIE
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 8974	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 179 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 72 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 26,9 °C  
 Pression atmosphérique : 94,1 kPa  
 Humidité : 57 %

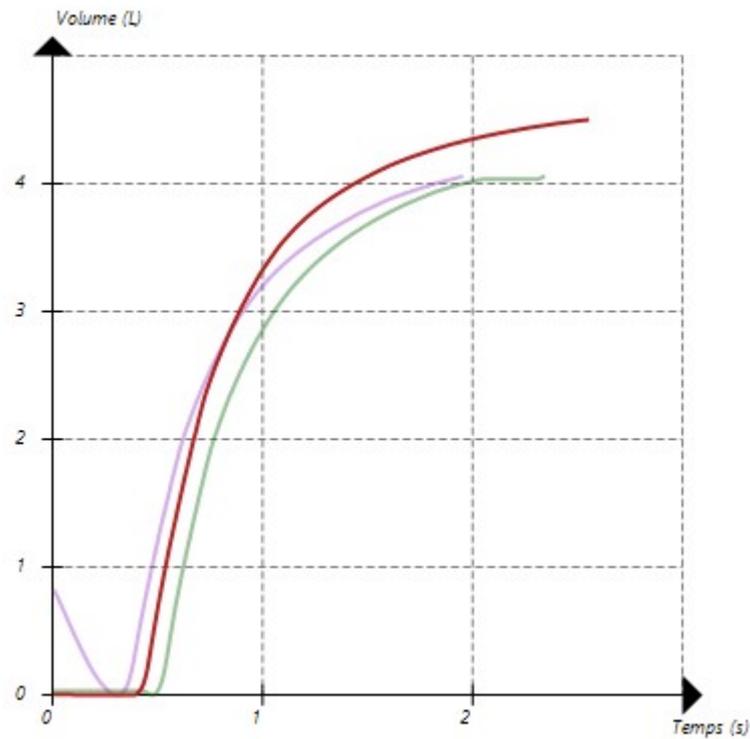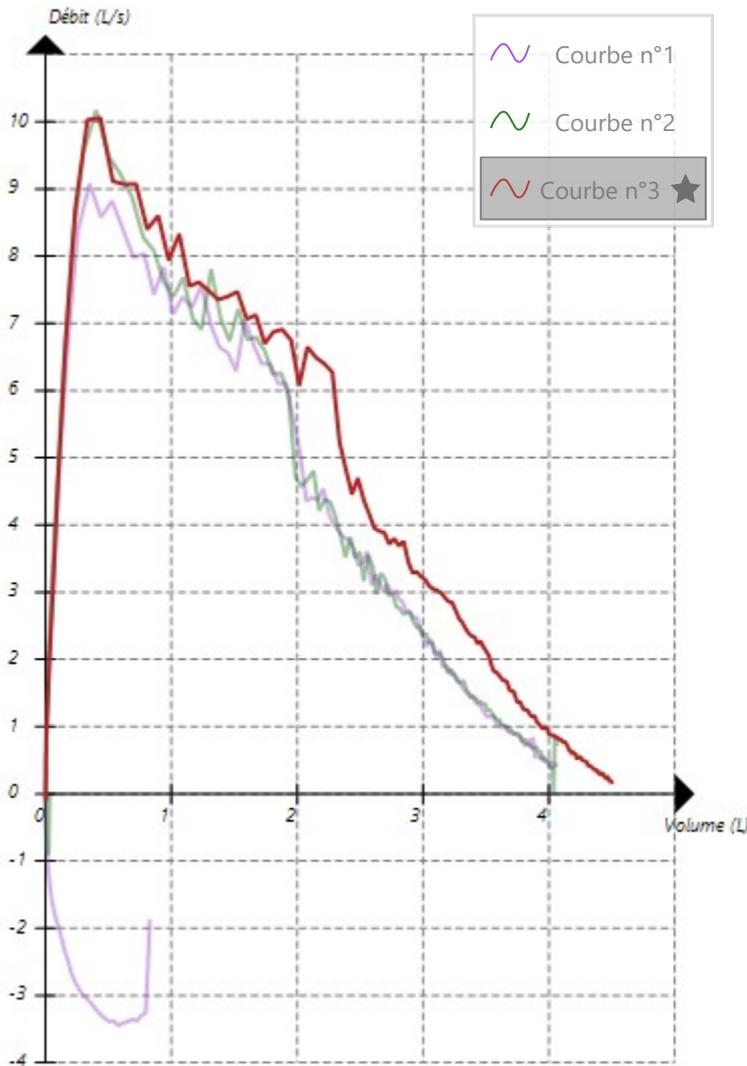

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,06 L	4,07 L	4,50 L	4,63 L	97,19 %
VEMS	3,66 L	3,66 L	3,99 L	3,88 L	102,84 %
DEP	9,10 L/s	10,36 L/s	10,30 L/s	9,76 L/s	105,53 %
VEMS/ CVF	90,15 %	89,93 %	88,67 %	83,76 %	105,86 %
Durée d'expiration	1,66 s	1,88 s	2,19 s	-	
DEMM	4,51 L/s	4,50 L/s	4,81 L/s	4,23 L/s	113,71 %
DEMM/ CVF	1,11 s-1	1,11 s-1	1,07 s-1	0,91 s-1	117,58 %
DE75	7,07 L/s	7,30 L/s	8,01 L/s	-	
DE50	5,04 L/s	4,66 L/s	6,49 L/s	-	
DE25	2,19 L/s	2,26 L/s	2,31 L/s	-	