



<b>Nom</b> YANG	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> CHANGZHAN	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/12/1969	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 55 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 6729	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 62 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 25,3 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 94,3 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 74 %

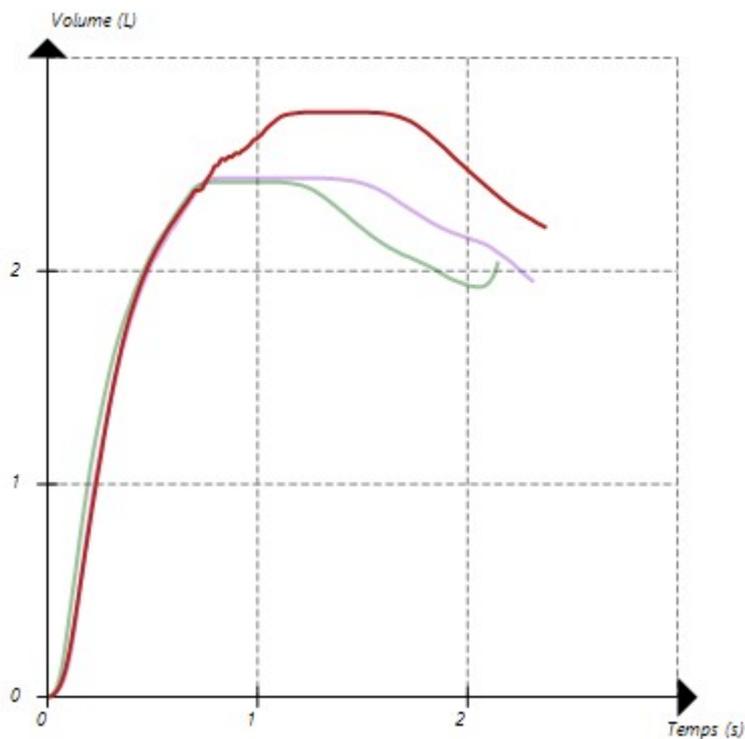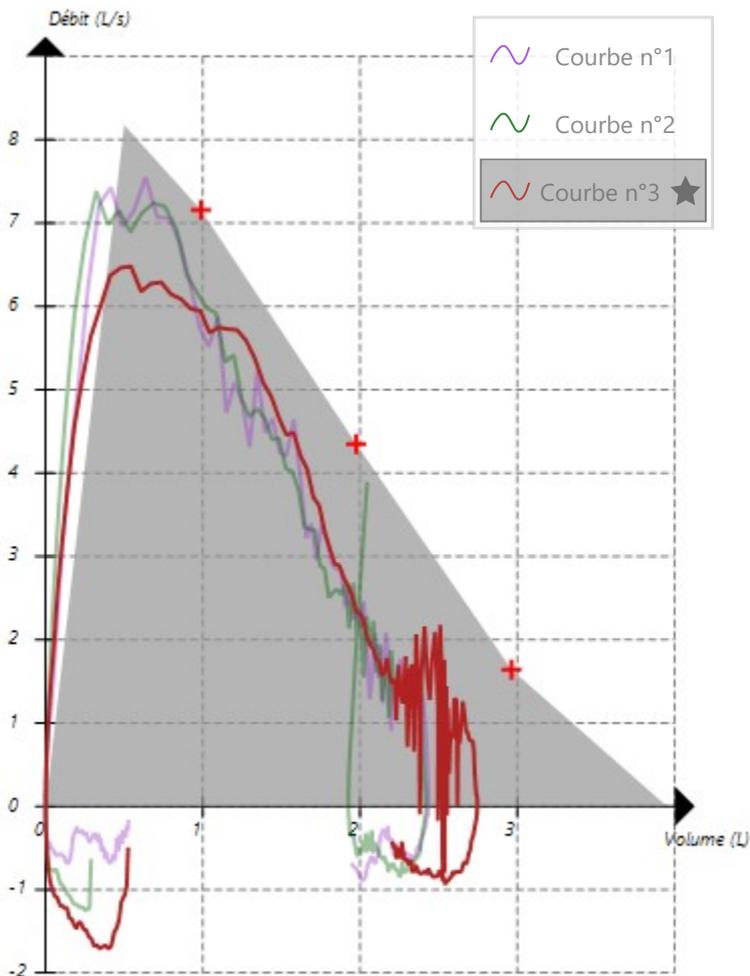

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,44 L	2,42 L	2,75 L	3,95 L	69,62 %
VEMS	2,44 L	2,42 L	2,69 L	3,18 L	84,59 %
DEP	7,75 L/s	7,43 L/s	6,58 L/s	8,18 L/s	80,44 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	97,82 %	77,36 %	126,45 %
Durée d'expiration	0,81 s	0,88 s	1,26 s	-	
DEMM	4,95 L/s	4,91 L/s	4,34 L/s	3,62 L/s	119,89 %
DEMM/CVF	2,03 s-1	2,03 s-1	1,58 s-1	0,92 s-1	171,74 %
DE75	7,69 L/s	7,24 L/s	6,42 L/s	7,16 L/s	89,66 %
DE50	5,41 L/s	5,32 L/s	5,07 L/s	4,35 L/s	116,55 %
DE25	2,67 L/s	2,40 L/s	2,05 L/s	1,64 L/s	125,00 %