

<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> PAPA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1998	<b>Profession</b> BUS DRIVER
<b>Age</b> 27 Ans	<b>Entreprise</b> CR18/CAMP2
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 7041	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 161 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 56 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 26,5 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Humidité : 74 %

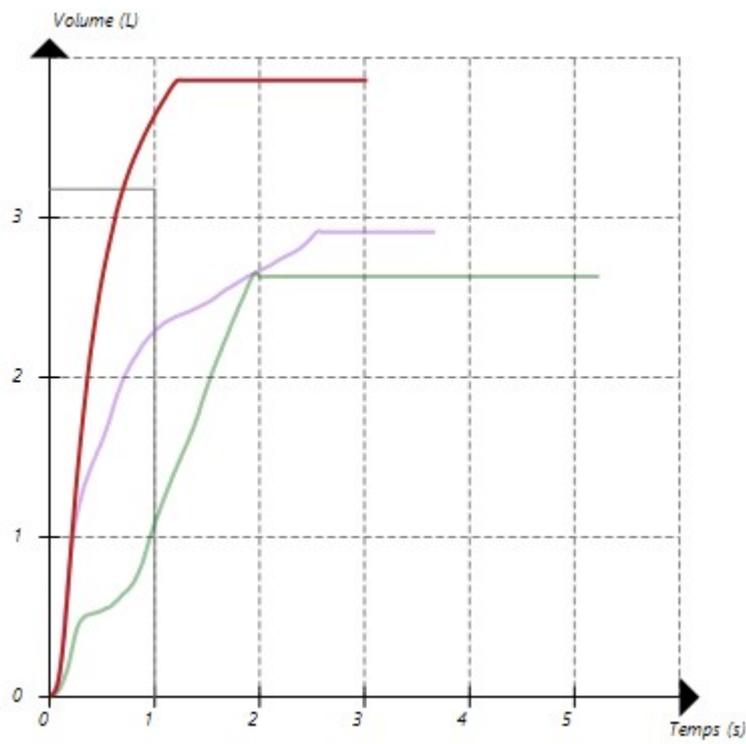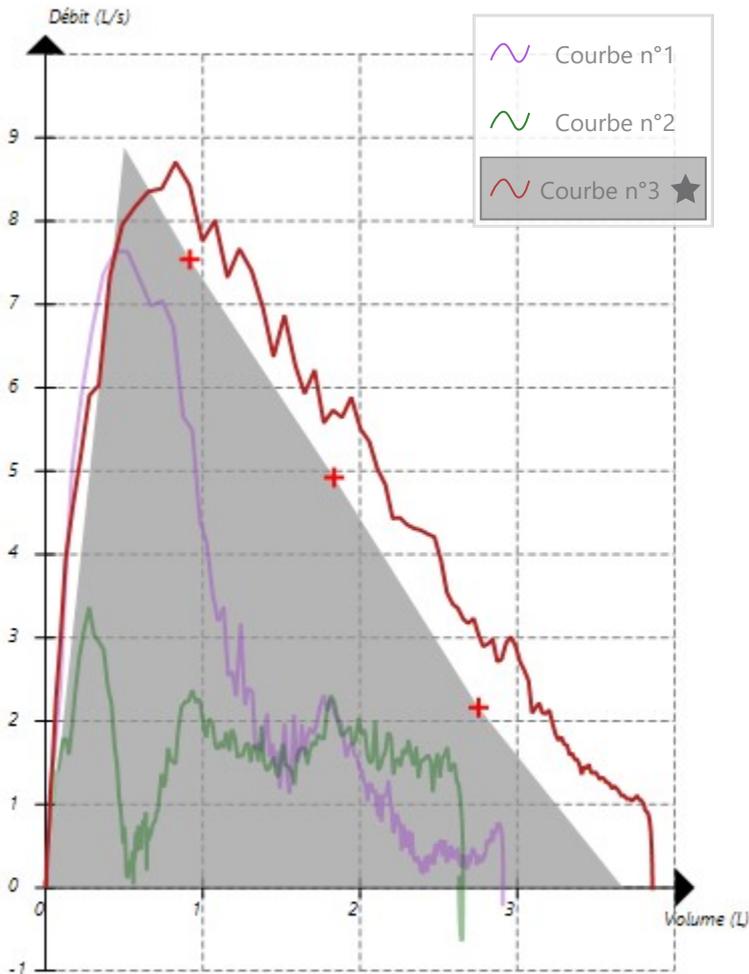

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,91 L	2,66 L	3,86 L	3,67 L	105,18 %
VEMS	2,32 L	1,26 L	3,74 L	3,18 L	117,61 %
DEP	7,85 L/s	3,73 L/s	9,09 L/s	8,89 L/s	102,25 %
VEMS/CVF	79,73 %	47,37 %	96,89 %	82,38 %	117,61 %
Durée d'expiration	3,91 s	1,98 s	1,83 s	-	
DEMM	2,10 L/s	1,67 L/s	5,05 L/s	4,67 L/s	108,14 %
DEMM/CVF	0,72 s-1	0,63 s-1	1,31 s-1	1,11 s-1	118,02 %
DE75	7,25 L/s	0,62 L/s	7,74 L/s	7,54 L/s	102,65 %
DE50	1,46 L/s	1,68 L/s	5,83 L/s	4,92 L/s	118,50 %
DE25	1,35 L/s	2,01 L/s	2,66 L/s	2,16 L/s	123,15 %