

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LANCINE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1993	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 540	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 164 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 51 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 25,2 °C  
 Pression atmosphérique : 94,3 kPa  
 Humidité : 52 %

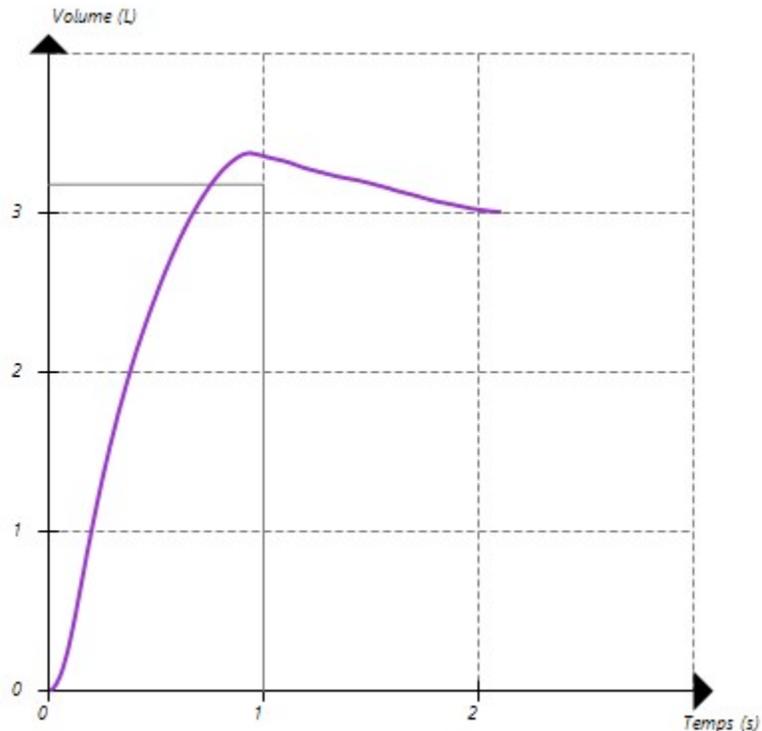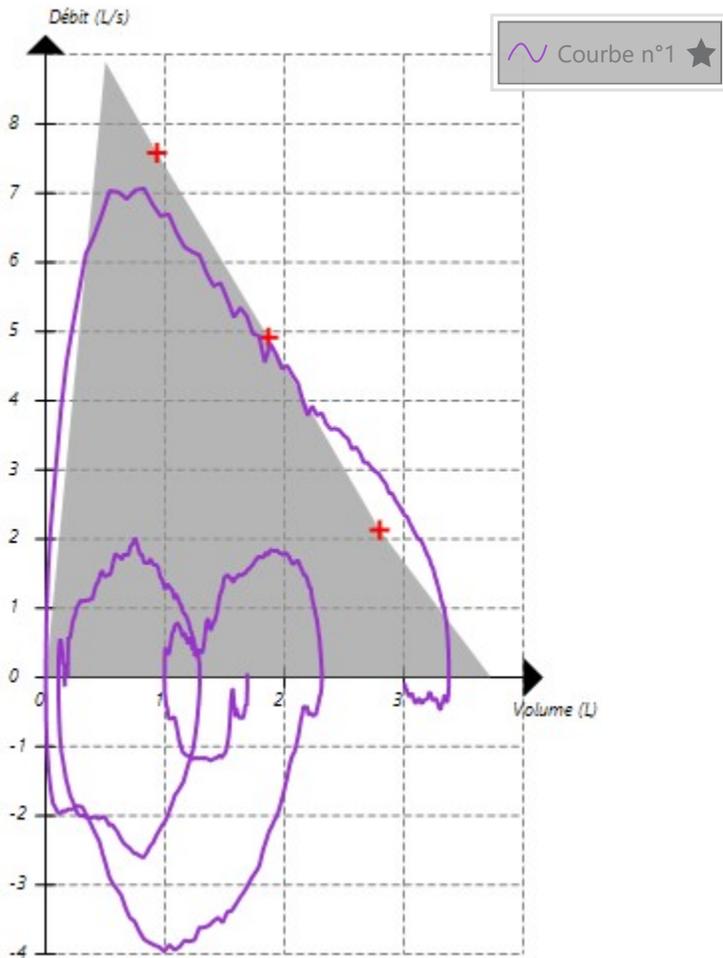

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,38 L	3,73 L	90,62 %
VEMS	3,38 L	3,18 L	106,29 %
DEP	7,18 L/s	8,90 L/s	80,67 %
VEMS/ CVF	100,00 %	81,66 %	122,46 %
Durée d'expiration	0,93 s	-	
DEMM	5,01 L/s	4,55 L/s	110,11 %
DEMM/ CVF	1,48 s-1	1,06 s-1	139,62 %
DE75	6,97 L/s	7,58 L/s	91,95 %
DE50	5,21 L/s	4,91 L/s	106,11 %
DE25	3,44 L/s	2,13 L/s	161,50 %