



<b>Nom</b> GUILAVOGUI	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> JOSEPH	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/02/1983	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 42 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 8984	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 166 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 70 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,2 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 59 %

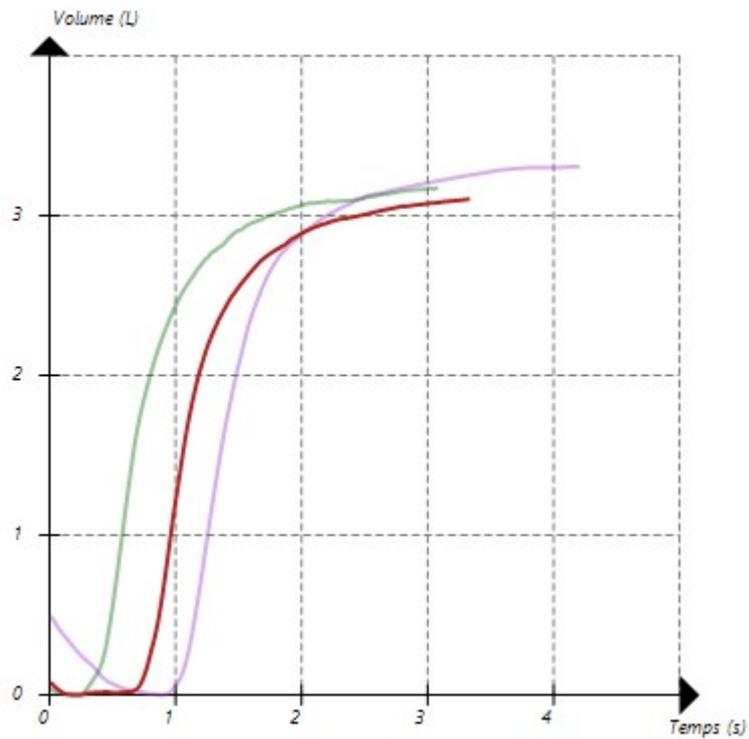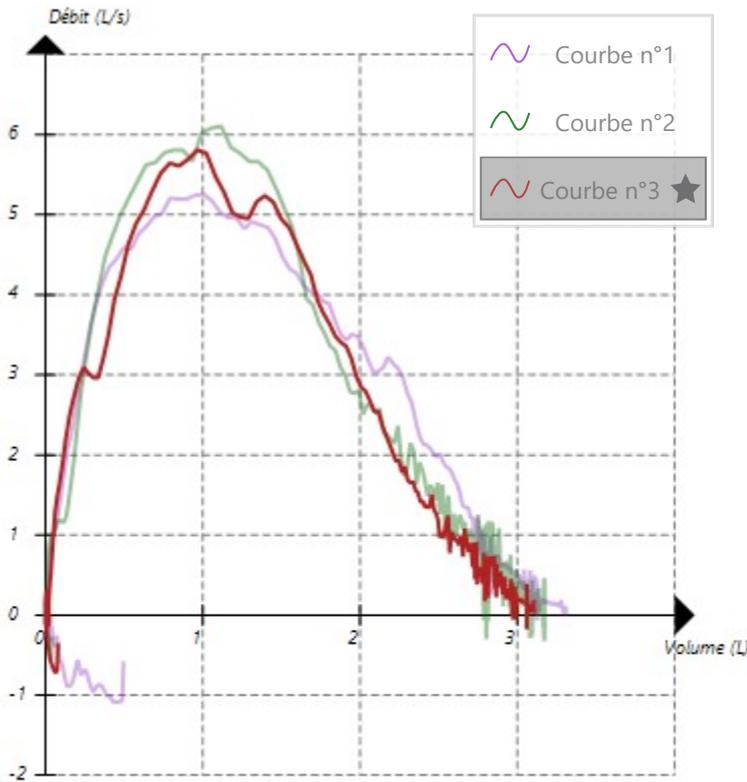

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,31 L	3,17 L	3,09 L	3,67 L	84,20 %
VEMS	2,92 L	2,85 L	2,77 L	3,01 L	92,03 %
DEP	5,33 L/s	6,15 L/s	5,88 L/s	8,04 L/s	73,13 %
VEMS/CVF	88,22 %	89,91 %	89,64 %	81,56 %	109,91 %
Durée d'expiration	3,30 s	2,80 s	2,83 s	-	
DEMM	3,84 L/s	3,73 L/s	3,79 L/s	3,25 L/s	116,62 %
DEMM/CVF	1,16 s-1	1,18 s-1	1,23 s-1	0,89 s-1	138,20 %
DE75	5,17 L/s	5,81 L/s	5,62 L/s	-	
DE50	4,02 L/s	4,69 L/s	4,84 L/s	-	
DE25	1,99 L/s	2,09 L/s	1,86 L/s	-	