

<b>Nom</b> DRAME	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> IBRAHIMA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 12/03/1993	<b>Profession</b> ELECTRICIEN
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 15	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 160 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 60 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Eccls/Zapletal	
<b>Opérateur</b> KEITA MARIAMA DALANDA	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,2 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 46 %

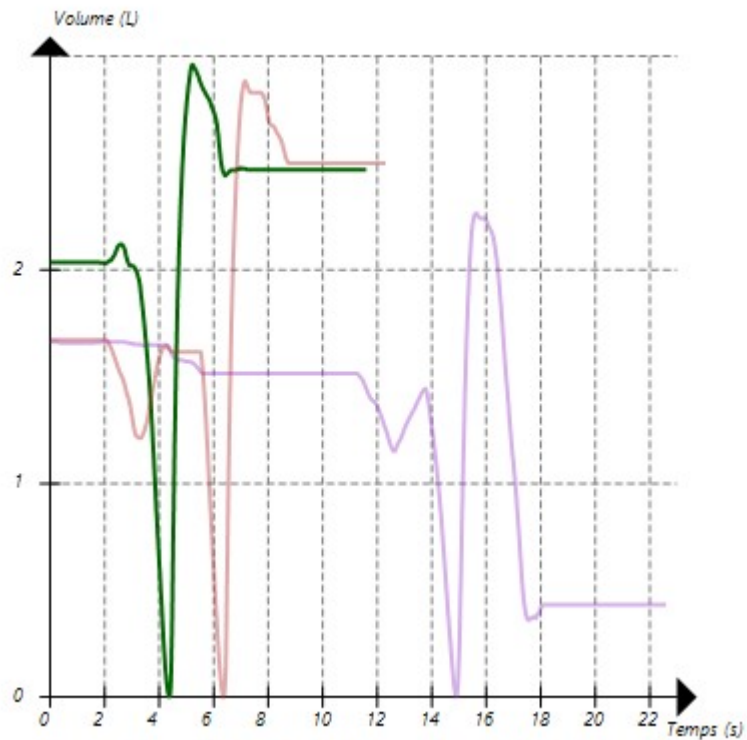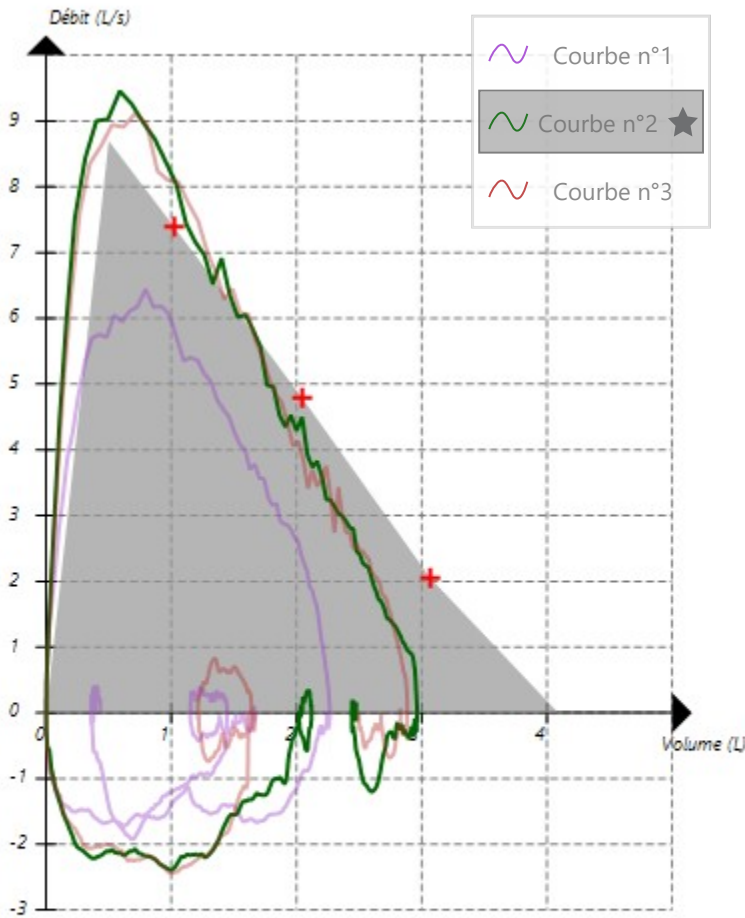

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,26 L	2,96 L	2,88 L	4,09 L	72,37 %
VEMS	2,26 L	2,96 L	2,88 L	3,52 L	84,09 %
DEP	6,51 L/s	9,52 L/s	9,30 L/s	8,70 L/s	109,43 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	81,84 %	122,19 %
Durée d'expiration	0,72 s	0,85 s	0,79 s	-	
DEMM	5,27 L/s	5,95 L/s	6,03 L/s	4,52 L/s	131,64 %
DEMM/CVF	2,33 s-1	2,01 s-1	2,09 s-1	1,11 s-1	181,08 %
DE75	5,97 L/s	8,91 L/s	9,30 L/s	7,39 L/s	120,57 %
DE50	5,24 L/s	6,43 L/s	6,22 L/s	4,79 L/s	134,24 %
DE25	3,54 L/s	3,40 L/s	3,25 L/s	2,05 L/s	165,85 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: