

<b>Nom</b> KOMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1997	<b>Profession</b> MECHANIC
<b>Age</b> 27 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1568	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 160 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 58 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,8 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 58 %

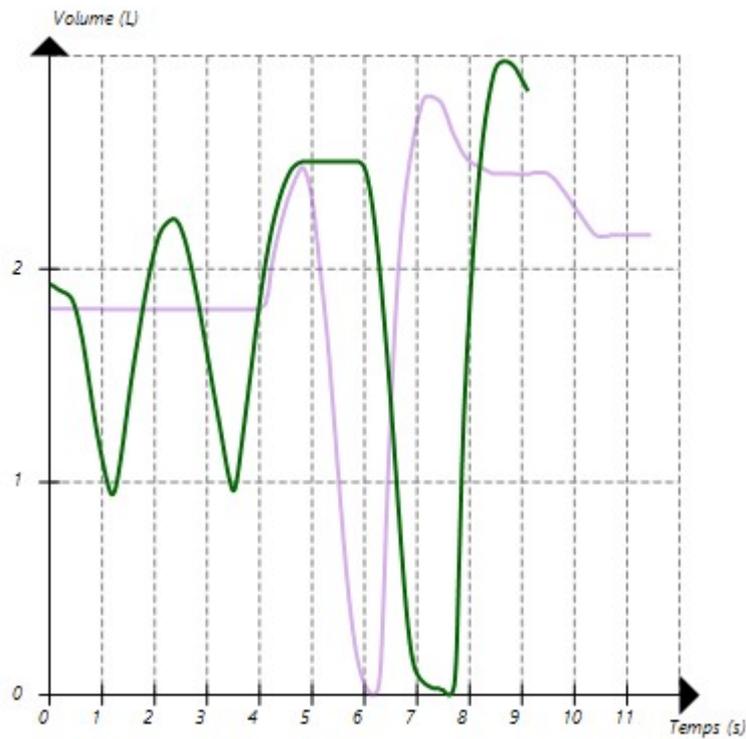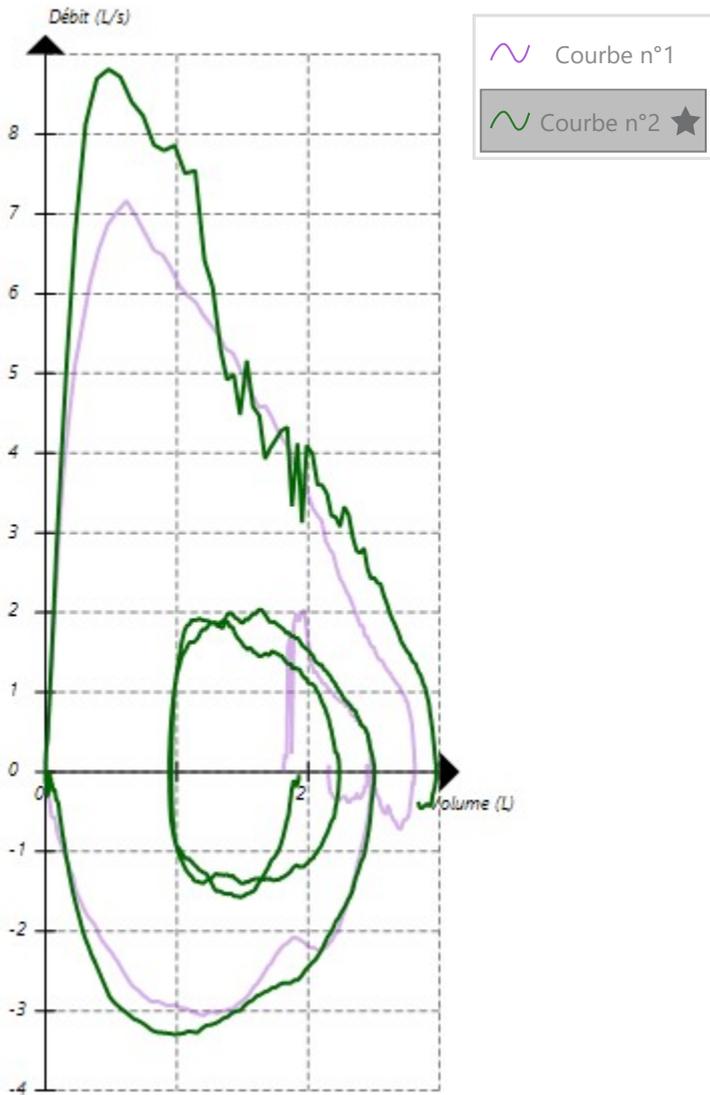

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,81 L	2,97 L	3,62 L	82,04 %
VEMS	2,81 L	2,97 L	3,10 L	95,81 %
DEP	7,20 L/s	8,87 L/s	8,12 L/s	109,24 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	84,30 %	118,62 %
Durée d'expiration	1,02 s	1,03 s	-	
DEMM	5,02 L/s	5,01 L/s	3,68 L/s	136,14 %
DEMM/CVF	1,79 s-1	1,69 s-1	1,02 s-1	165,69 %
DE75	6,86 L/s	8,18 L/s	-	
DE50	5,28 L/s	4,66 L/s	-	
DE25	3,09 L/s	3,03 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: