


<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> OUSMANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 20/01/1998	<b>Profession</b> MECHANIC
<b>Age</b> 26 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1555	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 65 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51


**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 32 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 60 %

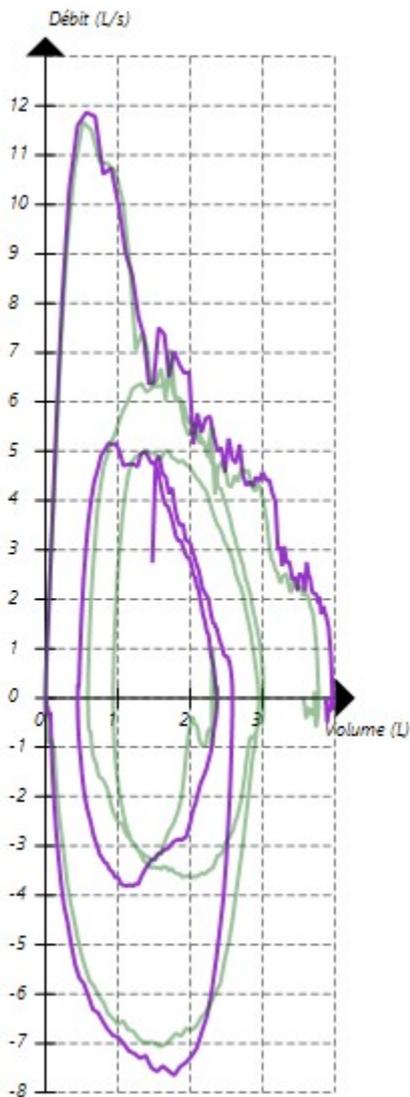

~ Courbe n°1 ★

~ Courbe n°2

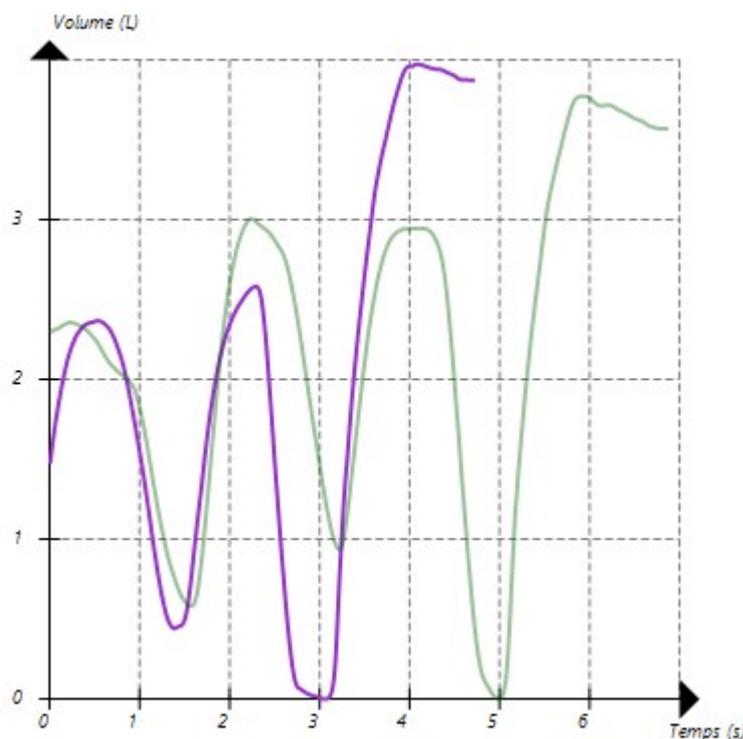

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	3,97 L	3,77 L	4,02 L	98,76 %
VEMS	3,97 L	3,77 L	3,42 L	116,08 %
DEP	12,46 L/s	11,87 L/s	8,79 L/s	141,75 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	84,49 %	118,36 %
Durée d'expiration	1,04 s	0,90 s	-	
DEMM	6,06 L/s	5,93 L/s	3,96 L/s	153,03 %
DEMM/CVF	1,53 s-1	1,57 s-1	0,99 s-1	154,55 %
DE75	10,11 L/s	10,79 L/s	-	
DE50	7,17 L/s	5,66 L/s	-	
DE25	4,52 L/s	4,18 L/s	-	

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: