

<b>Nom</b> CHERIF	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> IBRAHIMA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/09/1993	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 9596	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 159 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 56 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	




**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232707  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024

Température ambiante : 26,4 °C  
 Pression atmosphérique : 93,8 kPa  
 Humidité : 58 %

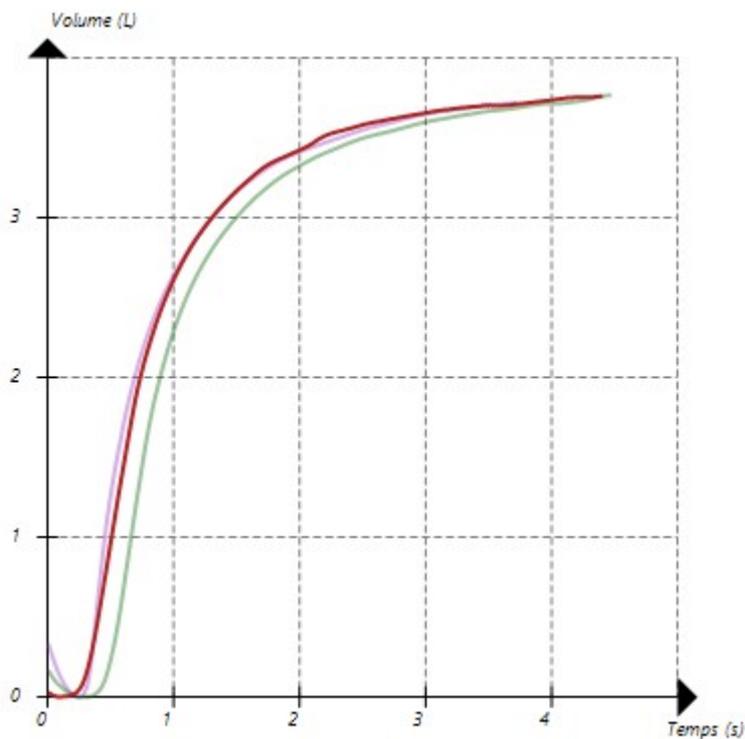

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,72 L	3,77 L	3,76 L	3,49 L	107,74 %
VEMS	3,01 L	2,98 L	3,00 L	2,96 L	101,35 %
DEP	7,66 L/s	5,33 L/s	4,89 L/s	7,87 L/s	62,13 %
VEMS/CVF	80,91 %	79,05 %	79,79 %	83,57 %	95,48 %
Durée d'expiration	3,49 s	4,22 s	4,33 s	-	
DEMM	2,78 L/s	2,80 L/s	2,90 L/s	3,48 L/s	83,33 %
DEMM/CVF	0,75 s-1	0,74 s-1	0,77 s-1	1,00 s-1	77,00 %
DE75	6,56 L/s	5,19 L/s	4,83 L/s	-	
DE50	3,32 L/s	3,24 L/s	3,76 L/s	-	
DE25	1,23 L/s	1,14 L/s	1,24 L/s	-	