

<b>Nom</b> KEMO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> TRAORE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2001	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 23 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 643	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 75 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 30,8 °C  
 Pression atmosphérique : 93,2 kPa  
 Humidité : 49 %

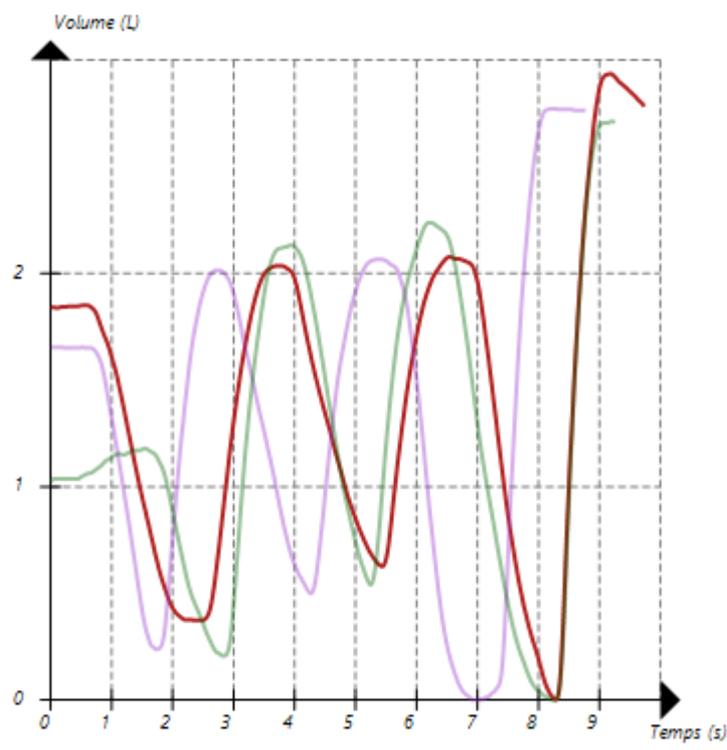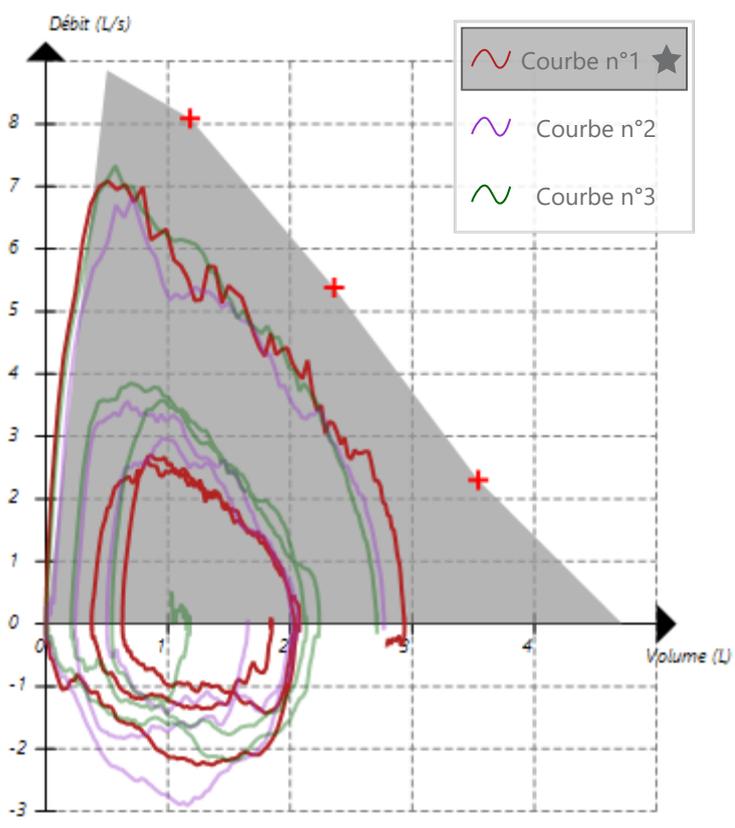

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,94 L	2,77 L	2,71 L	4,72 L	62,29 %
VEMS	2,94 L	2,77 L	2,71 L	4,06 L	72,41 %
DÉP	7,36 L/s	6,90 L/s	7,35 L/s	8,86 L/s	83,07 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	84,28 %	118,65 %
Durée d'expiration	0,89 s	1,10 s	0,96 s	-	
DEMM	5,19 L/s	5,00 L/s	5,56 L/s	4,58 L/s	113,32 %
DEMM/ CVF	1,77 s <sup>-1</sup>	1,81 s <sup>-1</sup>	2,05 s <sup>-1</sup>	0,97 s <sup>-1</sup>	182,47 %
DE75	6,97 L/s	6,90 L/s	6,86 L/s	8,09 L/s	86,16 %
DE50	5,45 L/s	5,24 L/s	5,62 L/s	5,38 L/s	101,30 %
DE25	3,86 L/s	3,41 L/s	4,16 L/s	2,30 L/s	167,83 %