

<b>Nom CISSE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom N'FALY</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/1996</b>	<b>Profession MANOEUVRE</b>
<b>Age 28 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 693</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 173 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 71 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30,9 °C


Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 58 %

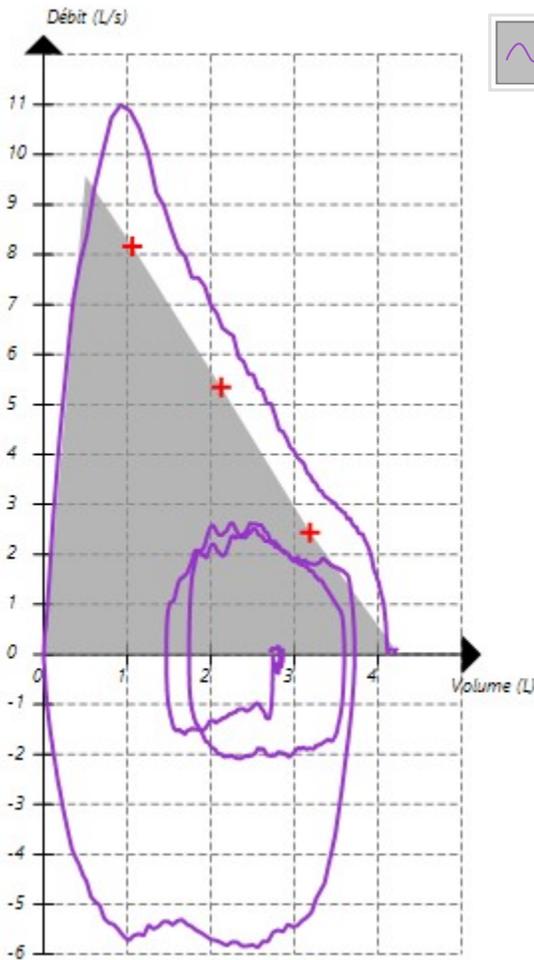

Courbe n°1 ★

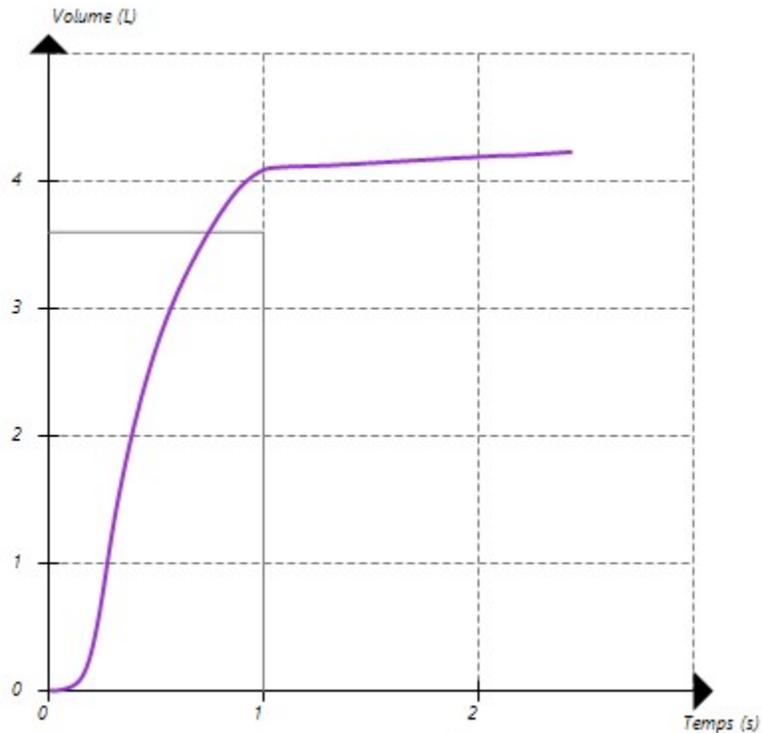

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,23 L	4,25 L	99,53 %
VEMS	4,12 L	3,60 L	114,44 %
DEP	11,07 L/s	9,58 L/s	115,55 %
VEMS/ CVF	97,40 %	82,20 %	118,49 %
Durée d'expiration	2,47 s	-	
DEMM	6,33 L/s	4,86 L/s	130,25 %
DEMM/ CVF	1,50 s-1	0,99 s-1	151,52 %
DE75	10,82 L/s	8,16 L/s	132,60 %
DE50	6,57 L/s	5,34 L/s	123,03 %
DE25	3,61 L/s	2,44 L/s	147,95 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: