

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> AMARA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1977	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 48 Ans	<b>Entreprise</b>
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 7960	<b>Fumeur</b> Ancien fumeur
<b>Taille</b> 178 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 78 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 6
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 26,3 °C  
 Pression atmosphérique : 94,6 kPa  
 Humidité : 72 %

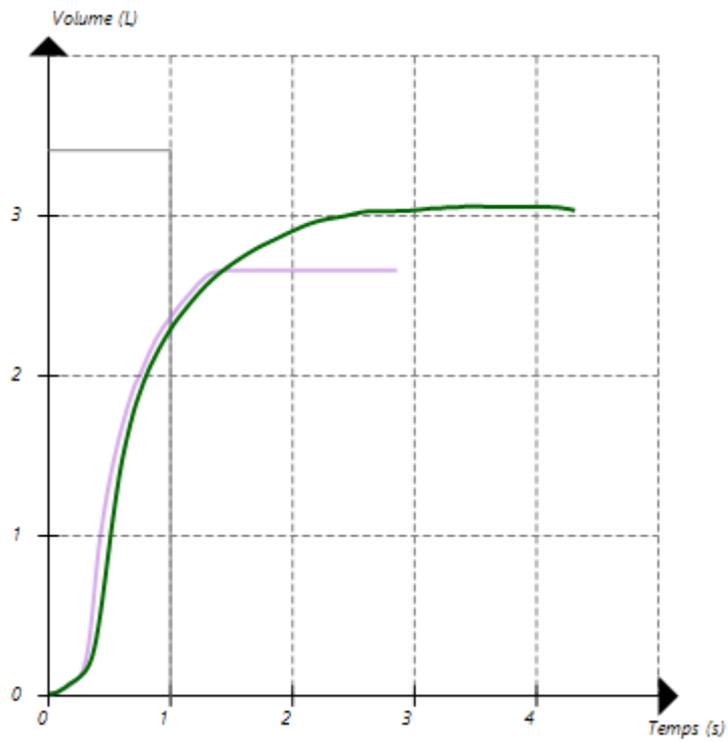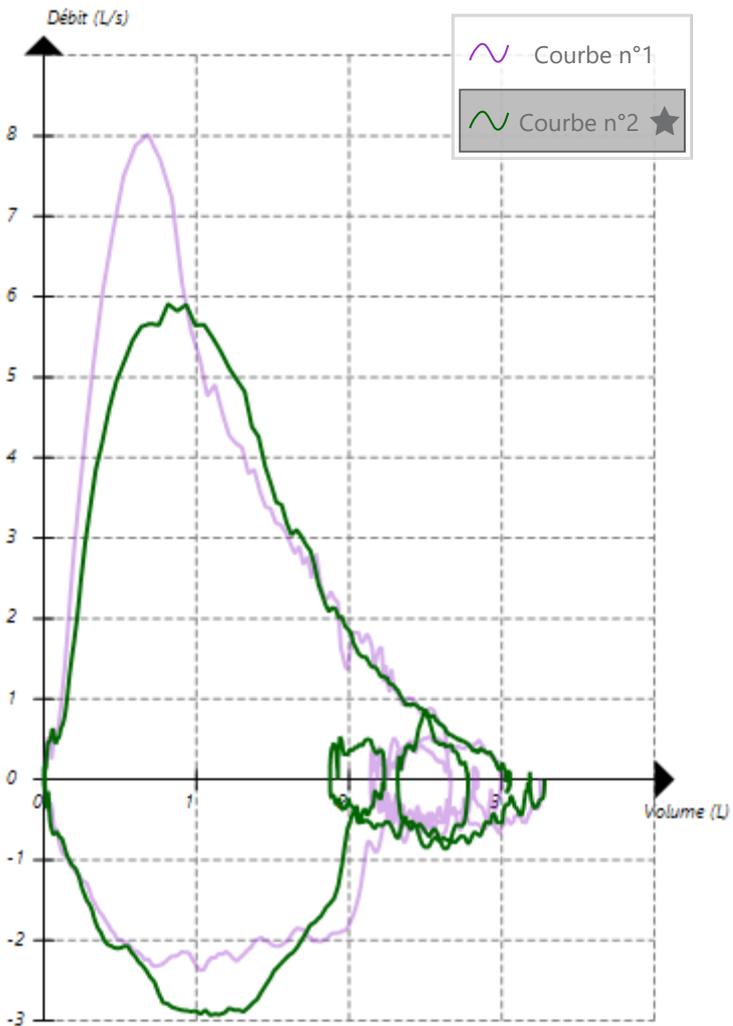

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,66 L	3,05 L	4,25 L	71,76 %
VEMS	2,62 L	2,59 L	3,41 L	75,95 %
DÉP	8,18 L/s	6,02 L/s	8,93 L/s	67,41 %
VEMS/ CVF	98,50 %	84,92 %	80,46 %	105,54 %
Durée d'expiration	1,52 s	3,49 s	-	
DEMM	3,65 L/s	2,86 L/s	3,43 L/s	83,38 %
DEMM/ CVF	1,37 s-1	0,94 s-1	0,81 s-1	116,05 %
DE75	8,04 L/s	5,54 L/s	-	
DE50	3,84 L/s	3,42 L/s	-	
DE25	1,29 L/s	1,19 L/s	-	