



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> LANCINE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/11/1994	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 3713	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 164 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 63 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 26 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 32 %

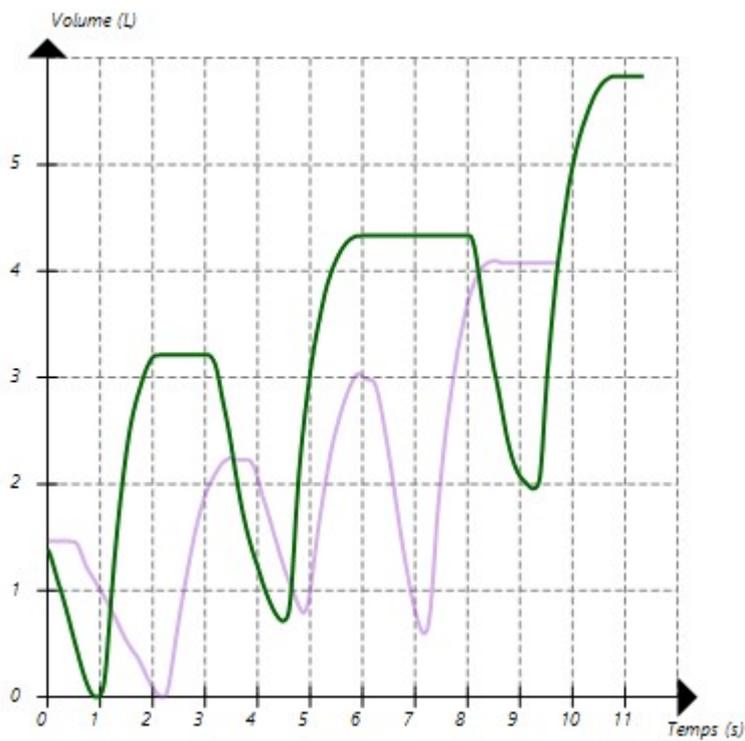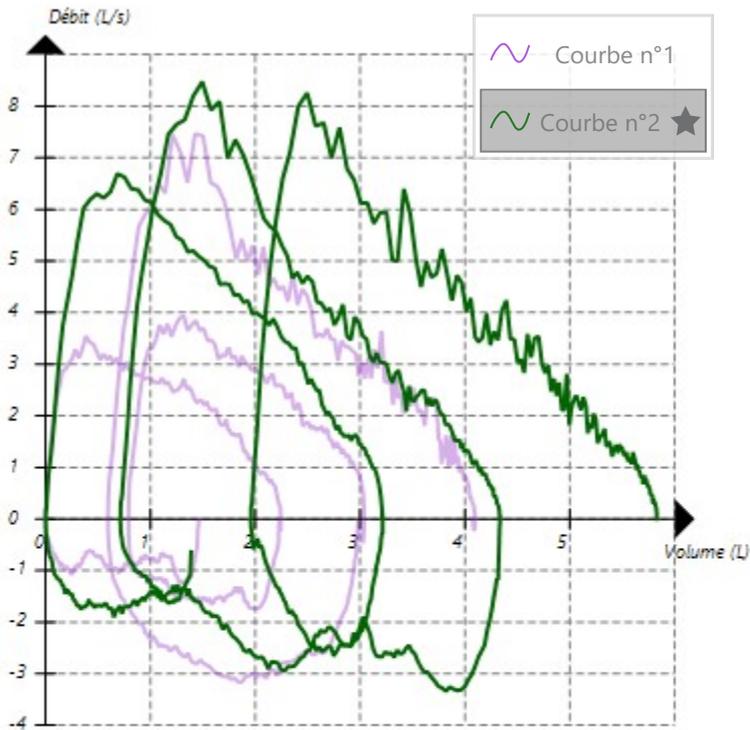

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,50 L	3,87 L	3,78 L	102,38 %
VEMS	3,43 L	3,64 L	3,20 L	113,75 %
DEP	8,06 L/s	8,65 L/s	8,35 L/s	103,59 %
VEMS/ CVF	98,00 %	94,06 %	83,76 %	112,30 %
Durée d'expiration	1,33 s	1,53 s	-	
DEMM	4,28 L/s	4,32 L/s	3,69 L/s	117,07 %
DEMM/ CVF	1,22 s-1	1,12 s-1	0,98 s-1	114,29 %
DE75	7,29 L/s	6,58 L/s	-	
DE50	5,08 L/s	4,79 L/s	-	
DE25	2,47 L/s	2,44 L/s	-	