

<b>Nom</b> SANGARE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/04/2000	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 24 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 01460	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 159 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> ITS (Crapo)	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Les prédits sélectionnés ne permettent pas de réaliser ce type d'interprétation.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,9 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 55 %

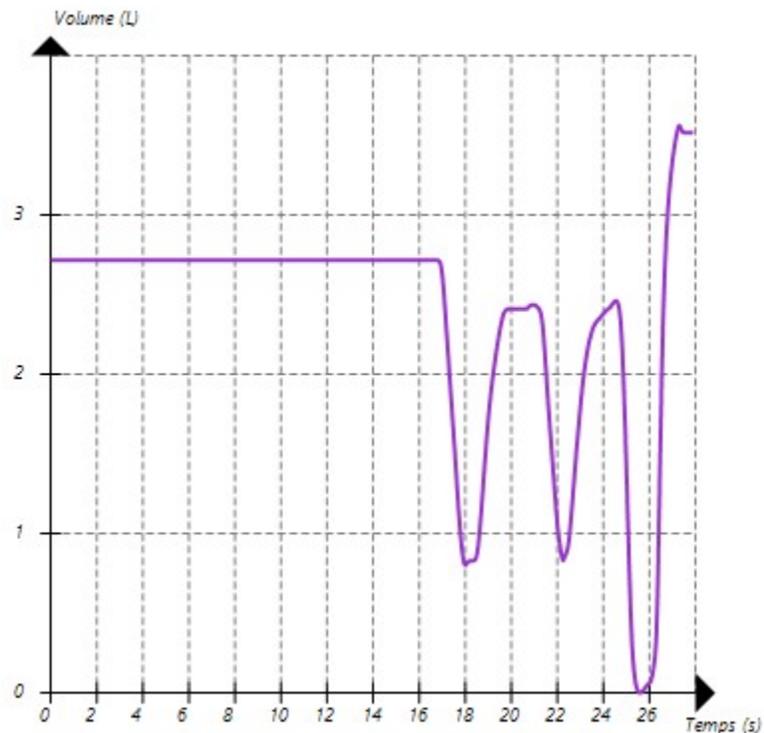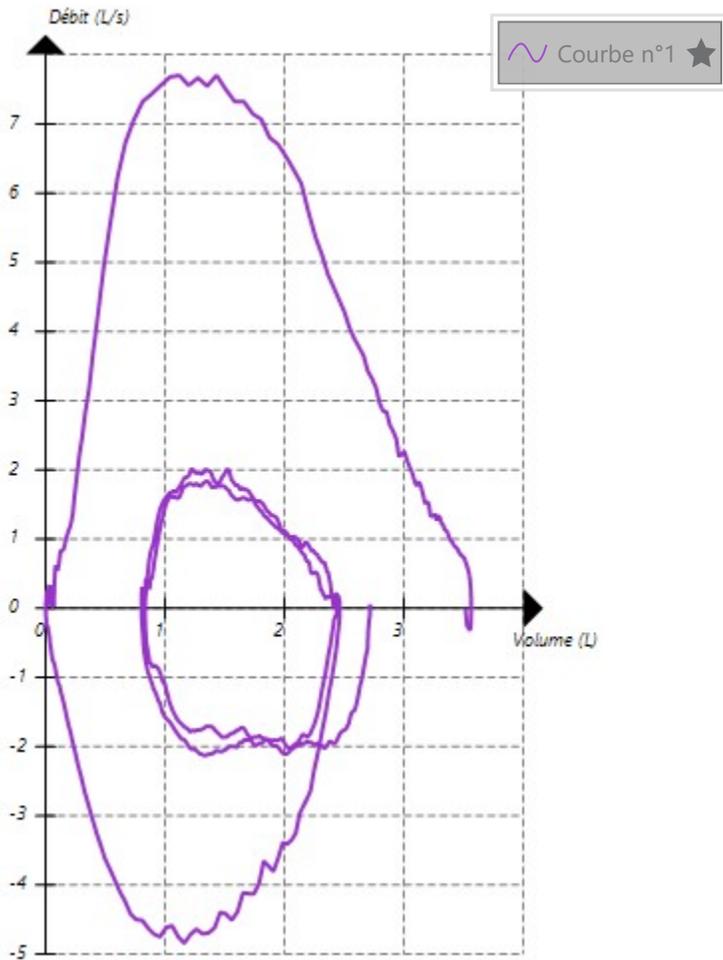

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,56 L	4,38 L	81,28 %
VEMS	3,56 L	3,81 L	93,44 %
DEP	7,78 L/s	-	-
VEMS/ CVF	100,00 %	86,17 %	116,05 %
Durée d'expiration	1,73 s	-	-
DEMM	6,32 L/s	4,46 L/s	141,70 %
DEMM/ CVF	1,78 s-1	1,02 s-1	174,51 %
DE75	7,49 L/s	-	-
DE50	7,05 L/s	-	-
DE25	3,53 L/s	-	-

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: