



<b>Nom</b> HABA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> GASTON	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 06/06/1994	<b>Profession</b> BUS DRIVER
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 10095	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 179 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 81 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 26,2 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 94,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 78 %

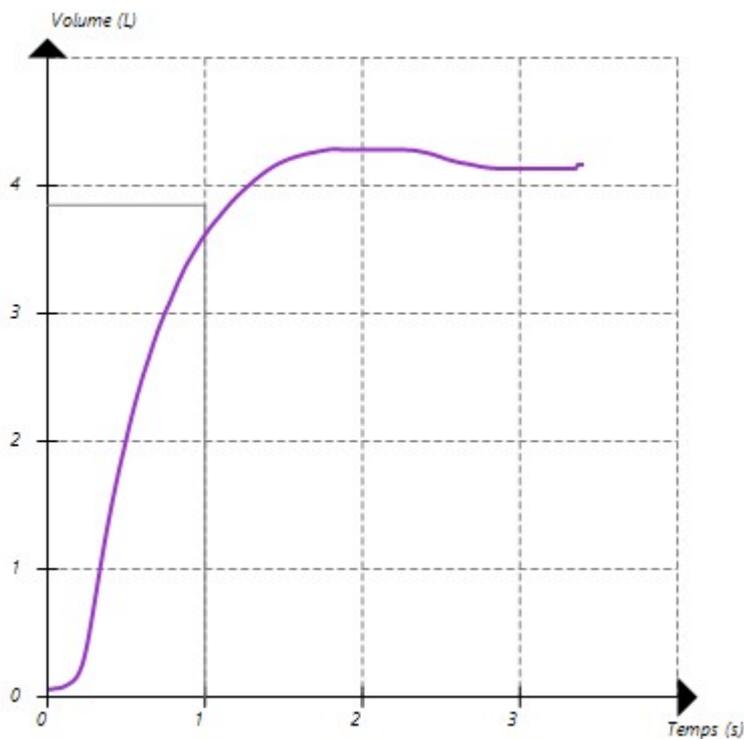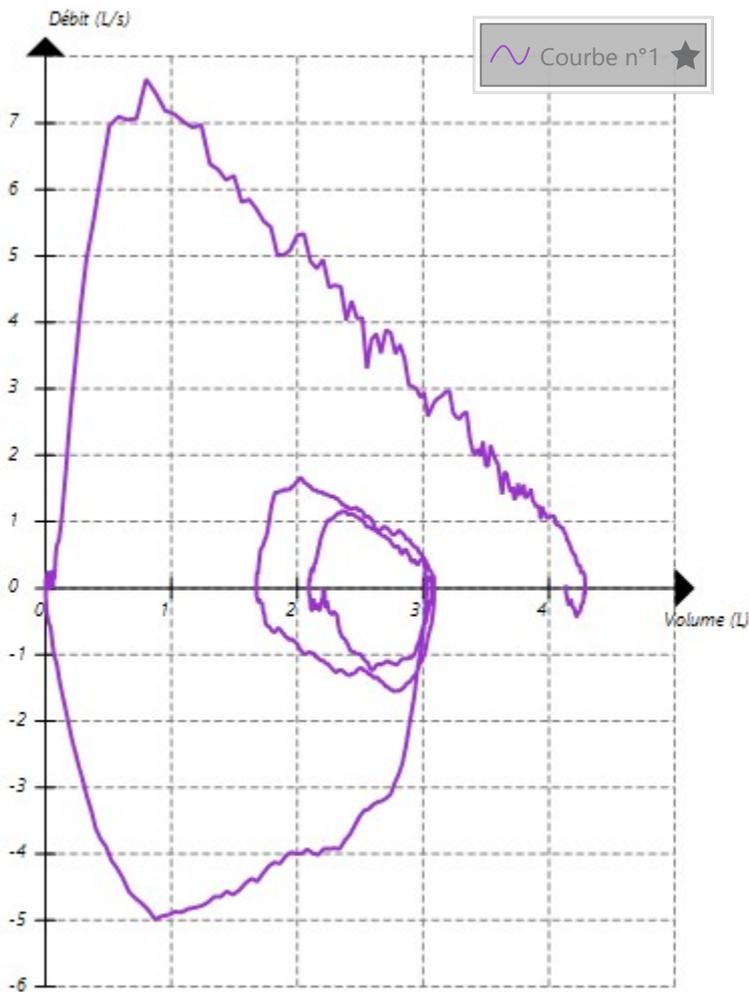

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,26 L	4,62 L	92,21 %
VEMS	3,89 L	3,85 L	101,04 %
DEP	7,85 L/s	9,72 L/s	80,76 %
VEMS/ CVF	91,31 %	83,57 %	109,26 %
Durée d'expiration	2,09 s	-	
DEMM	4,48 L/s	4,19 L/s	106,92 %
DEMM/ CVF	1,05 s-1	0,91 s-1	115,38 %
DE75	7,03 L/s	-	
DE50	4,71 L/s	-	
DE25	2,90 L/s	-	