

<b>Nom</b> BONAMOU	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABASS	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 27/02/1997	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 27 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 597	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 179 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 75 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30,2 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 54 %

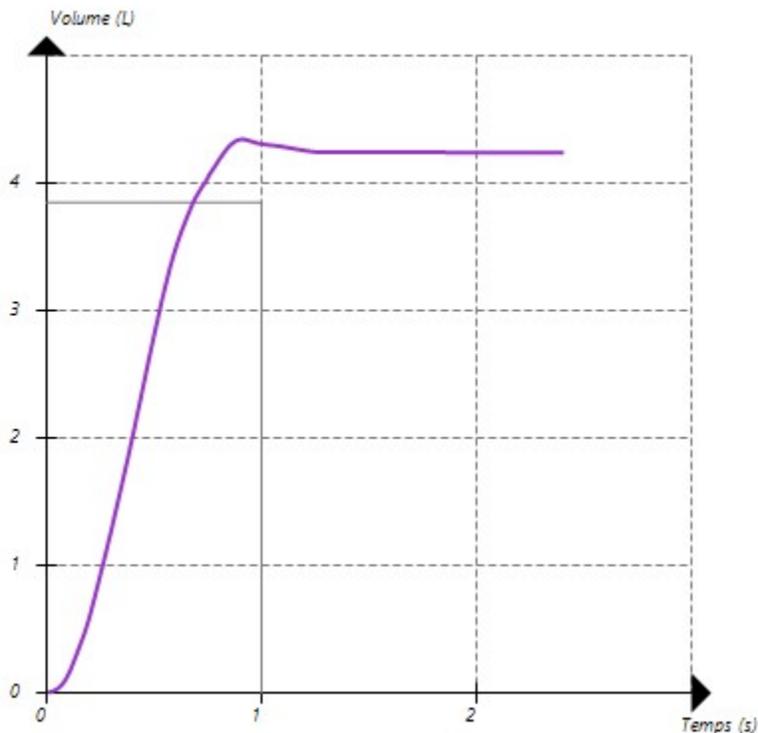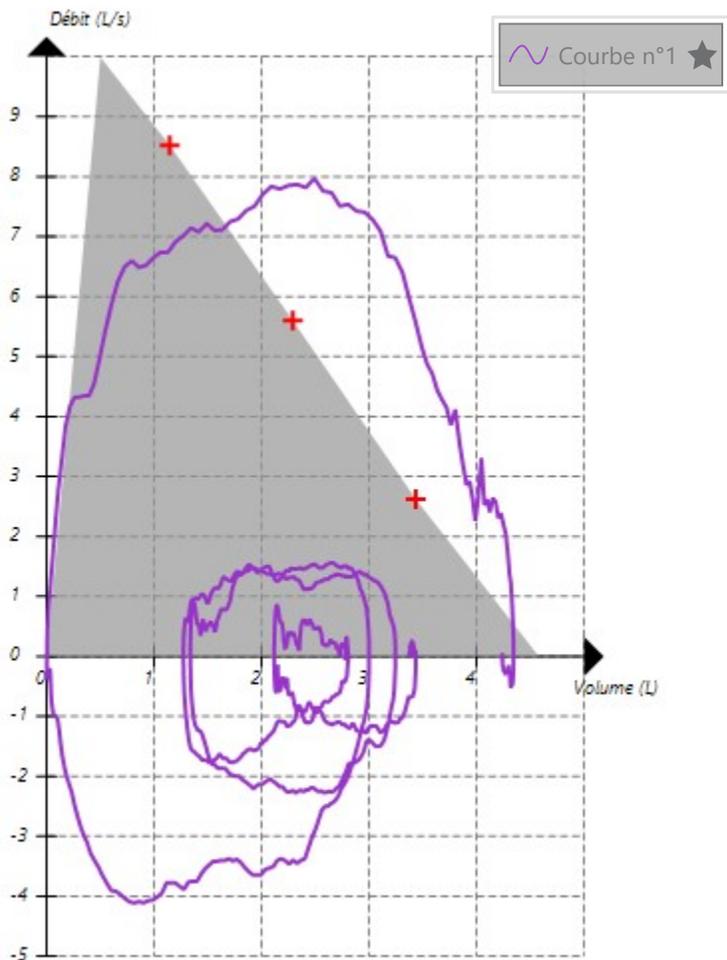

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,34 L	4,58 L	94,76 %
VEMS	4,34 L	3,85 L	112,73 %
DEP	8,04 L/s	9,99 L/s	80,48 %
VEMS/CVF	100,00 %	82,38 %	121,39 %
Durée d'expiration	0,98 s	-	
DEMM	7,54 L/s	5,02 L/s	150,20 %
DEMM/CVF	1,74 s-1	0,95 s-1	183,16 %
DE75	6,75 L/s	8,52 L/s	79,23 %
DE50	7,77 L/s	5,60 L/s	138,75 %
DE25	6,57 L/s	2,62 L/s	250,76 %