

<b>Nom</b> SQUARE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED ADAMA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/2004	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 21 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 3873	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 60 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30,9 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 33 %

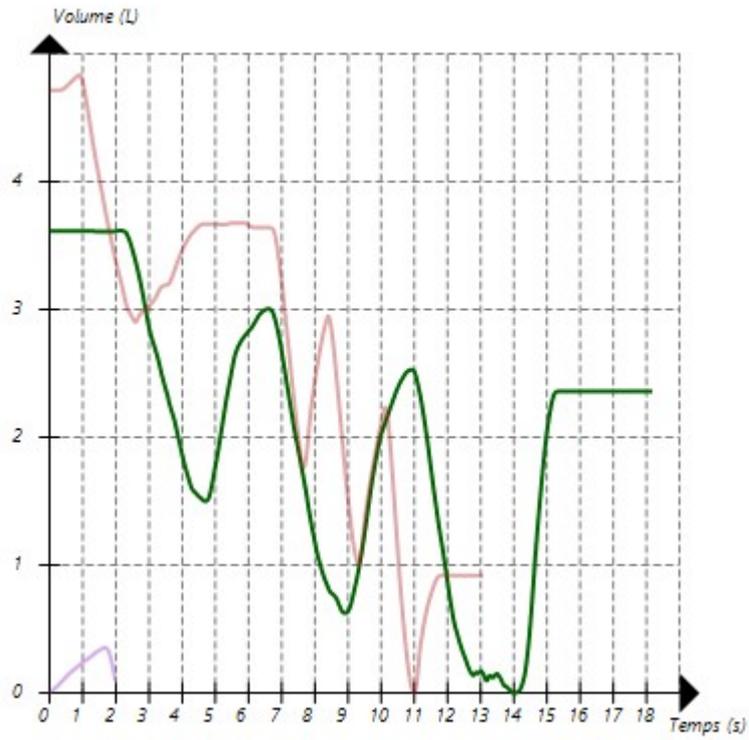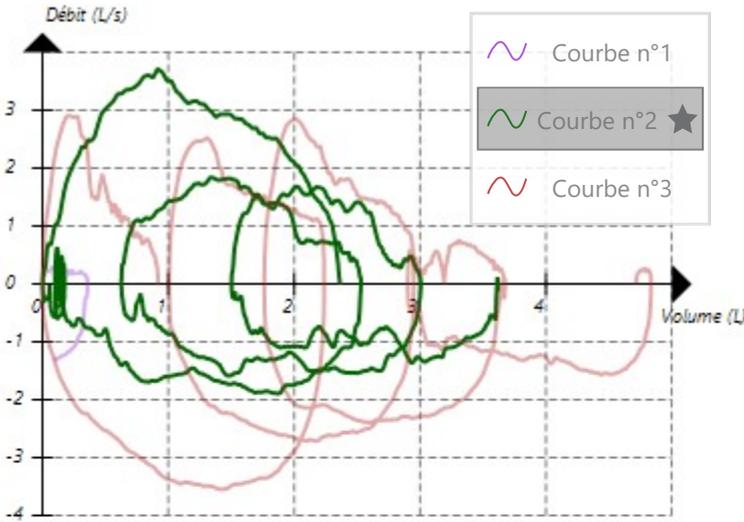

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	0,36 L	2,36 L	0,92 L	4,33 L	54,50 %
VEMS	0,25 L	2,36 L	0,92 L	3,71 L	63,61 %
DEP	0,32 L/s	3,74 L/s	2,99 L/s	9,36 L/s	39,96 %
VEMS/CVF	69,44 %	100,00 %	100,00 %	85,40 %	117,10 %
Durée d'expiration	1,66 s	1,36 s	0,78 s	-	
DEMM	0,23 L/s	3,19 L/s	1,64 L/s	4,32 L/s	73,84 %
DEMM/CVF	0,64 s-1	1,35 s-1	1,78 s-1	1,00 s-1	135,00 %
DE75	0,25 L/s	3,22 L/s	2,90 L/s	-	
DE50	0,21 L/s	3,17 L/s	1,86 L/s	-	
DE25	0,17 L/s	2,54 L/s	1,16 L/s	-	