


<b>Nom</b> SANOH	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MAMADY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 10/01/1999	<b>Profession</b> WELDER
<b>Age</b> 25 Ans	<b>Entreprise</b> CR 18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1550	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 62 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 32 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 59 %

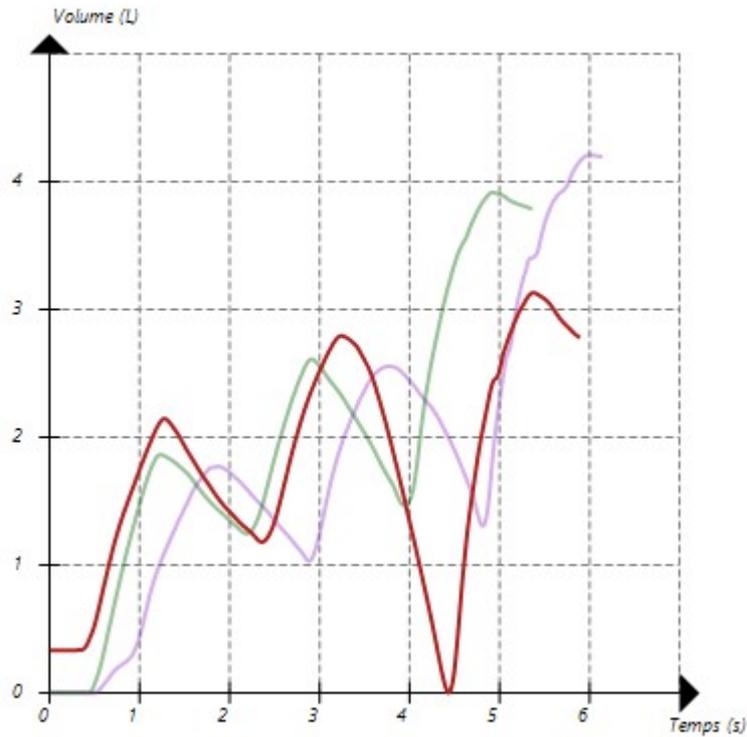

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,90 L	2,44 L	3,13 L	4,03 L	77,67 %
VEMS	2,81 L	2,44 L	3,13 L	3,44 L	90,99 %
DEP	7,89 L/s	6,05 L/s	8,37 L/s	8,83 L/s	94,79 %
VEMS/CVF	96,90 %	100,00 %	100,00 %	84,67 %	118,11 %
Durée d'expiration	1,18 s	0,98 s	0,94 s	-	
DEMM	3,00 L/s	3,53 L/s	4,93 L/s	4,01 L/s	122,94 %
DEMM/CVF	1,03 s-1	1,45 s-1	1,58 s-1	1,00 s-1	158,00 %
DE75	5,62 L/s	5,50 L/s	8,05 L/s	-	
DE50	4,05 L/s	3,42 L/s	4,62 L/s	-	
DE25	3,41 L/s	2,41 L/s	3,45 L/s	-	