



<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> OUMAR	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 30/05/1994	<b>Profession</b> DUMP TRCUK
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 222	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 177 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 62 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 1
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30,8 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,5 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 50 %

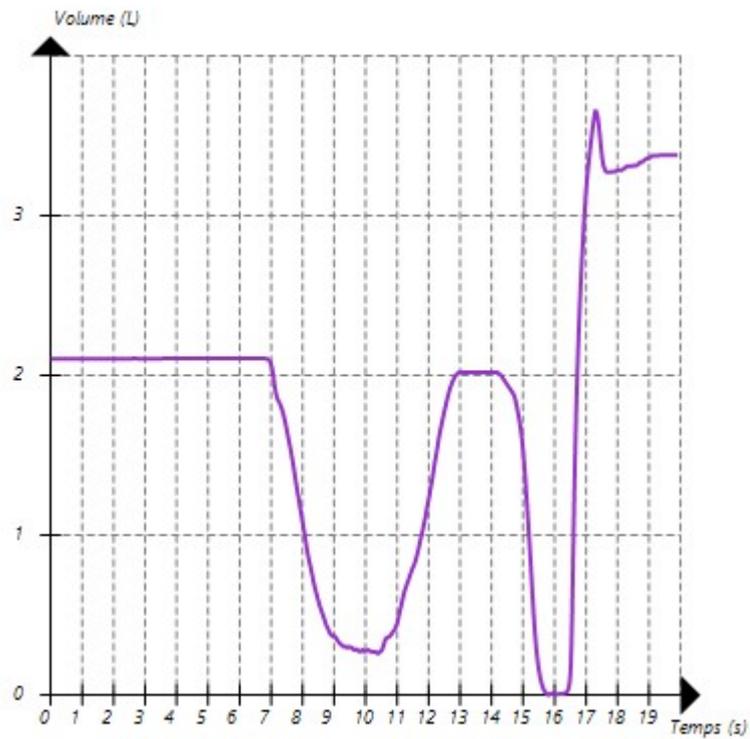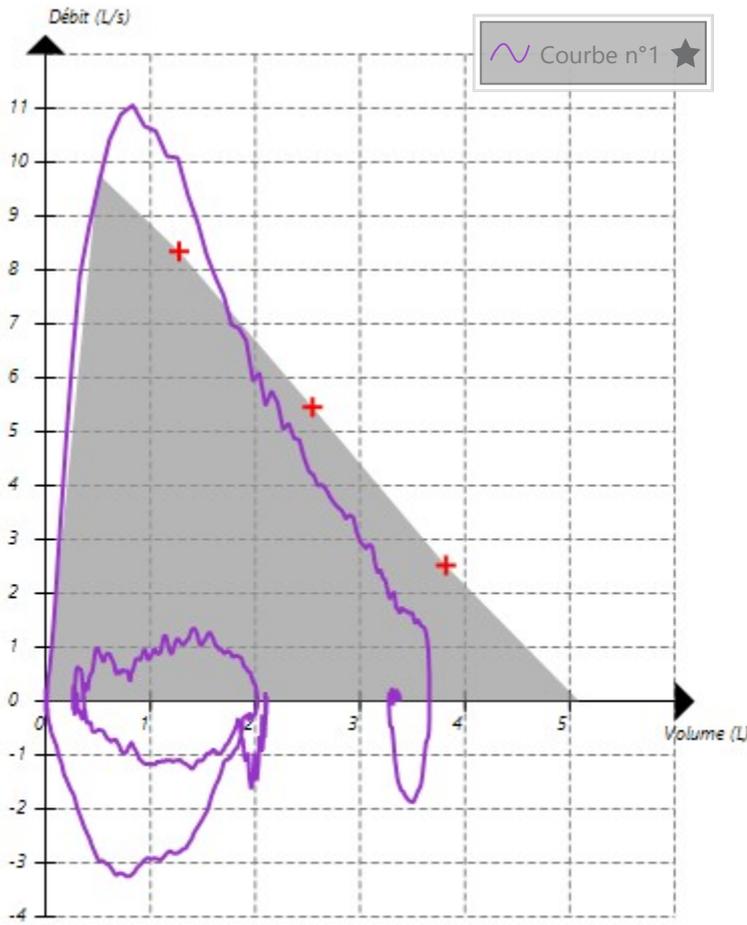

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,65 L	5,09 L	71,71 %
VEMS	3,65 L	4,28 L	85,28 %
DEP	11,27 L/s	9,79 L/s	115,12 %
VEMS/ CVF	100,00 %	82,02 %	121,92 %
Durée d'expiration	1,08 s	-	
DEMM	6,53 L/s	4,89 L/s	133,54 %
DEMM/ CVF	1,79 s-1	0,96 s-1	186,46 %
DE75	10,81 L/s	8,35 L/s	129,46 %
DE50	6,94 L/s	5,46 L/s	127,11 %
DE25	3,59 L/s	2,52 L/s	142,46 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: