

<b>Nom</b> KEITA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1983	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 41 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 01457	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 159 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> ITS (Crapo)	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> admin admin	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Les prédits sélectionnés ne permettent pas de réaliser ce type d'interprétation.


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,4 °C


Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 55 %

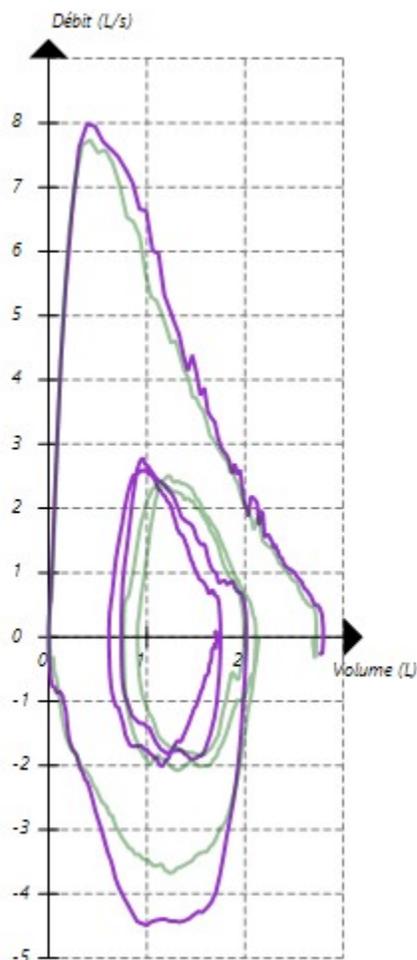

~ Courbe n°1 ★  
~ Courbe n°2

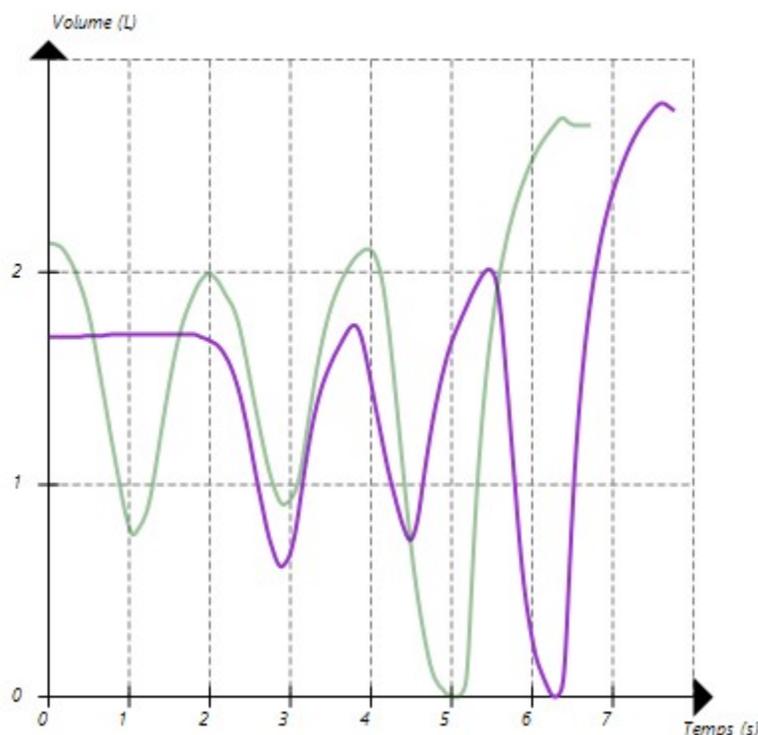

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	2,80 L	2,72 L	4,01 L	69,83 %
VEMS	2,71 L	2,64 L	3,39 L	79,94 %
DEP	8,11 L/s	7,90 L/s	-	-
VEMS/CVF	96,79 %	97,06 %	83,59 %	115,79 %
Durée d'expiration	1,32 s	1,29 s	-	-
DEMM	4,01 L/s	3,87 L/s	3,82 L/s	104,97 %
DEMM/CVF	1,43 s-1	1,42 s-1	0,95 s-1	150,53 %
DE75	7,57 L/s	7,26 L/s	-	-
DE50	4,16 L/s	4,20 L/s	-	-
DE25	2,12 L/s	1,88 L/s	-	-