

<b>Nom</b> ZHANG	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> FANGIGJIE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/11/1980	<b>Profession</b> CHARPENTIER
<b>Age</b> 44 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 4893	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 175 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 74 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,1 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 93,5 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 53 %

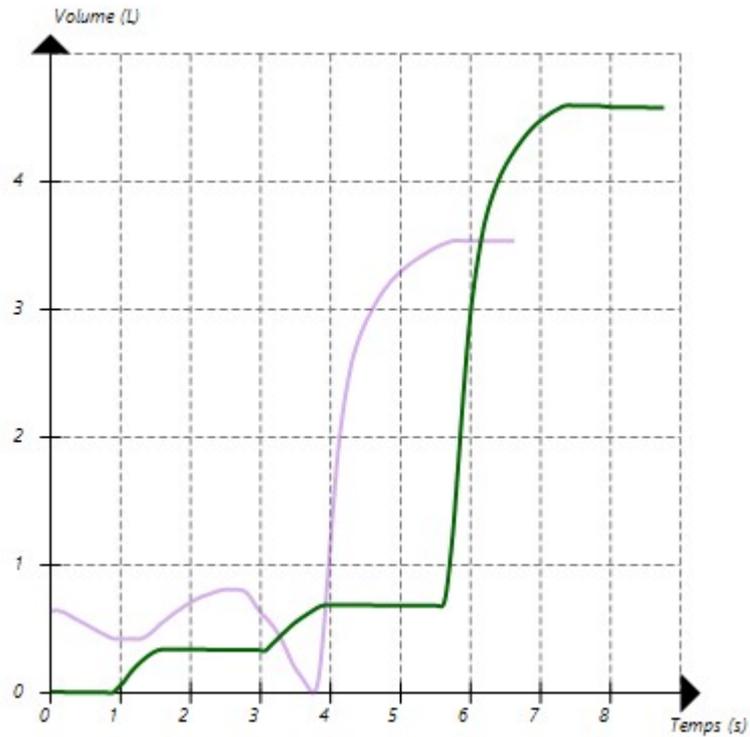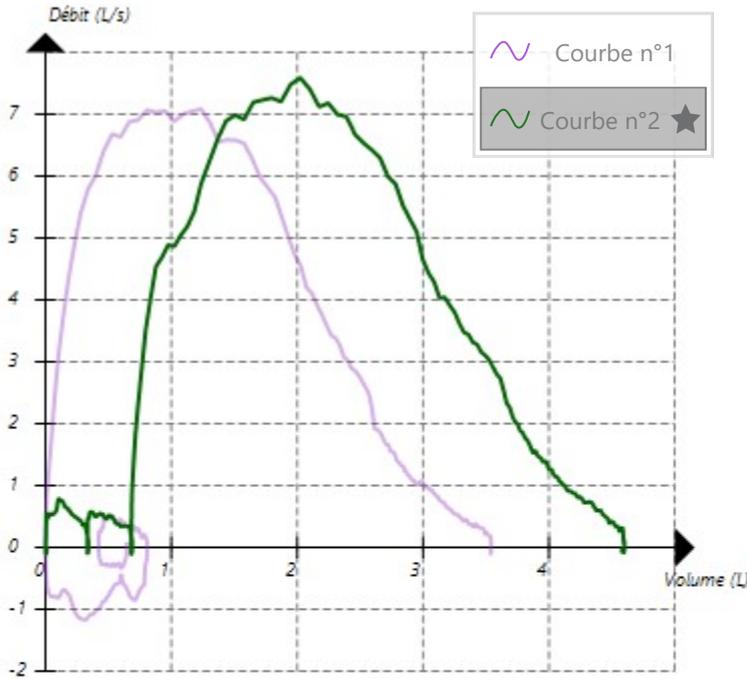

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,54 L	3,92 L	5,02 L	78,09 %
VEMS	3,20 L	3,60 L	3,96 L	90,91 %
DEP	7,26 L/s	7,70 L/s	9,82 L/s	78,41 %
VEMS/ CVF	90,40 %	91,84 %	78,98 %	116,28 %
Durée d'expiration	2,02 s	1,83 s	-	
DEMM	4,66 L/s	5,28 L/s	3,67 L/s	143,87 %
DEMM/ CVF	1,32 s-1	1,35 s-1	0,73 s-1	184,93 %
DE75	6,97 L/s	7,19 L/s	-	
DE50	5,83 L/s	6,32 L/s	-	
DE25	1,84 L/s	2,78 L/s	-	