

<b>Nom</b> KABA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> CHERIF	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1994	<b>Profession</b> ASSISTANT MECANIQUE
<b>Age</b> 31 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 3746	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 88 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 30,8 °C

Numéro de série : 232697

Pression atmosphérique : 93,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 27 %

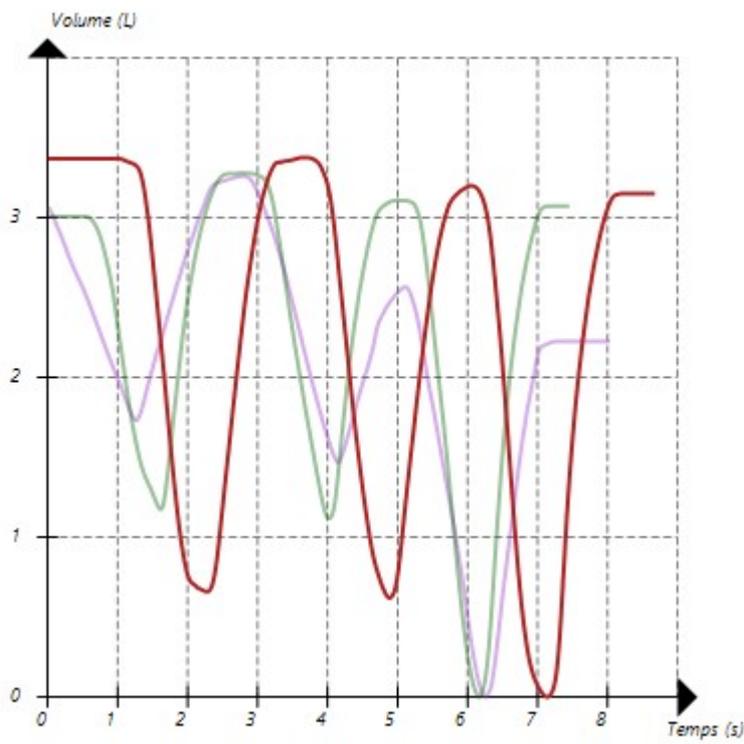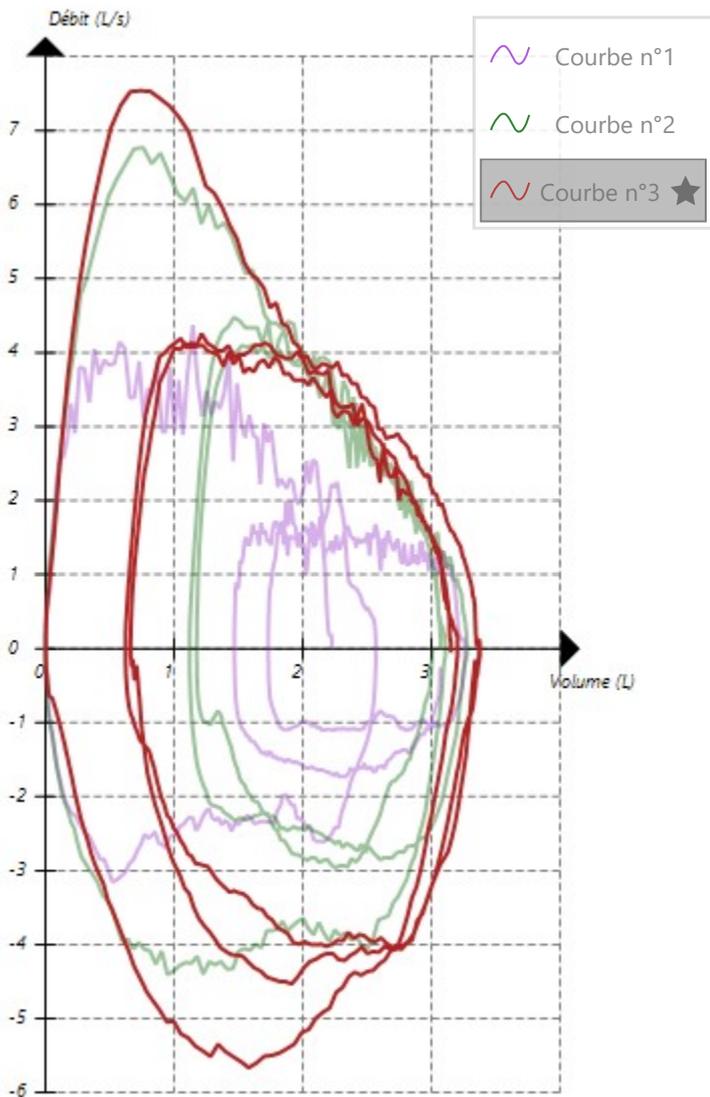

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,23 L	3,07 L	3,15 L	3,93 L	80,15 %
VEMS	2,23 L	3,07 L	3,15 L	3,30 L	95,45 %
DEP	4,71 L/s	6,96 L/s	7,62 L/s	8,58 L/s	88,81 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	83,57 %	119,66 %
Durée d'expiration	0,98 s	0,97 s	1,06 s	-	
DEMM	3,42 L/s	4,96 L/s	5,03 L/s	3,75 L/s	134,13 %
DEMM/ CVF	1,53 s-1	1,62 s-1	1,60 s-1	0,95 s-1	168,42 %
DE75	4,17 L/s	6,69 L/s	7,49 L/s	-	
DE50	3,71 L/s	5,09 L/s	5,22 L/s	-	
DE25	2,15 L/s	3,12 L/s	3,46 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: