

<b>Nom</b> DOUNOH	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 19/04/1997	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 27 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 913	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 166 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 67 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 28,2 °C  
 Pression atmosphérique : 92,9 kPa  
 Humidité : 44 %

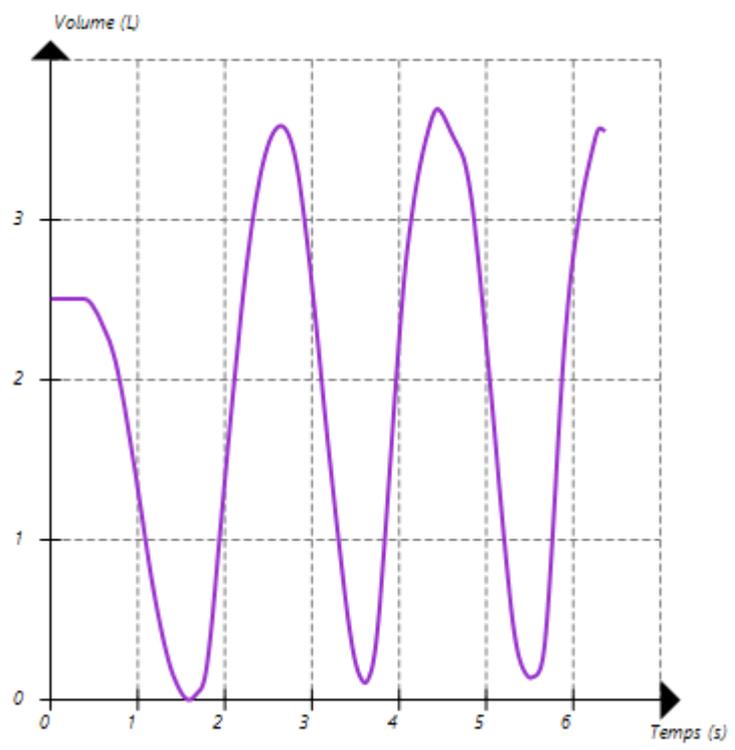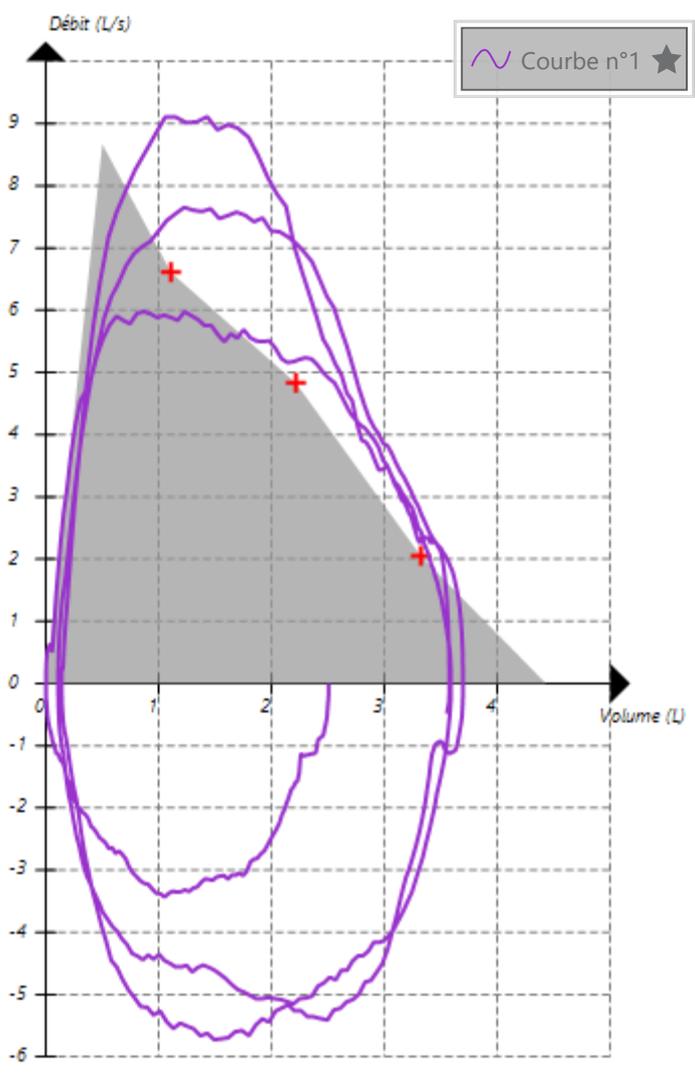

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,44 L	4,43 L	77,65 %
VEMS	3,44 L	3,74 L	91,98 %
DÉP	9,21 L/s	8,67 L/s	106,23 %
VEMS/CVF	100,00 %	83,86 %	119,25 %
Durée d'expiration	0,80 s	-	
DEMM	7,57 L/s	4,11 L/s	184,18 %
DEMM/CVF	2,20 s <sup>-1</sup>	0,93 s <sup>-1</sup>	236,56 %
DE75	9,00 L/s	6,61 L/s	136,16 %
DE50	8,58 L/s	4,83 L/s	177,64 %
DE25	4,51 L/s	2,05 L/s	220,00 %