



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABDOULAYE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 30/01/1976	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 48 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> MANOEUVRE
<b>ID</b> 1666	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 86 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,8 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,7 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 59 %

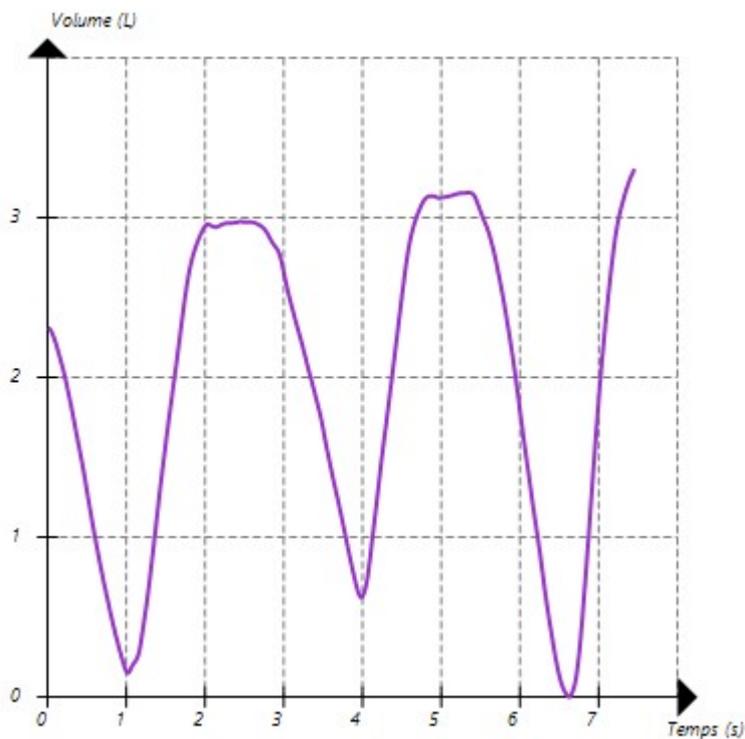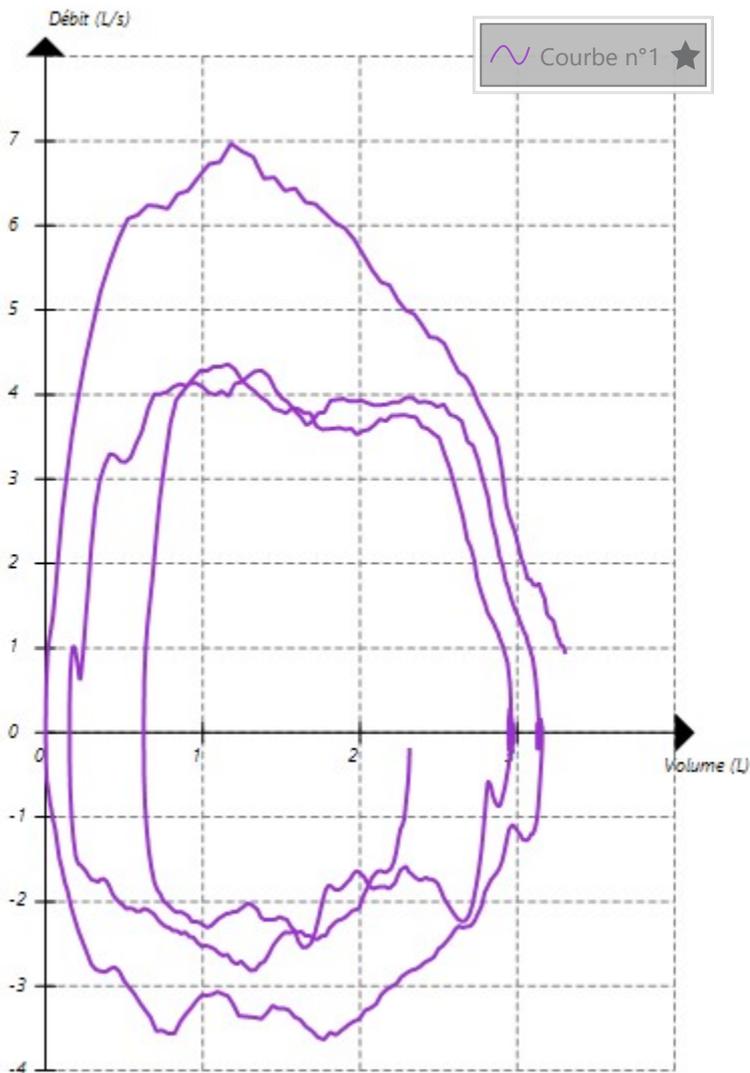

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,32 L	3,62 L	91,71 %
VEMS	3,32 L	2,91 L	114,09 %
DEP	7,11 L/s	7,89 L/s	90,11 %
VEMS/CVF	100,00 %	80,46 %	124,29 %
Durée d'expiration	0,84 s	-	
DEMM	6,10 L/s	3,03 L/s	201,32 %
DEMM/CVF	1,84 s-1	0,84 s-1	219,05 %
DE75	6,40 L/s	-	
DE50	6,26 L/s	-	
DE25	4,65 L/s	-	