

<b>Nom</b> SANOH	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MORY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 21/07/1996	<b>Profession</b> GRADER OPERTOR
<b>Age</b> 28 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 3810	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 165 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 66 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un syndrome des petites voies aériennes.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,2 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 93,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 27 %

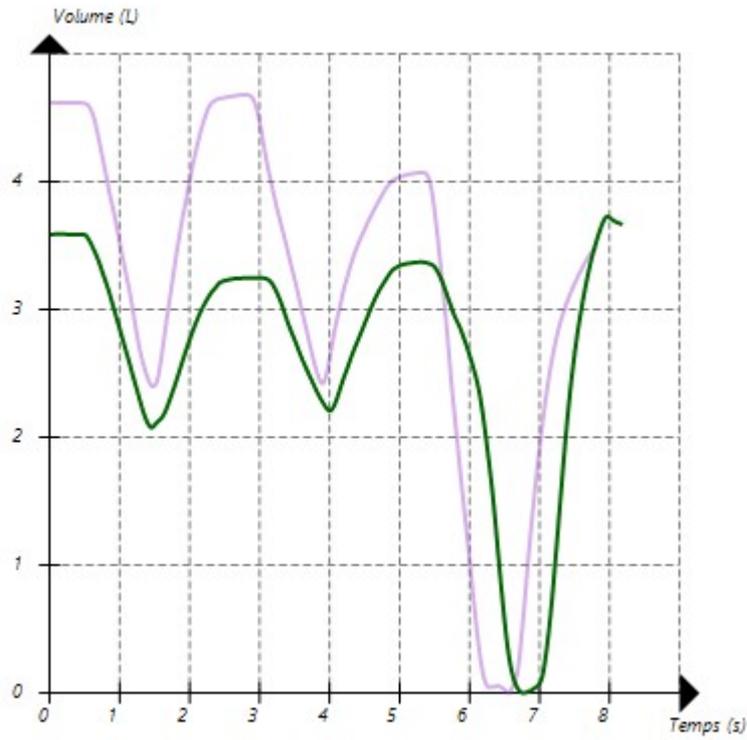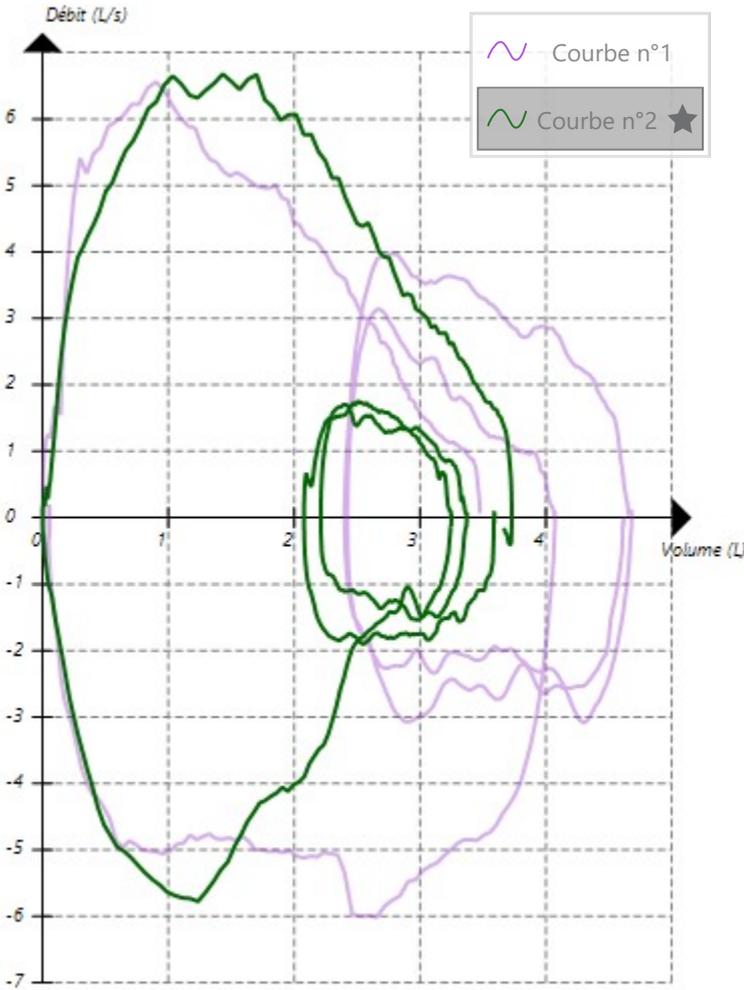

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,48 L	3,73 L	3,87 L	96,38 %
VEMS	3,39 L	3,73 L	3,29 L	113,37 %
DEP	6,64 L/s	6,78 L/s	8,52 L/s	79,58 %
VEMS/ CVF	97,41 %	100,00 %	84,12 %	118,88 %
Durée d'expiration	1,26 s	1,20 s	-	
DEMM	4,73 L/s	5,72 L/s	3,81 L/s	150,13 %
DEMM/ CVF	1,36 s-1	1,53 s-1	0,98 s-1	156,12 %
DE75	6,42 L/s	6,45 L/s	-	
DE50	4,97 L/s	5,97 L/s	-	
DE25	2,93 L/s	3,60 L/s	-	