

<b>Nom</b> TRAORE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ALIA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 26/08/1993	<b>Profession</b> ELECTRICIEN
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 908	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 175 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 66 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Knudson	
<b>Opérateur</b> admin admin	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 28,3 °C  
 Pression atmosphérique : 93,1 kPa  
 Humidité : 45 %

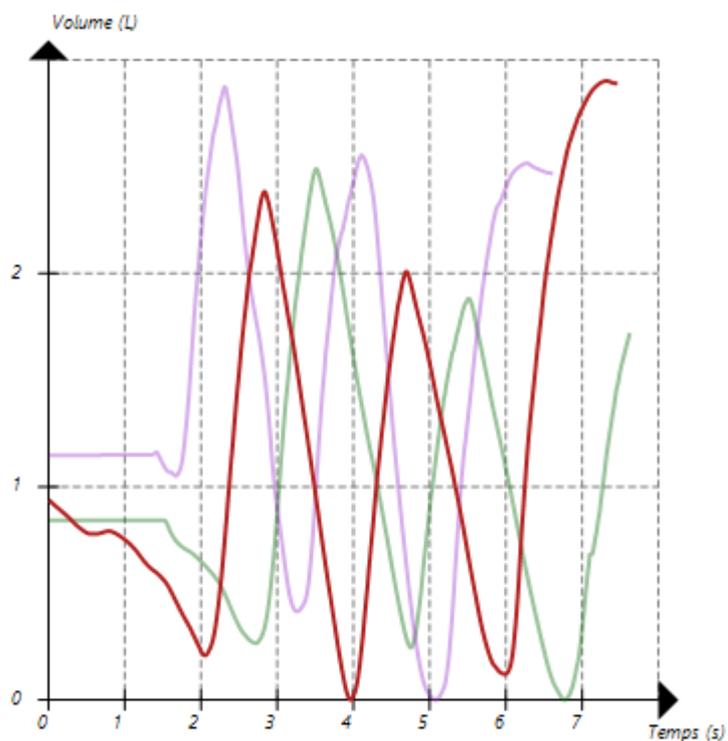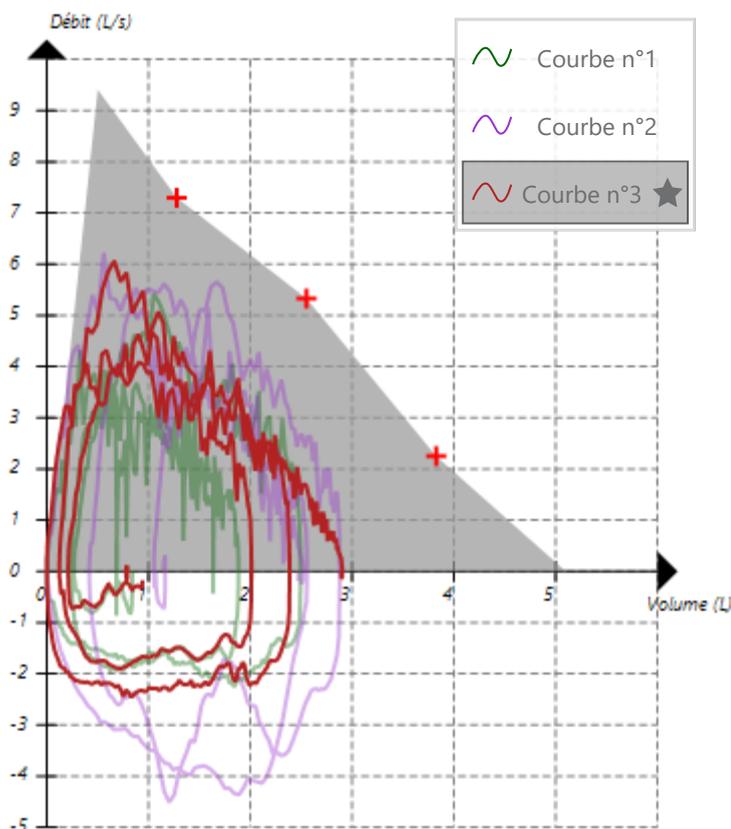

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,23 L	2,52 L	2,78 L	5,10 L	54,51 %
VEMS	2,23 L	2,51 L	2,71 L	4,25 L	63,76 %
DÉP	6,03 L/s	6,65 L/s	6,79 L/s	9,41 L/s	72,16 %
VEMS/CVF	100,00 %	99,60 %	97,48 %	83,55 %	116,67 %
Durée d'expiration	0,80 s	1,19 s	1,34 s	-	
DEMM	4,03 L/s	3,69 L/s	3,49 L/s	4,52 L/s	77,21 %
DEMM/CVF	1,81 s <sup>-1</sup>	1,46 s <sup>-1</sup>	1,26 s <sup>-1</sup>	0,89 s <sup>-1</sup>	141,57 %
DE75	4,01 L/s	5,24 L/s	5,88 L/s	7,30 L/s	80,55 %
DE50	4,22 L/s	3,86 L/s	3,20 L/s	5,33 L/s	60,04 %
DE25	2,97 L/s	2,84 L/s	1,65 L/s	2,25 L/s	73,33 %