

<b>Nom</b> PIVI	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> HELENE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 24/02/1996	<b>Profession</b> CLEANER
<b>Age</b> 28 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Féminin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 654	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 157 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 53 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 29 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 57 %

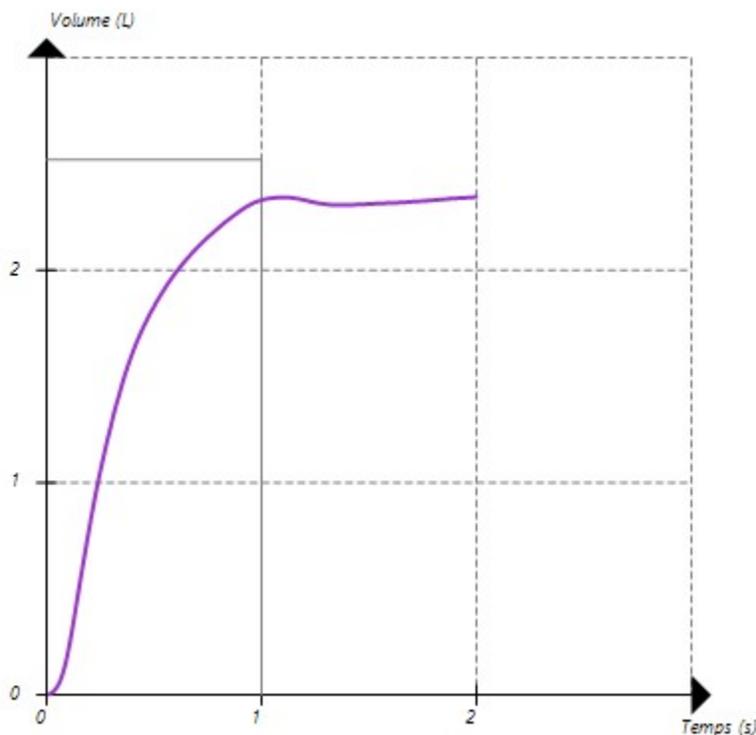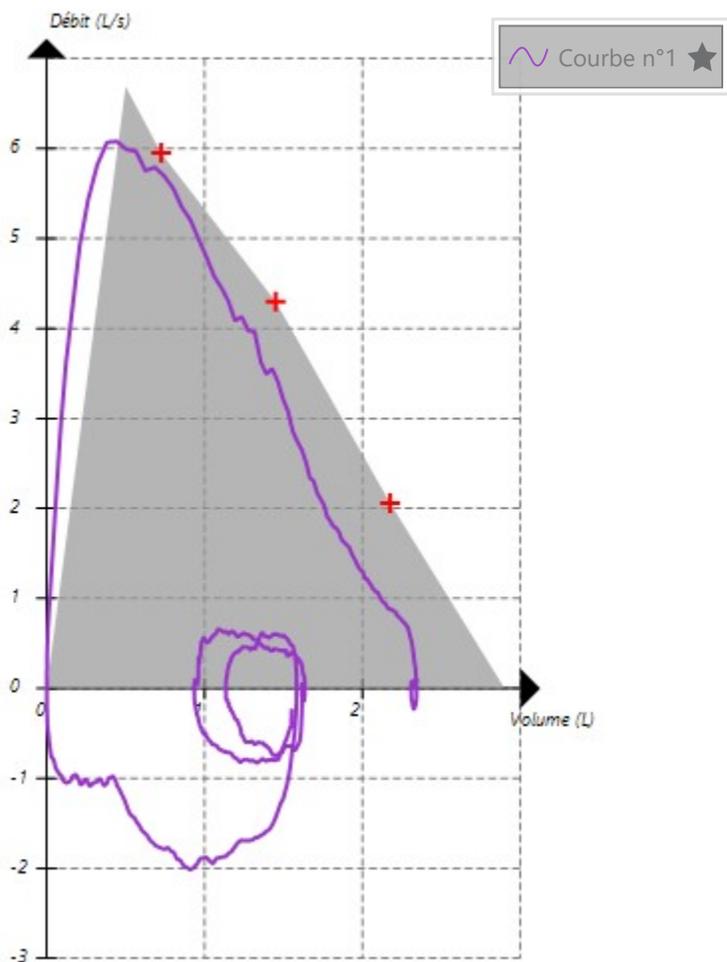

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,34 L	2,90 L	80,69 %
VEMS	2,34 L	2,52 L	92,86 %
DEP	6,17 L/s	6,69 L/s	92,23 %
VEMS/ CVF	100,00 %	83,72 %	119,45 %
Durée d'expiration	1,08 s	-	
DEMM	3,93 L/s	3,94 L/s	99,75 %
DEMM/ CVF	1,68 s-1	1,18 s-1	142,37 %
DE75	5,86 L/s	5,95 L/s	98,49 %
DE50	4,08 L/s	4,30 L/s	94,88 %
DE25	2,04 L/s	2,06 L/s	99,03 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: