



<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ABDOULAYE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1998	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 26 Ans	<b>Entreprise</b>
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 94	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 162 cm	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids</b> 71 kg	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	
<b>Opérateur</b> admin admin	

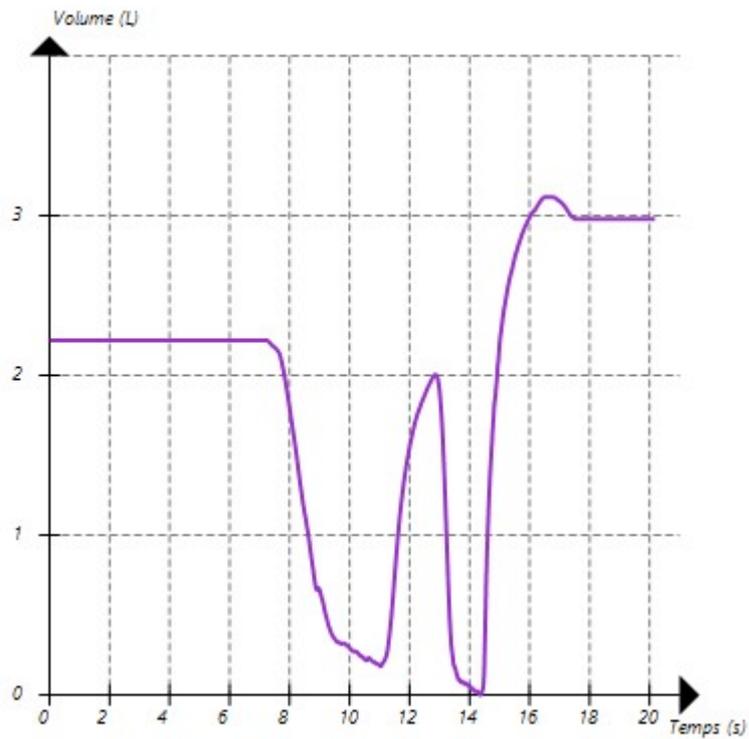

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,4 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 93,3 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 43 %

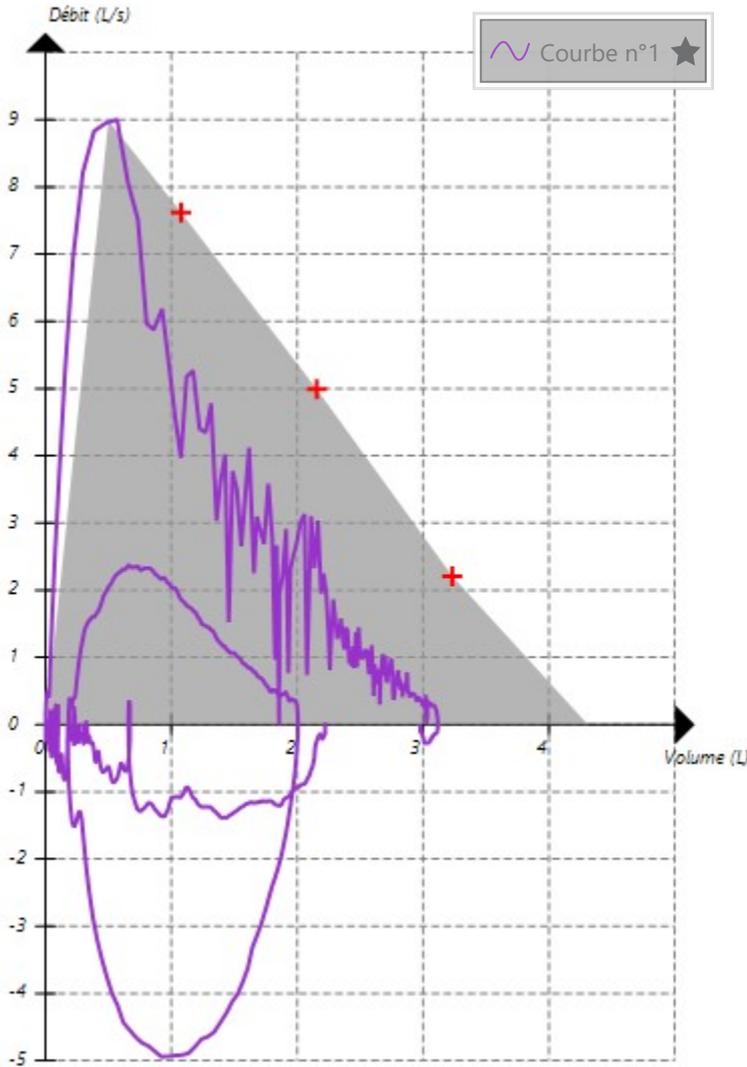

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,12 L	4,31 L	72,39 %
VEMS	2,71 L	3,72 L	72,85 %
DEP	9,49 L/s	8,99 L/s	105,56 %
VEMS/ CVF	86,86 %	82,56 %	105,21 %
Durée d'expiration	2,17 s	-	
DEMM	2,95 L/s	4,73 L/s	62,37 %
DEMM/ CVF	0,95 s-1	1,10 s-1	86,36 %
DE75	6,47 L/s	7,62 L/s	84,91 %
DE50	2,86 L/s	4,99 L/s	57,31 %
DE25	1,76 L/s	2,21 L/s	79,64 %