

<b>Nom CISSE</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom ANSOUMANE</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/1994</b>	<b>Profession MANOEUVRE</b>
<b>Age 30 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 845</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 180 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 68 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 27,9 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,8 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 58 %

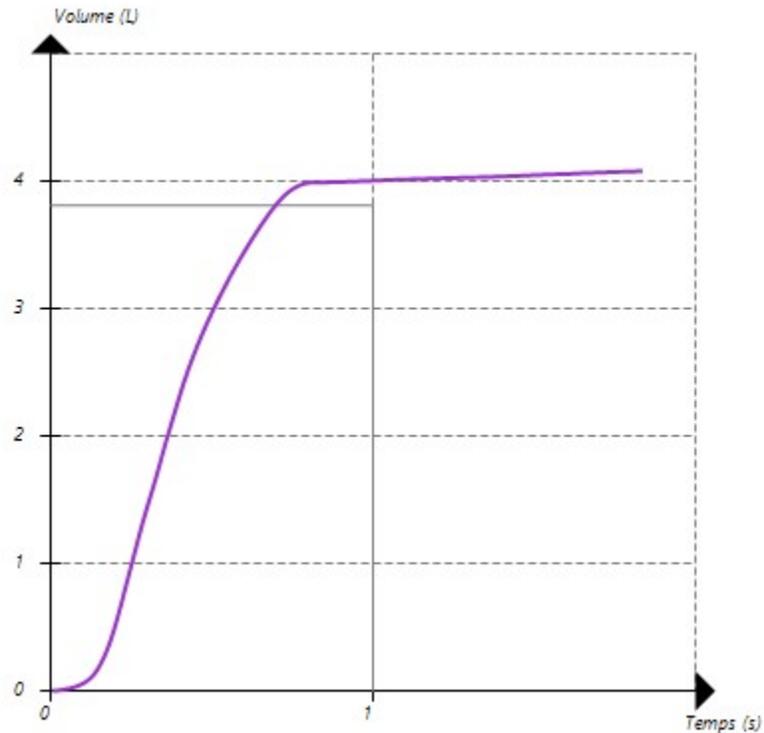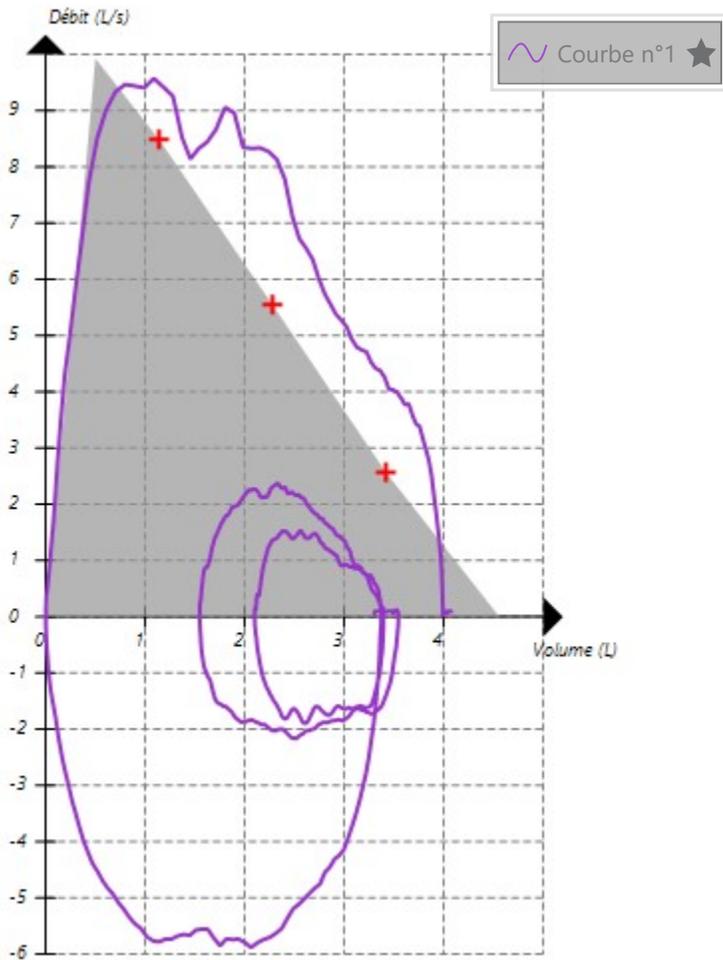

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,08 L	4,56 L	89,47 %
VEMS	4,02 L	3,81 L	105,51 %
DEP	9,61 L/s	9,93 L/s	96,78 %
VEMS/CVF	98,53 %	81,84 %	120,39 %
Durée d'expiration	1,85 s	-	
DEMM	7,73 L/s	4,91 L/s	157,43 %
DEMM/CVF	1,89 s-1	0,94 s-1	201,06 %
DE75	9,50 L/s	8,49 L/s	111,90 %
DE50	8,18 L/s	5,55 L/s	147,39 %
DE25	4,91 L/s	2,57 L/s	191,05 %