



<b>Nom</b> SAGNO	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1989	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 35 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> MANOEUVRE
<b>ID</b> 1695	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 160 cm	<b>Groupe ethnique</b> Caucasien
<b>Poids</b> 61 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,3 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 53 %

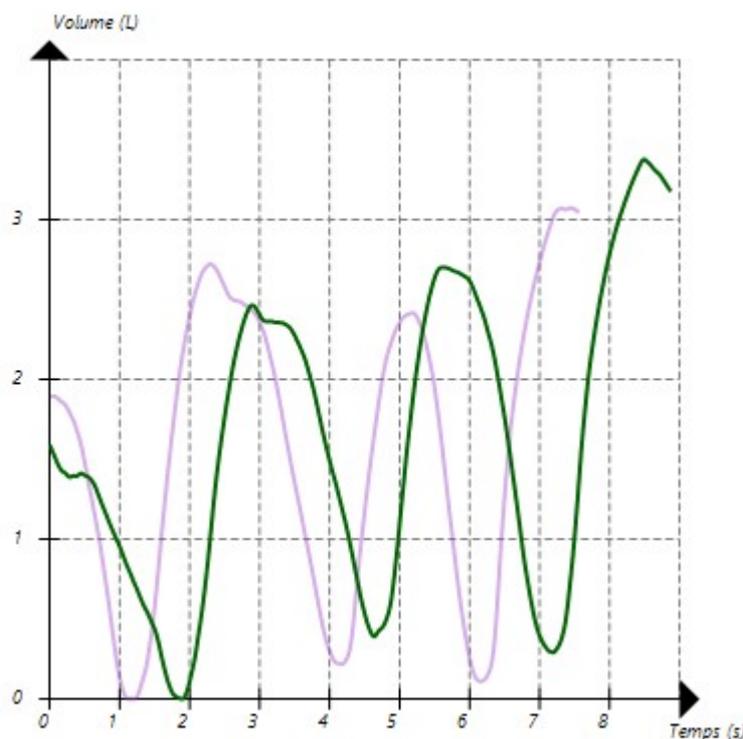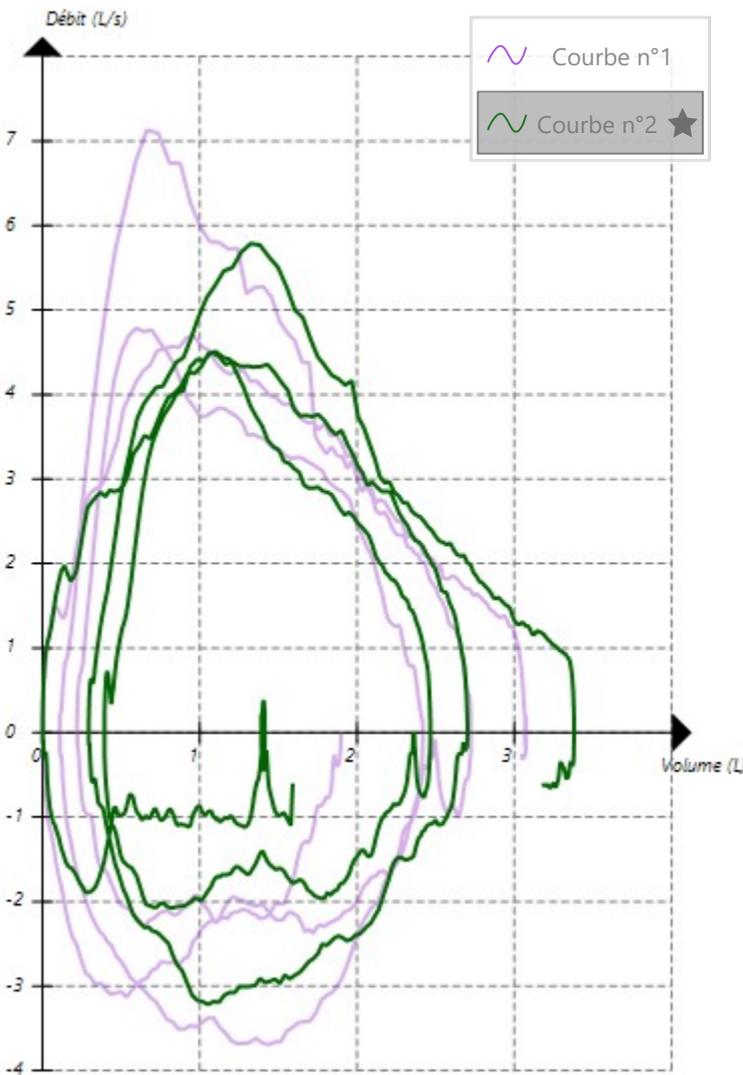

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,96 L	3,09 L	4,27 L	72,37 %
VEMS	2,96 L	3,00 L	3,50 L	85,71 %
DEP	7,25 L/s	5,82 L/s	8,74 L/s	66,59 %
VEMS/CVF	100,00 %	97,09 %	80,84 %	120,10 %
Durée d'expiration	1,29 s	1,30 s	-	
DEMM	4,06 L/s	3,83 L/s	3,60 L/s	106,39 %
DEMM/CVF	1,37 s-1	1,24 s-1	0,84 s-1	147,62 %
DE75	6,82 L/s	5,26 L/s	-	
DE50	4,68 L/s	4,21 L/s	-	
DE25	2,37 L/s	2,15 L/s	-	