

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ADAMA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 02/09/1986	<b>Profession</b> LIGHT DUTY DRIVER
<b>Age</b> 38 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 4566	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 173 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 81 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecce/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 10
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 32,3 °C  
 Pression atmosphérique : 95,2 kPa  
 Humidité : 55 %

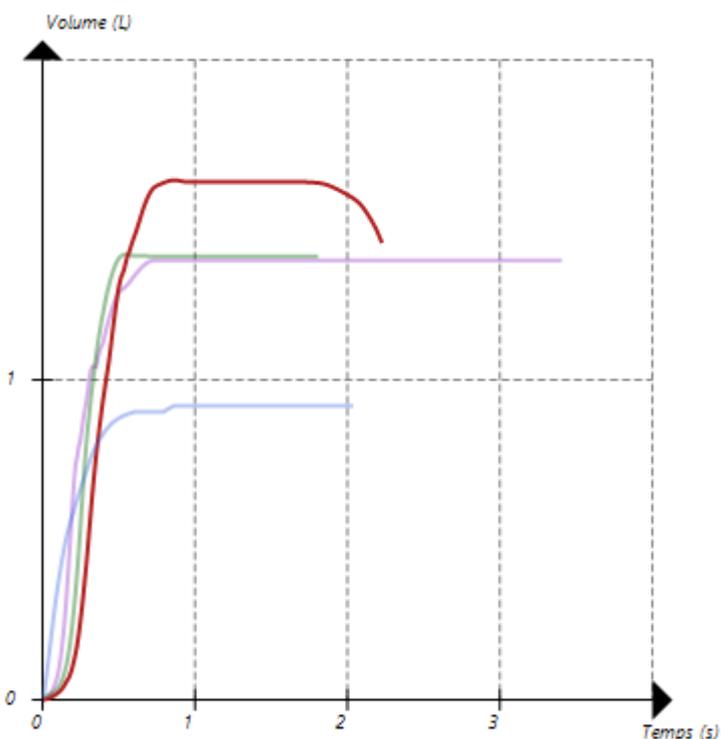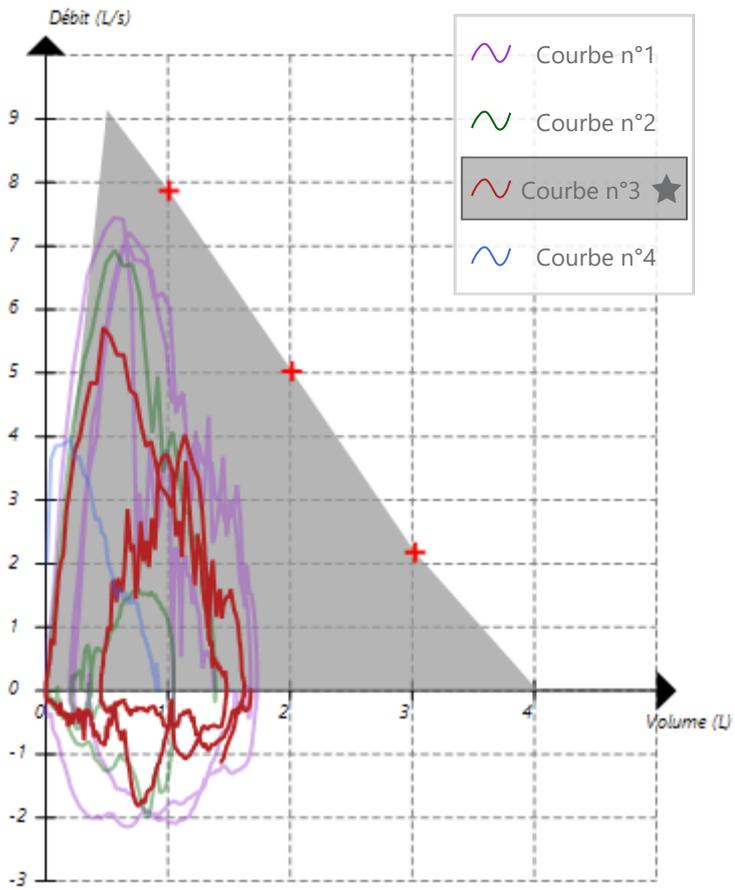

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Courbe n°4	Prédits	% Prédits
CVF	1,37 L	1,39 L	1,62 L	0,92 L	4,03 L	40,20 %
VEMS	1,37 L	1,39 L	1,62 L	0,92 L	3,35 L	48,36 %
DÉP	7,81 L/s	7,60 L/s	6,15 L/s	4,05 L/s	9,15 L/s	67,21 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	80,41 %	124,36 %
Durée d'expiration	0,76 s	0,63 s	0,88 s	0,87 s	-	
DEMM	4,27 L/s	5,55 L/s	4,19 L/s	2,24 L/s	4,43 L/s	94,58 %
DEMM/ CVF	3,12 s <sup>-1</sup>	3,99 s <sup>-1</sup>	2,59 s <sup>-1</sup>	2,43 s <sup>-1</sup>	0,96 s <sup>-1</sup>	269,79 %
DE75	6,75 L/s	5,69 L/s	4,77 L/s	3,47 L/s	7,87 L/s	60,61 %
DE50	6,67 L/s	7,16 L/s	4,09 L/s	2,50 L/s	5,03 L/s	81,31 %
DE25	0,67 L/s	4,19 L/s	3,44 L/s	1,40 L/s	2,18 L/s	157,80 %