



<b>Nom</b> KONATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOUSSA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1999	<b>Profession</b> BUS DRIVER
<b>Age</b> 26 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 7147	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 175 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 81 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 29,2 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 61 %

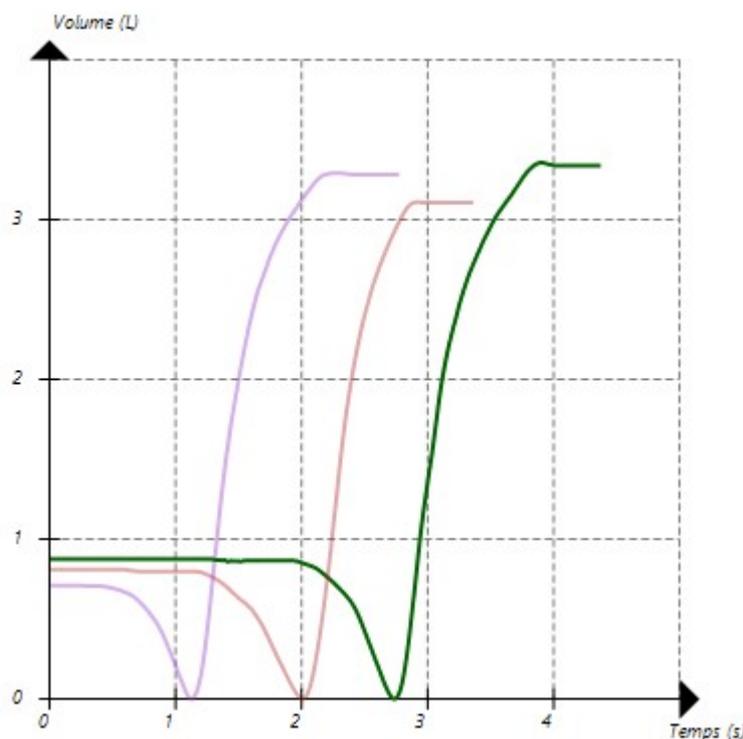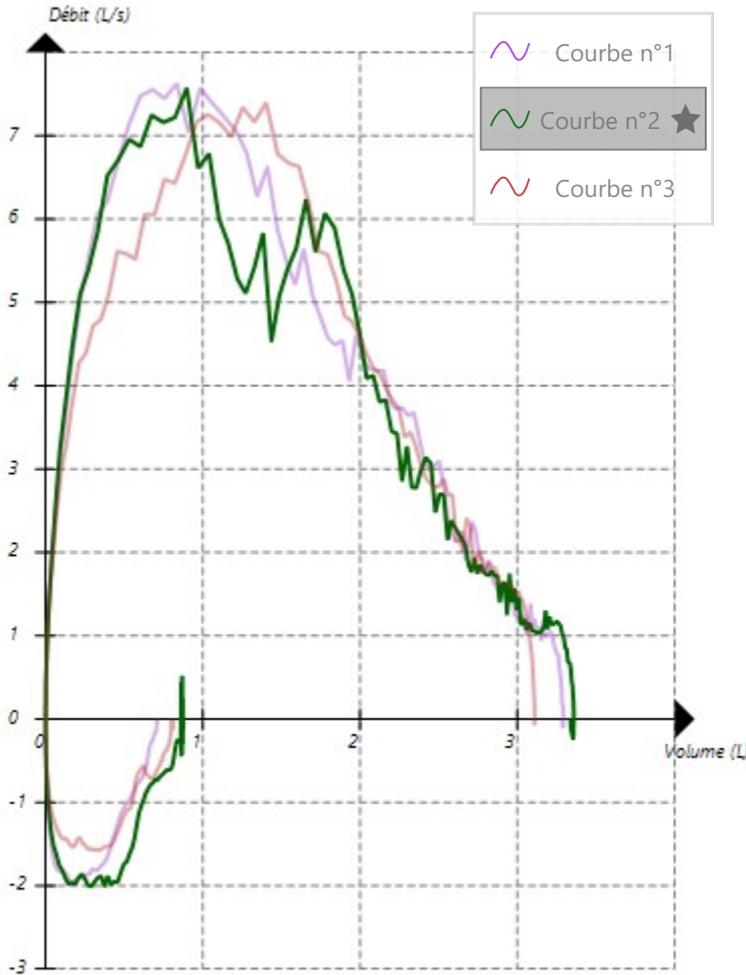

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,29 L	3,36 L	3,11 L	4,47 L	75,17 %
VEMS	3,29 L	3,31 L	3,11 L	3,78 L	87,57 %
DEP	7,87 L/s	7,74 L/s	7,62 L/s	9,54 L/s	81,13 %
VEMS/ CVF	100,00 %	98,51 %	100,00 %	84,49 %	116,59 %
Durée d'expiration	1,13 s	1,16 s	0,90 s	-	
DEMM	5,15 L/s	4,76 L/s	5,74 L/s	4,25 L/s	112,00 %
DEMM/ CVF	1,57 s-1	1,42 s-1	1,85 s-1	0,95 s-1	149,47 %
DE75	7,69 L/s	7,03 L/s	6,60 L/s	-	
DE50	5,79 L/s	6,03 L/s	6,60 L/s	-	
DE25	3,06 L/s	2,62 L/s	3,01 L/s	-	