

<b>Nom</b> BERETE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ALHASSANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 15/04/1995	<b>Profession</b> ASSISTANT SECURITE
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 3805	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 177 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31,4 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 93,2 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 30 %

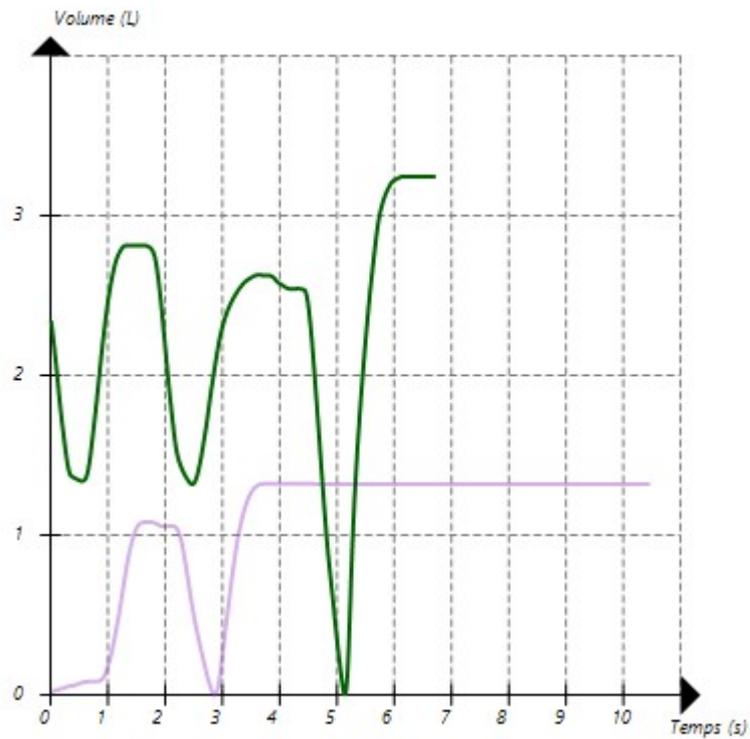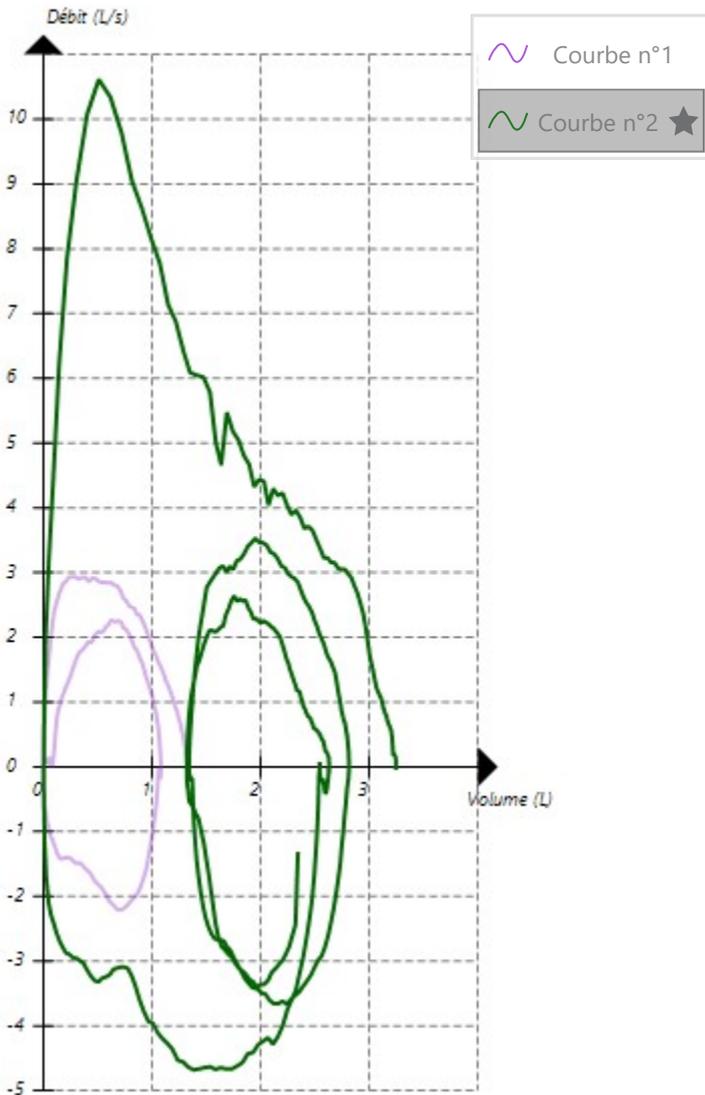

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	1,32 L	3,25 L	4,53 L	71,74 %
VEMS	1,32 L	3,25 L	3,81 L	85,30 %
DEP	2,98 L/s	10,67 L/s	9,61 L/s	111,03 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	83,94 %	119,13 %
Durée d'expiration	0,89 s	1,00 s	-	
DEMM	2,67 L/s	5,43 L/s	4,20 L/s	129,29 %
DEMM/CVF	2,02 s-1	1,67 s-1	0,93 s-1	179,57 %
DE75	2,87 L/s	9,02 L/s	-	
DE50	2,78 L/s	4,60 L/s	-	
DE25	1,88 L/s	3,71 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: