

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> OUSMANE	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1995	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1110	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 167 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 53 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 31 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 59 %

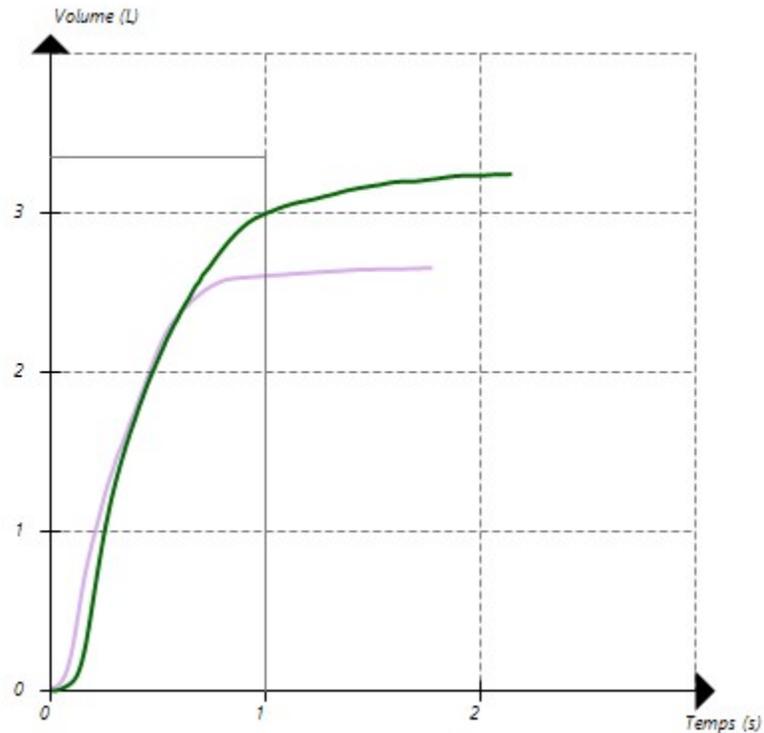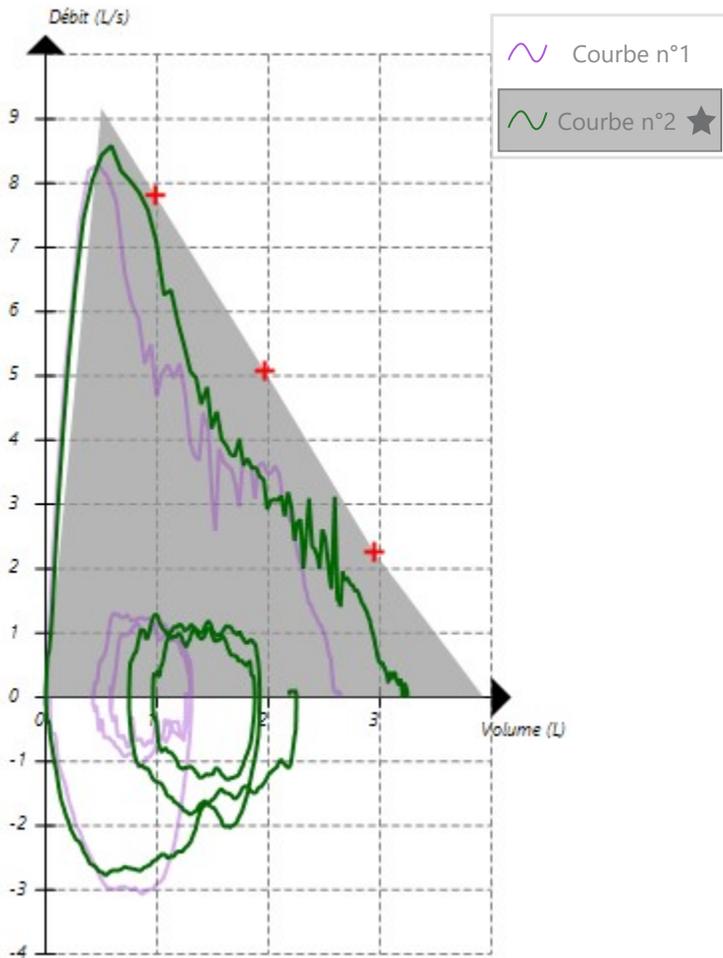

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,65 L	3,25 L	3,93 L	82,70 %
VEMS	2,60 L	3,06 L	3,35 L	91,34 %
DEP	8,38 L/s	8,67 L/s	9,17 L/s	94,55 %
VEMS/ CVF	98,11 %	94,15 %	82,02 %	114,79 %
Durée d'expiration	1,86 s	2,17 s	-	
DEMM	4,32 L/s	4,05 L/s	4,70 L/s	86,17 %
DEMM/ CVF	1,63 s-1	1,25 s-1	1,04 s-1	120,19 %
DE75	7,33 L/s	7,87 L/s	7,81 L/s	100,77 %
DE50	4,17 L/s	3,74 L/s	5,08 L/s	73,62 %
DE25	3,56 L/s	2,36 L/s	2,26 L/s	104,42 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v03.01.00

Signature de l'opérateur: