

<b>Nom</b> ZHOU	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> NIANJIANG	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/12/1974	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 50 Ans	<b>Entreprise</b> CR18/CAMP2
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 6979	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 166 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 66 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale

Version du logiciel embarqué : V01.02.00



Température ambiante : 24,9 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 94,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Humidité : 65 %

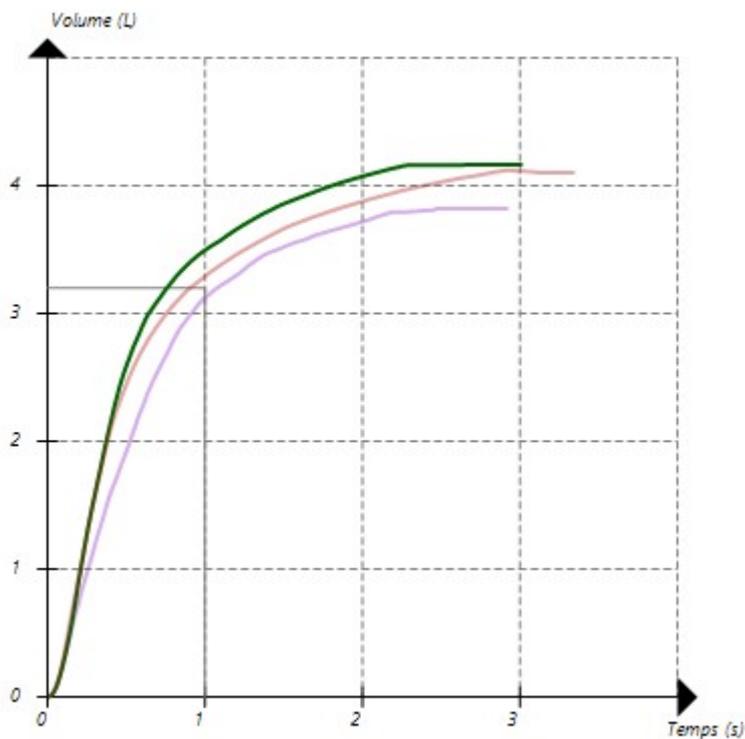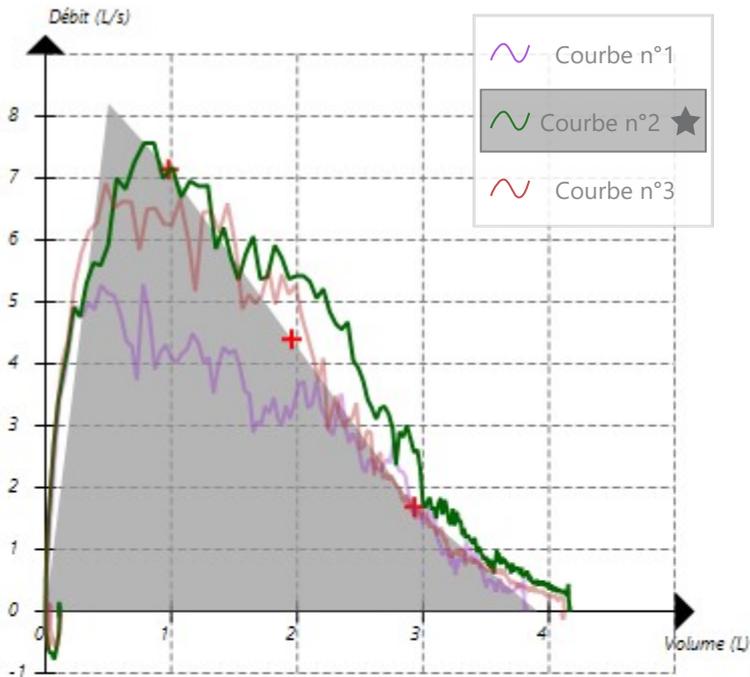

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,81 L	4,17 L	4,12 L	3,91 L	106,65 %
VEMS	3,15 L	3,56 L	3,34 L	3,20 L	111,25 %
DEP	5,57 L/s	8,15 L/s	7,47 L/s	8,21 L/s	99,27 %
VEMS/CVF	82,68 %	85,37 %	81,07 %	78,26 %	109,09 %
Durée d'expiration	2,46 s	2,70 s	2,92 s	-	
DEMM	3,27 L/s	4,18 L/s	3,41 L/s	3,78 L/s	110,58 %
DEMM/CVF	0,86 s-1	1,00 s-1	0,83 s-1	0,97 s-1	103,09 %
DE75	4,29 L/s	6,83 L/s	6,64 L/s	7,14 L/s	95,66 %
DE50	3,22 L/s	5,35 L/s	4,69 L/s	4,40 L/s	121,59 %
DE25	2,15 L/s	1,58 L/s	1,35 L/s	1,69 L/s	93,49 %