

<b>Nom QIU</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom TAO</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 20/11/1974</b>	<b>Profession WELDER</b>
<b>Age 50 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 5709</b>	<b>Fumeur Fumeur</b>
<b>Taille 158 cm</b>	<b>Groupe ethnique Chinois de Hong Kong</b>
<b>Poids 68 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites NHANES III</b>	<b>Smoking Pack Years : 4</b>
<b>Opérateur BAH OUMOU SALAMATA</b>	




**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51


**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 23,3 °C  
 Pression atmosphérique : 94,5 kPa  
 Humidité : 73 %

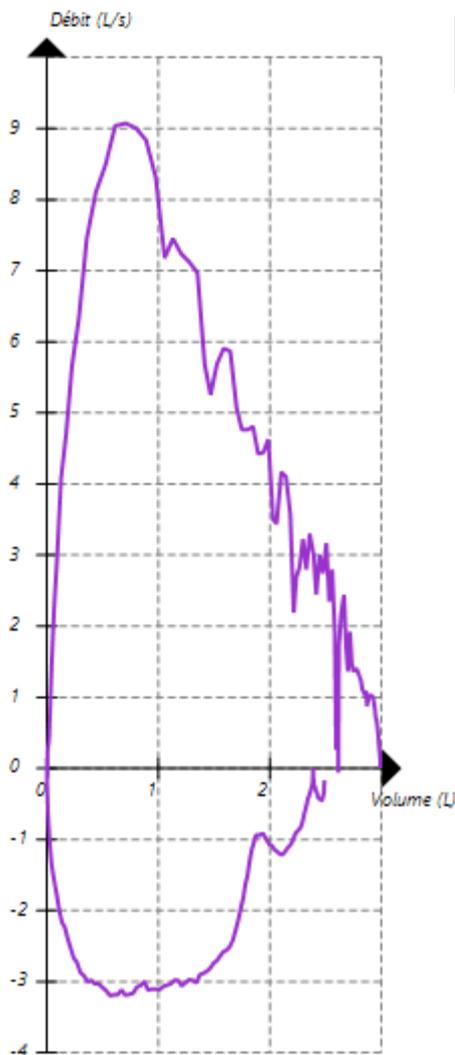

Courbe n°1 ★

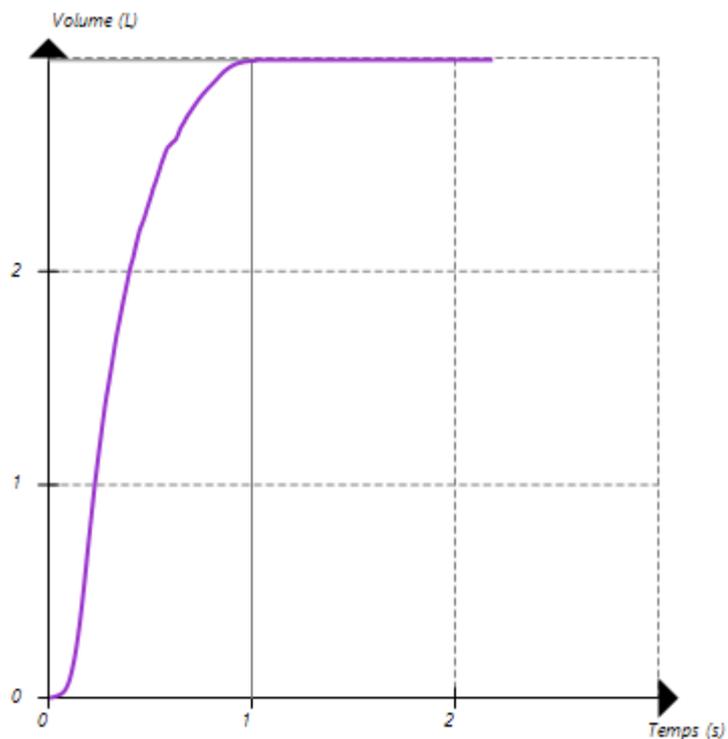

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,99 L	3,82 L	78,27 %
VEMS	2,99 L	2,99 L	100,00 %
DÉP	9,41 L/s	8,17 L/s	115,18 %
VEMS/CVF	100,00 %	77,74 %	128,63 %
Durée d'expiration	1,03 s	-	
DEMM	5,57 L/s	2,79 L/s	199,64 %
DEMM/CVF	1,86 s <sup>-1</sup>	0,73 s <sup>-1</sup>	254,79 %
DE75	8,93 L/s	-	
DE50	5,72 L/s	-	
DE25	2,73 L/s	-	