

<b>Nom FOFANA</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom OUMAR</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/1888</b>	<b>Profession CHAUFFEUR PL</b>
<b>Age 136 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 385</b>	<b>Fumeur Non fumeur</b>
<b>Taille 177 cm</b>	<b>Groupe ethnique Origine africaine</b>
<b>Poids 84 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites NHANES III</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	





**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232697  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024

Température ambiante : 30,6 °C  
 Pression atmosphérique : 698,3 mmHg  
 Humidité : 50 %

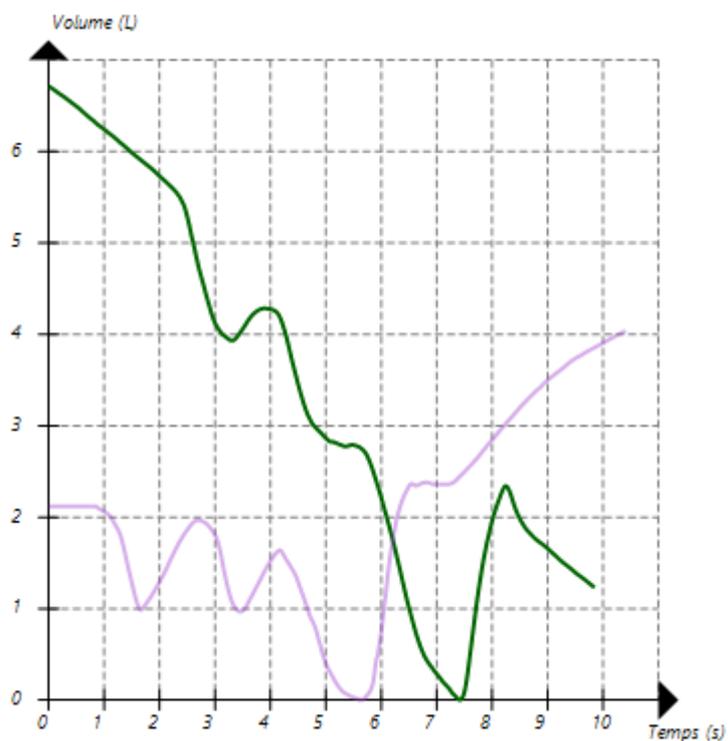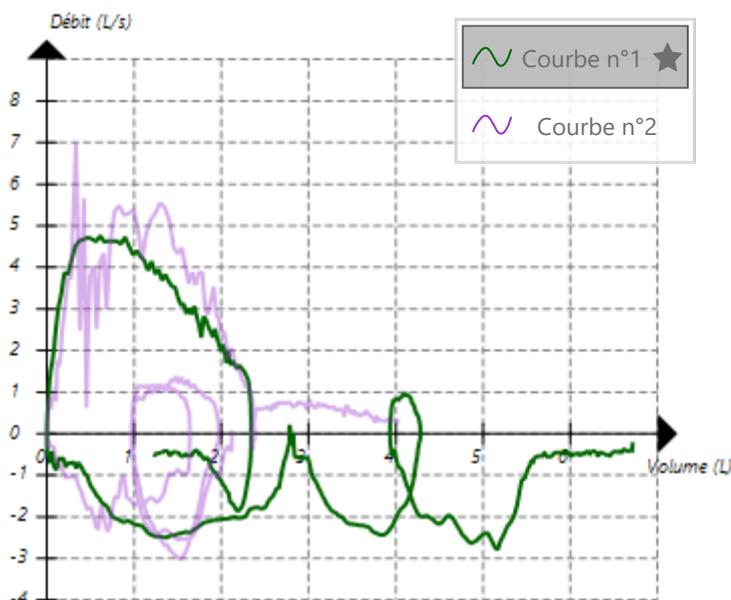

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	2,34 L	2,37 L	2,59 L	90,35 %
VEMS	2,34 L	2,37 L	1,33 L	175,94 %
DÉP	4,94 L/s	8,04 L/s	5,24 L/s	94,27 %
VEMS/CVF	100,00 %	100,00 %	64,38 %	155,33 %
Durée d'expiration	0,83 s	0,93 s	-	
DEMM	3,92 L/s	4,69 L/s	-0,34 L/s	-1152,94 %
DEMM/CVF	1,68 s-1	1,98 s-1	-0,13 s-1	-1292,31 %
DE75	4,71 L/s	3,97 L/s	-	
DE50	3,93 L/s	4,75 L/s	-	
DE25	2,42 L/s	3,97 L/s	-	