

<b>Nom</b> CONDE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MOHAMED	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1995	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 29 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1124	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 165 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 59 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Spirométrie normale


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 28,8 °C


Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,9 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 59 %

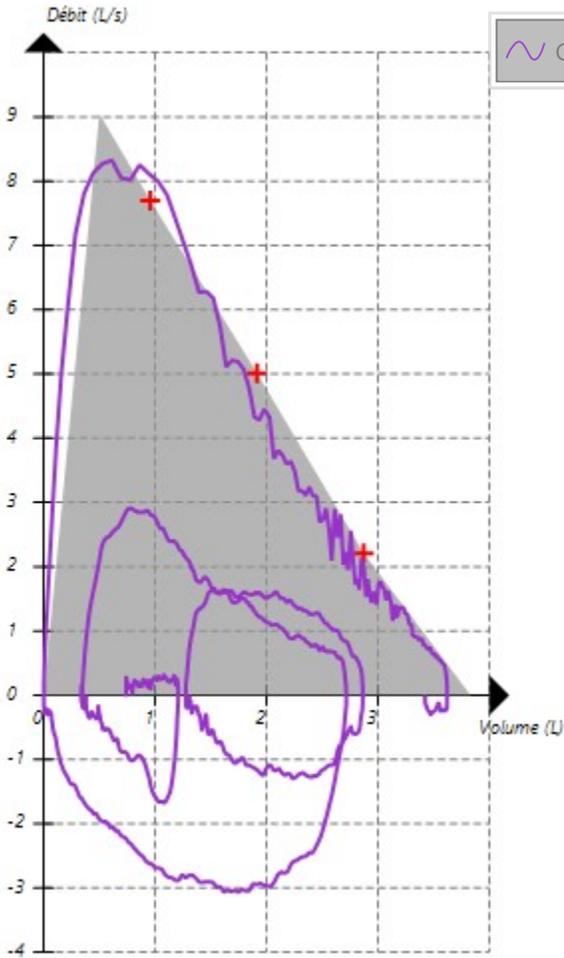

Courbe n°1 ★

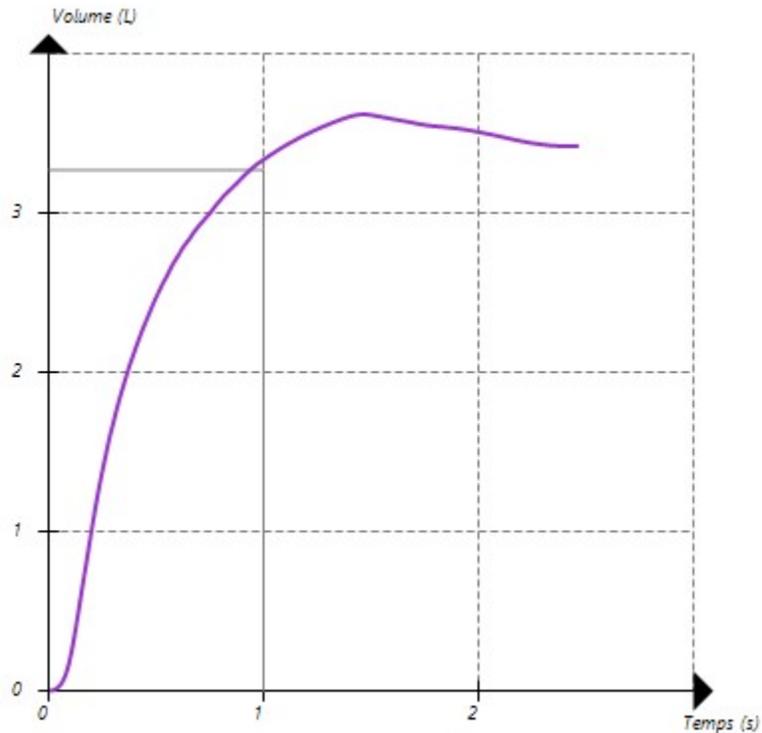

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,62 L	3,83 L	94,52 %
VEMS	3,40 L	3,27 L	103,98 %
DEP	8,57 L/s	9,05 L/s	94,70 %
VEMS/ CVF	93,92 %	82,02 %	114,51 %
Durée d'expiration	1,47 s	-	
DEMM	4,45 L/s	4,66 L/s	95,49 %
DEMM/ CVF	1,23 s-1	1,06 s-1	116,04 %
DE75	8,14 L/s	7,70 L/s	105,71 %
DE50	5,06 L/s	5,01 L/s	101,00 %
DE25	2,47 L/s	2,21 L/s	111,76 %