

<b>Nom</b> CAMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> MORY	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/02/1999	<b>Profession</b> FLAGMAN
<b>Age</b> 26 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 4545	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 168 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 75 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Eccs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	





**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00  
 Numéro de série : 232803  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024

Température ambiante : 33,2 °C  
 Pression atmosphérique : 95,2 kPa  
 Humidité : 51 %

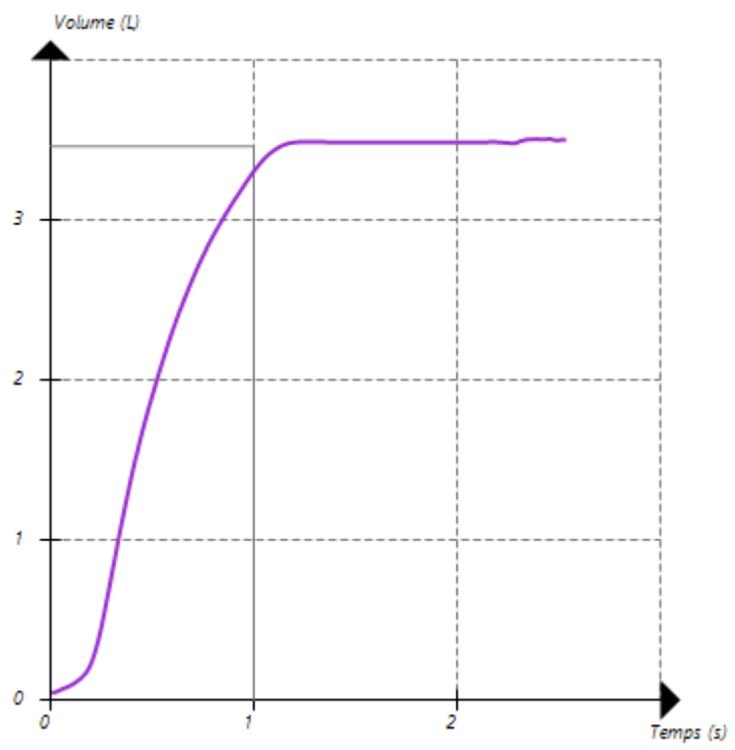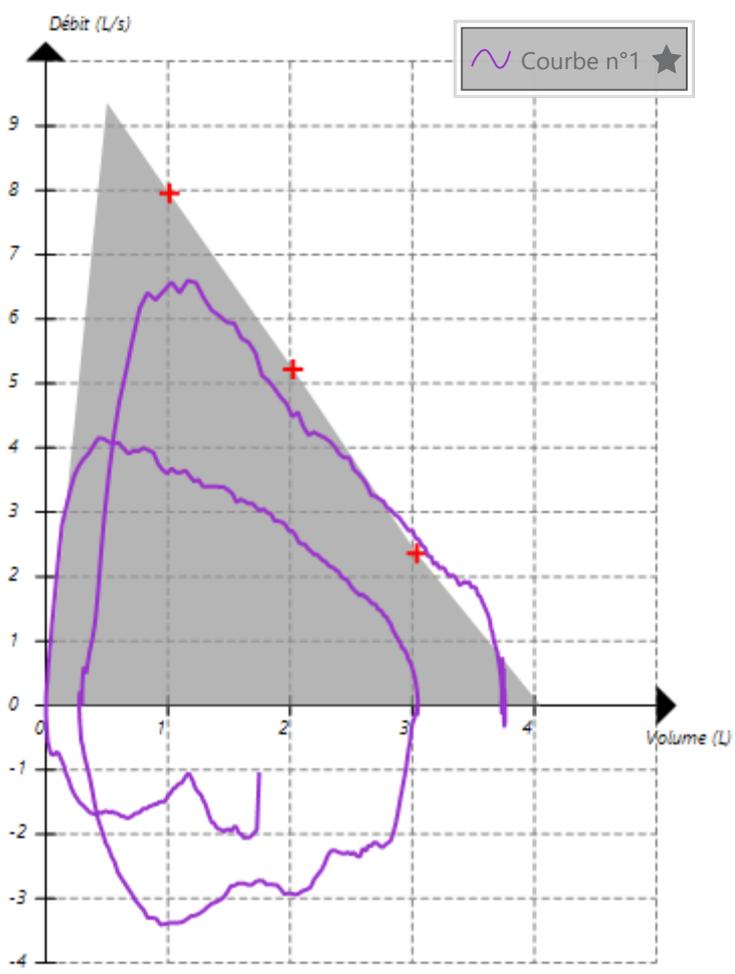

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,47 L	4,05 L	85,68 %
VEMS	3,46 L	3,46 L	100,00 %
DÉP	6,68 L/s	9,36 L/s	71,37 %
VEMS/CVF	99,71 %	82,56 %	120,77 %
Durée d'expiration	1,47 s	-	
DEMM	4,59 L/s	4,85 L/s	94,64 %
DEMM/CVF	1,32 s <sup>-1</sup>	1,04 s <sup>-1</sup>	126,92 %
DE75	6,52 L/s	7,95 L/s	82,01 %
DE50	4,45 L/s	5,22 L/s	85,25 %
DE25	2,91 L/s	2,36 L/s	123,31 %