



<b>Nom</b> KONATE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SEKOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 20/03/2002	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 22 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1590	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 165 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 64 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30,7 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 62 %

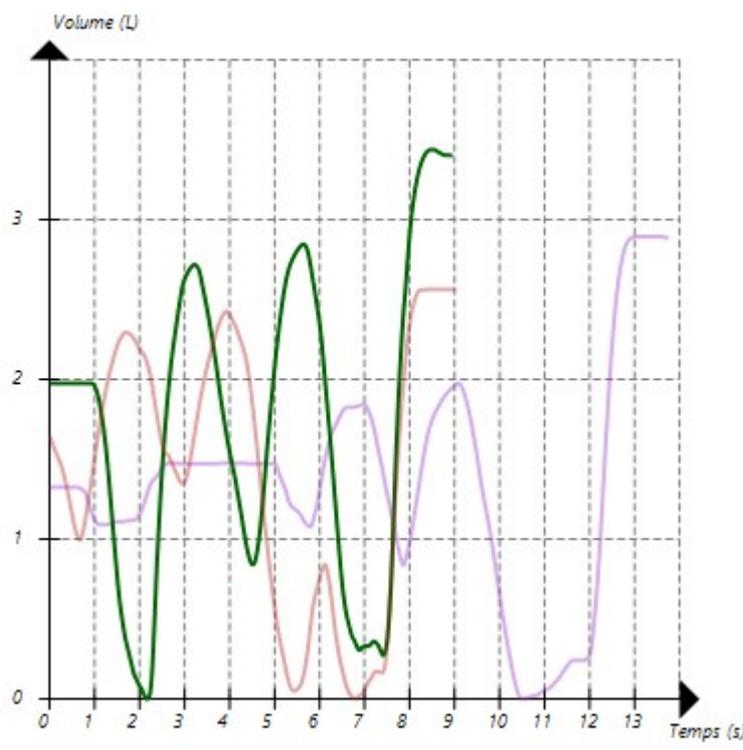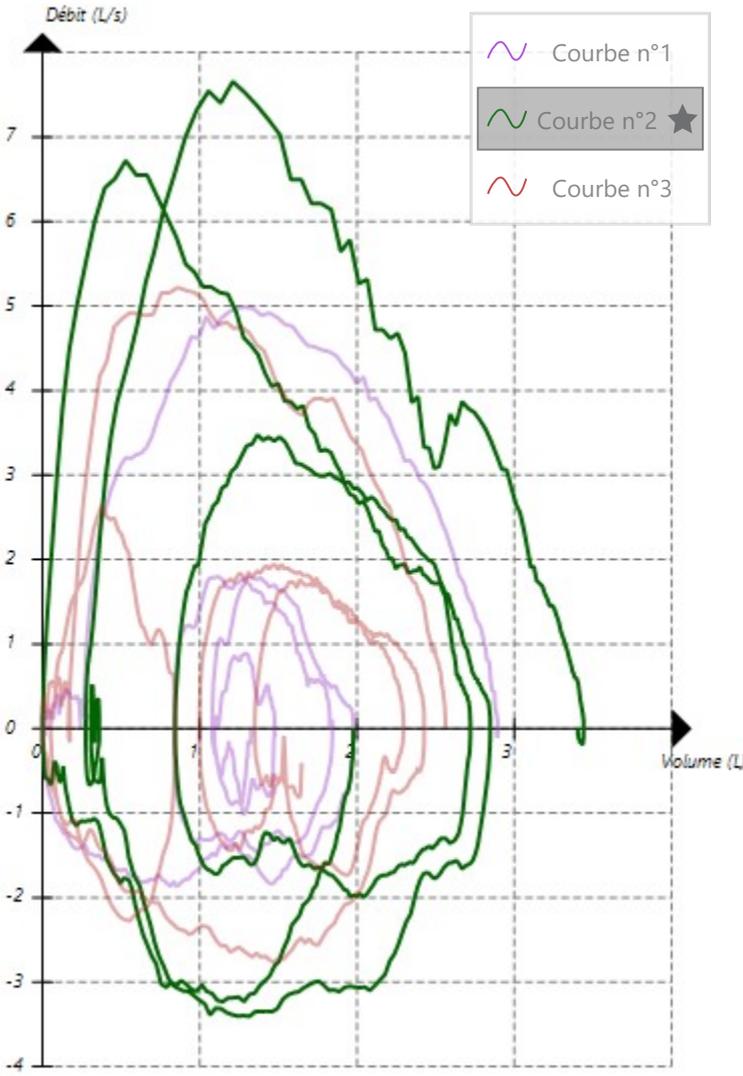

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	2,88 L	3,17 L	2,40 L	3,98 L	79,65 %
VEMS	2,88 L	3,17 L	2,40 L	3,43 L	92,42 %
DEP	5,07 L/s	7,82 L/s	5,26 L/s	8,77 L/s	89,17 %
VEMS/ CVF	100,00 %	100,00 %	100,00 %	85,22 %	117,34 %
Durée d'expiration	2,32 s	1,06 s	1,02 s	-	
DEMM	4,59 L/s	5,38 L/s	4,46 L/s	4,06 L/s	132,51 %
DEMM/ CVF	1,59 s-1	1,70 s-1	1,86 s-1	1,02 s-1	166,67 %
DE75	3,72 L/s	7,63 L/s	5,23 L/s	-	
DE50	4,89 L/s	6,11 L/s	4,50 L/s	-	
DE25	3,76 L/s	3,92 L/s	3,48 L/s	-	

Signature du patient:

Signature de l'opérateur: