

<b>Nom</b> BERETE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SEKOU	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1996	<b>Profession</b> MANOEUVRE
<b>Age</b> 28 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 1296	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 177 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 72 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 24,3 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 95,3 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 62 %

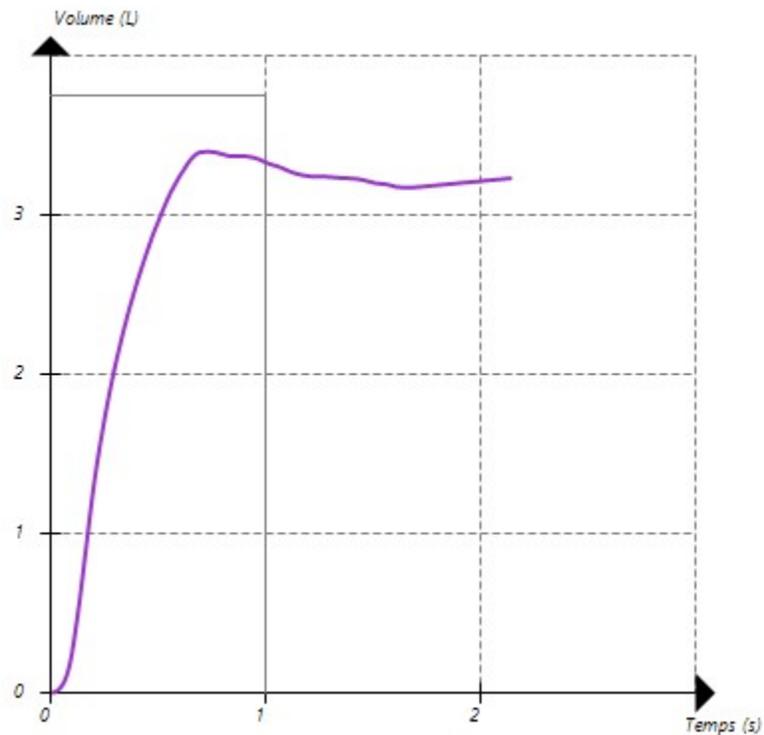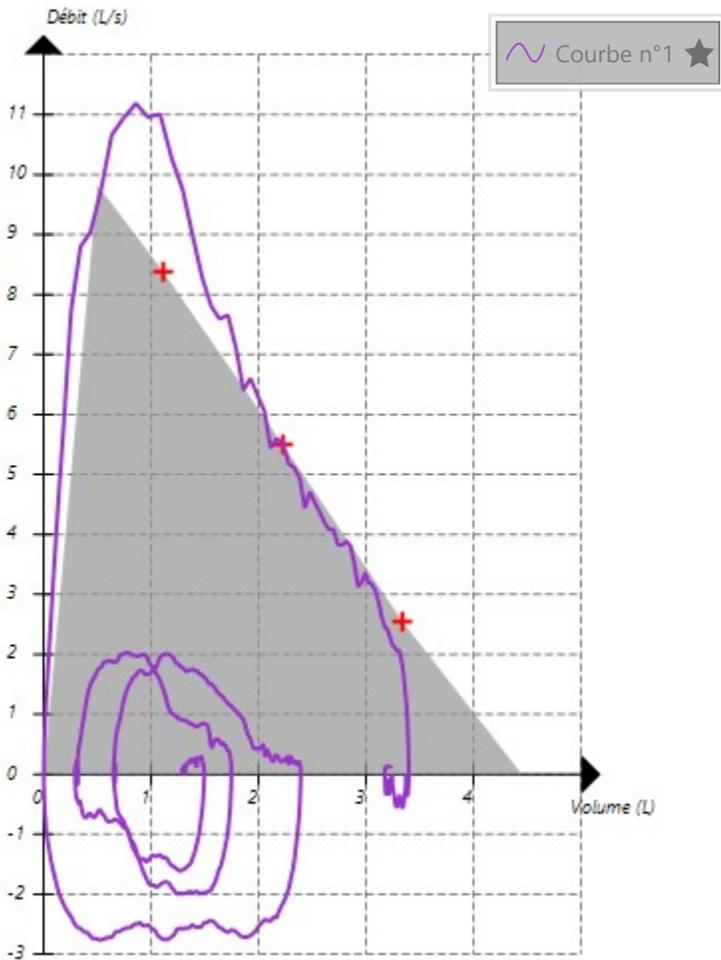

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	3,40 L	4,45 L	76,40 %
VEMS	3,40 L	3,75 L	90,67 %
DEP	11,35 L/s	9,83 L/s	115,46 %
VEMS/ CVF	100,00 %	82,20 %	121,65 %
Durée d'expiration	0,72 s	-	
DEMM	7,20 L/s	4,94 L/s	145,75 %
DEMM/ CVF	2,12 s-1	0,96 s-1	220,83 %
DE75	11,28 L/s	8,38 L/s	134,61 %
DE50	7,81 L/s	5,50 L/s	142,00 %
DE25	4,46 L/s	2,55 L/s	174,90 %