



<b>Nom SYLLA</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom ABOUBACAR</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 01/01/1990</b>	<b>Profession WELDER</b>
<b>Age 34 Ans</b>	<b>Entreprise CR18</b>
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 38</b>	<b>Fumeur Ancien fumeur</b>
<b>Taille 181 cm</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Poids 73 kg</b>	<b>Smoking Pack Years : 6</b>
<b>Valeurs prédites Ecgs/Zapletal</b>	
<b>Opérateur KEITA MARIAMA DALANDA</b>	



**MEDVIE**  
CENTRE MEDICAL BEYLA  
611724921

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,3 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,1 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 39 %

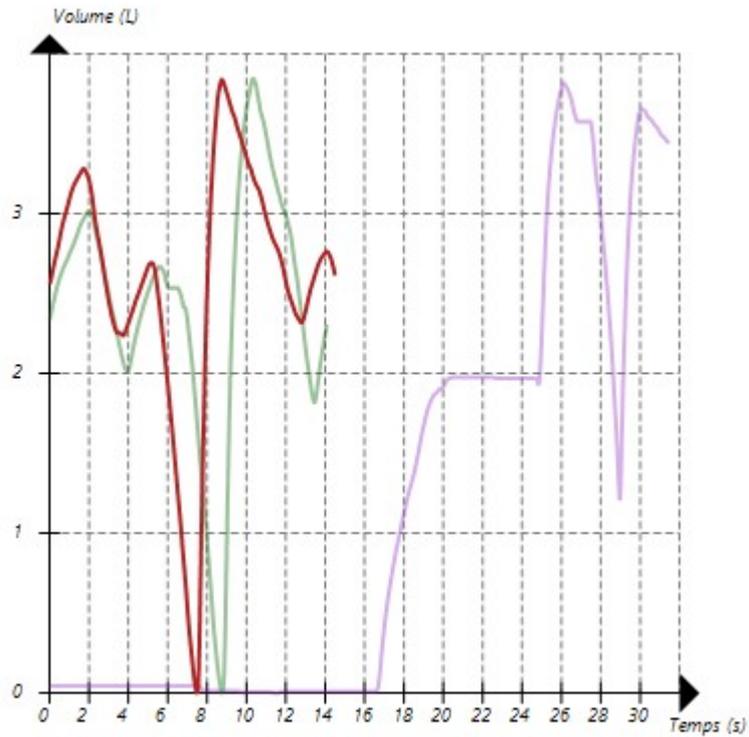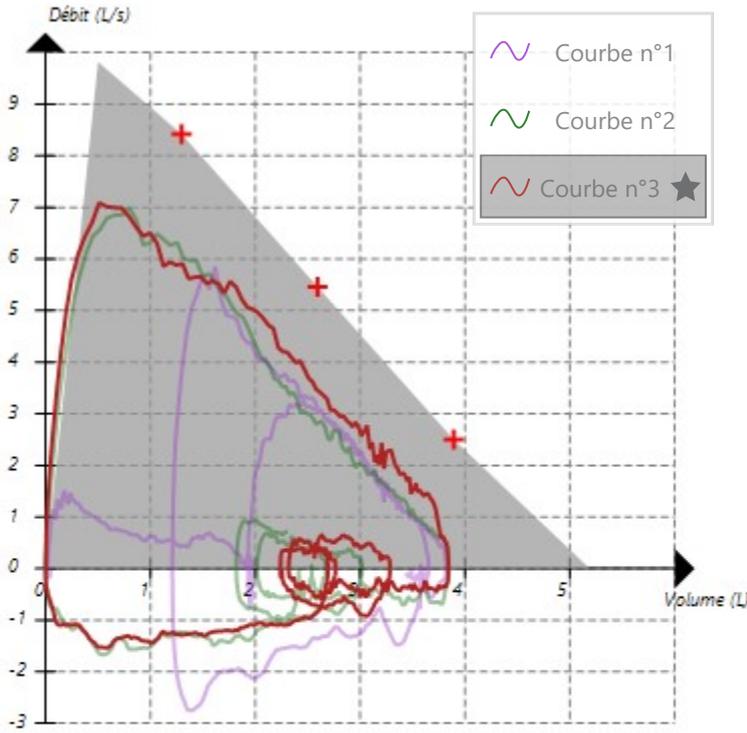

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,45 L	3,85 L	3,84 L	5,19 L	73,99 %
VEMS	2,43 L	3,53 L	3,74 L	4,31 L	86,77 %
DEP	6,01 L/s	7,14 L/s	7,20 L/s	9,82 L/s	73,32 %
VEMS/CVF	99,18 %	91,69 %	97,40 %	81,12 %	120,07 %
Durée d'expiration	1,10 s	1,58 s	1,25 s	-	
DEMM	3,30 L/s	4,17 L/s	4,69 L/s	4,76 L/s	98,53 %
DEMM/CVF	1,35 s-1	1,08 s-1	1,22 s-1	0,92 s-1	132,61 %
DE75	4,83 L/s	6,37 L/s	6,56 L/s	8,42 L/s	77,91 %
DE50	3,30 L/s	4,73 L/s	4,97 L/s	5,46 L/s	91,03 %
DE25	2,10 L/s	2,23 L/s	2,73 L/s	2,50 L/s	109,20 %