



<b>Nom</b> BILIVOGUI	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> AUGUSTIN	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 12/06/1994	<b>Profession</b>
<b>Age</b> 30 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b> CNSS ASSISTANT
<b>ID</b> 1692	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 170 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 72 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un trouble ventilatoire obstructif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 27,4 °C  
 Numéro de série : 232697      Pression atmosphérique : 93,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024      Humidité : 56 %

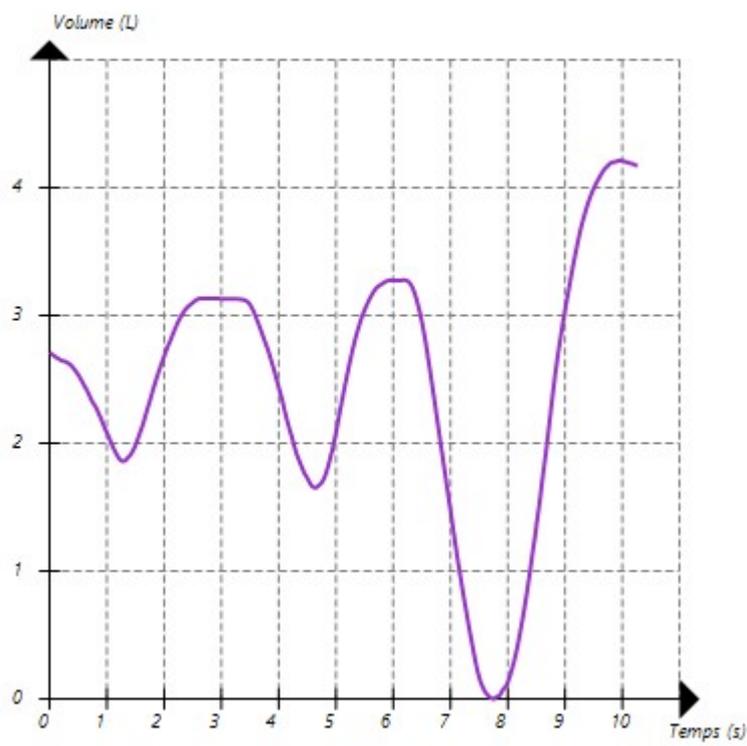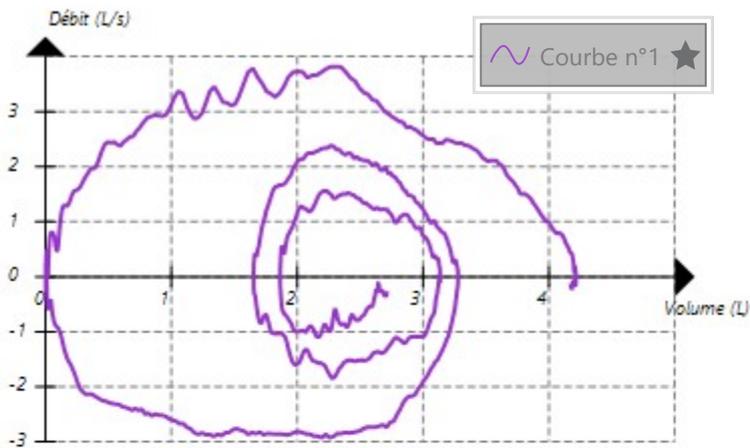

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	4,21 L	4,11 L	102,43 %
VEMS	3,44 L	3,46 L	99,42 %
DEP	3,86 L/s	8,90 L/s	43,37 %
VEMS/ CVF	81,71 %	83,76 %	97,55 %
Durée d'expiration	2,20 s	-	
DEMM	3,28 L/s	3,90 L/s	84,10 %
DEMM/ CVF	0,78 s-1	0,95 s-1	82,11 %
DE75	3,39 L/s	-	
DE50	3,64 L/s	-	
DE25	2,43 L/s	-	