



<b>Nom</b> KOMARA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> SOUMAILA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 15/04/2002	<b>Profession</b> BUS DRIVER
<b>Age</b> 23 Ans	<b>Entreprise</b> CR18
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 9779	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 169 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b> 73 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BAH OUMOU SALAMATA	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 26,8 °C  
 Numéro de série : 232803      Pression atmosphérique : 94,4 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024      Humidité : 60 %

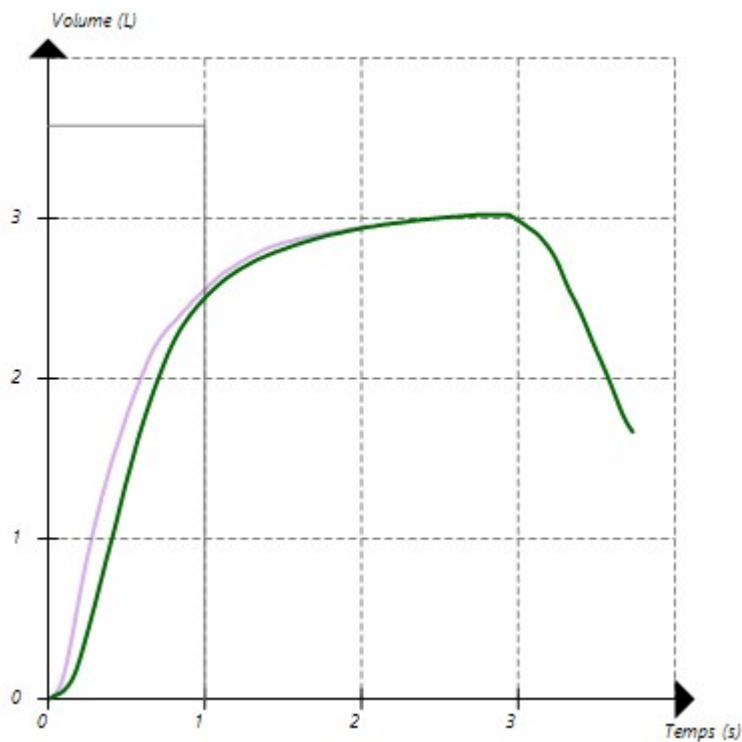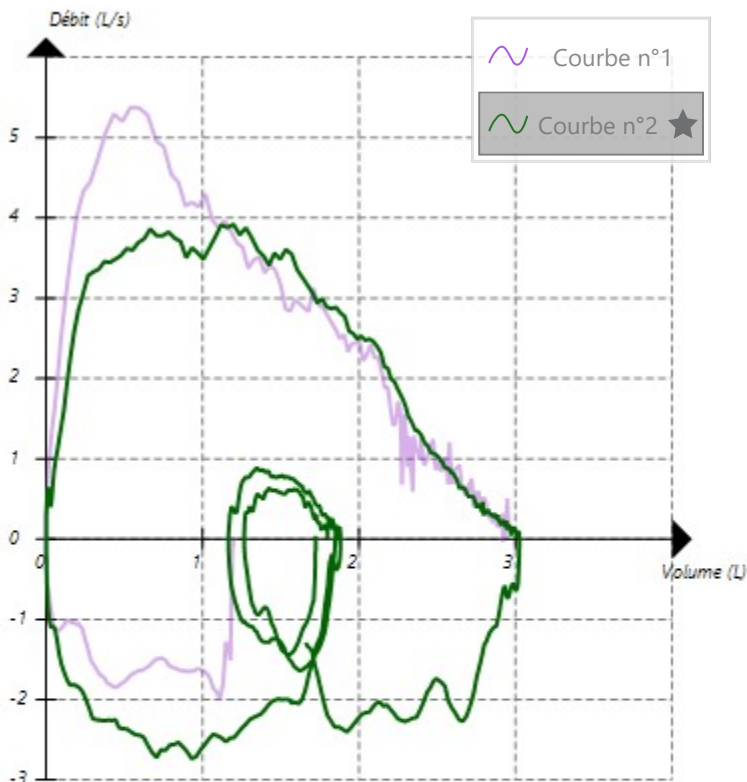

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,96 L	3,02 L	4,18 L	72,25 %
VEMS	2,63 L	2,63 L	3,58 L	73,46 %
DEP	5,56 L/s	3,96 L/s	9,09 L/s	43,56 %
VEMS/ CVF	88,85 %	87,09 %	85,03 %	102,42 %
Durée d'expiration	2,04 s	2,89 s	-	
DEMM	3,11 L/s	3,15 L/s	4,16 L/s	75,72 %
DEMM/ CVF	1,05 s-1	1,04 s-1	1,00 s-1	104,00 %
DE75	4,92 L/s	3,83 L/s	-	
DE50	3,37 L/s	3,55 L/s	-	
DE25	1,31 L/s	1,76 L/s	-	